



CE₀₁₂₃

Metacross™ OTW

PTA Balloon Dilatation Catheter
Cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA
PTA-Balloon dilationskatheter
Catéter de dilatación de balón para ATP
Cateter de Dilatação de Balão para ATP
Catetere con palloncino di dilatazione per PTA
PTA ballon dilatatiekatheter
PTA ballon dilations kateter
PTA ballon dilationskateter
PTA ballon dilationskateter
PTA-pallolaajennuskatetri
Καθετήρας Διαστολής PTA με Μπαλόνι
Периферический баллонный катетер ЧТА
Balonowy cewnik dylacyjny do PTA
PTA Tágitó Ballonkatéter
Balónkový dilatační katétr pro PTA
PTA balónkový dilatačný katéter
PTA Balon Dilatasyon Kateteri
PTA balloondilatatsiooni kateeter
PTA dilatācijas balonkatetrs
PTA kateteris su išplečiamuoju balionėliu
Balonski kateter za dilataciyo PTA
PTA balon dilatacion kateter
Cateter de dilatare pe balon pentru PTA
PTA дилатационен балон-катетър
Дилатаційний балон-катетер для ЧТА
Balonski dilatacijski kateter za PTA



September, 2021

PM-05579
1/115 (3210-2)

REF	SN	LOT	
Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer Número de catálogo Referência Codice prodotto Catalogusnummer Artikelnummer Varenummer Artikkelnummer Tuotekoodi Κωδικός Προϊόντος Каталожный номер Kod produktu Termékkód Kód výrobku Kód výrobku Ürün kodu Kood Koda Nr. Katalogo Nr. Koda izdelka Šifra proizvoda Codul produsului Каталожен номер Номер за каталогом Kataloški broj	Serial number Numéro de série Seriennummer Número de serie Número de série Numero di lotto Seriennummer Seriennummer Seriennummer Seriennummer Sarjanumero Αριθμός παραγωγής Серийный номер Numer serii Sorozatszám Sériové číslo Sériové číslo výrobku Seri Numarası Seerianumber Sērijas Nr. Serijos Nr. Serjska številka Serjski broj Număr de serie. Сериен номер Серийный номер Serjski broj	Lot number Numéro de lot Chargenbezeichnung Número de lote Número de lote Numero di lotto Lotnummer Batchkod Batchnummer Batch number Eränumero Αριθμός παρτίδας Номер партии Numer serii Tételszám Číslo výrobní serie Identifikačné číslo Lot numarası Partii nr. Sērijas Nr. Partijos kodas Številka serije Serjska oznaka Număr lotului Партиден номер Код партії Šifra serije	Use by A utiliser jusque Verwendbar bis Caducidad Data limite de uso Utilizzare entro Gebruiken voor Användes före Udløbsdato Brukes før-dato Eräpäivä Ημερομηνία λήξης Годен до Użył przed datą Felhasználható Použit do Použit do Son kullanim tarihi Säilivusaeg Derīguma termiņš Sunaudoti iki Uporabno do Upotrebljivo do Data de expirare Срок на годност Використати до Upotrijebiti do
STERILEEO			P
Sterilized using ethylene oxide Stérilisé à l'oxyde d'éthylène Sterilisation mit Ethylenoxid Esterilizado con óxido de etileno Esterilizado com oxido de etileno Sterilizzato con ossido di etilene Gesteriliseerd met ethyleenoxide Steriliserad med etylenoxid /Etylenoxid steriliseret Sterilisert med etylen oksid Steriloitu etyleenioksidilla Αποστειρωμένο με αιθυλανοξείδιο Стерилизовано окисью этилена Steryliżowane tlenkiem etylenu Etílenoxiddal sterilizálva Sterilizováno ethylenoxidem Sterilizované etylénoxidom Etilen Oksitle sterilize edilmiştir Steriliseeritud etüleenoksiidiga Sterilizēts ar etilēna oksīdu Sterilizuota naudojant etileno oksidą Sterilizirano z etilen oksidom Sterilisano etilen oksidom Sterilizat cu oxid de etilena Стерилизовано с этилен оксид Простерилизовано за допомогою оксиду етилену Sterilizirano etilen-oksidom		Do not reuse Ne pas réutiliser Nicht zur Wiederverwendung No reutilizar Não reutilizar Monouso Niet opnieuw gebruiken Ingen återanvändning Må ikke genbruges Må ikke gjenbrukes Kertakäyttöinen Μόνο για μια χρήση Не использовать повторно Nie używać powtórnie Csak egyszeri használatra Nelze použít opakovaně Na jednorázové použitie Tek kullanimlik Ainult ühekordseks kasutuseks Tikai vienreizējai lietošanai Pakartotinai nenaudoti Samo za enkratno uporabo Samo za jednokratnu upotrebu Doar pentru unica folosinta Само за еднократна употреба Використовувати повторно заборонено Ne upotrebljavati ponovno	Pressure Pression Druck Presión Pressão Pressione Druk Tr yck Tr yk Trykk Paine Πίεση Давление Ciśnienie Nyomás Tlak Tlak Basiņš Röhk Spiediens Slegis Tlak Pritisak Presiune Налягане Тиск Tlak

	
Consult instructions for use Lire le mode d'emploi Gebrauchsanweisung beachten Consulte las instrucciones de uso Consultar instruções de uso Consultare le istruzioni per l'uso De gebruiksaanwijzing raadplegen Läs bruksanvisningen Læs brugsanvisningen Les brugsanvisning før bruk Lue käyttöohjeet Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης Прочитайте инструкции по применению Sprawdź w instrukcji stosowania Olvassa el a használati útmutatót! Postupujte podle pokynů Prečítajte si návod na použitie Kullanma talimatına başvurunuz. Tutvu kasutusjuhendiga. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju Skaitykite naudojimo instrukciją Glej navodila za uporabo Pogledaj instrukcije za upotrebu A se consulta instrucțiunile de folosință Прочетете указанията за употреба Ознайомтеся з інструкціями для застосування Pogledati upute za upotrebu	Manufacturer Fabricant Hersteller Fabricante Fabricante Fabbricante Fabrikant Tilverkare Produceret af Produsent Valmistaja Κατασκευαστής Изготовлено Wytwórca Gyártó Vyrobeno Výrobca Üretici firma Toodetud Razžots Gamintojas Izdelovalec Proizvodjač Fabricat de Произведено от Виробник Proizvođač
NP	RBP
Nominal Pressure Pression nominale Nenndruck Presión nominal Pressão nominal Pressione nominale Nominale druk Nominellt tryck Nominelt tryk Nominelt trykk Nominaalipaine Ονομαστική Πίεση Номинальное давление Ciśnienie znamionowe Névleges nyomás Jmenovitý tlak Menovitý tlak Nominal Basing Nominaalrõhk Nominālais spiediens Minimalus slėgis Nominalni tlak Nominalni pritisak Presiunea nominală Номинално налягане Номинальний тиск Nominalni tlak	Rated Burst Pressure Pression nominale de rupture Zerreißdruck Presión de rotura Pressão nominal de ruptura Pressione massima di sicurezza Bepaalde scheurdruk Nominellt bristningstryck Nominel øvre trykgrænse Nominelt sprengtrykk Nimellinen rikkoutumispaine Ονομαστική Πίεση Ρήξης Расчетное давление разрыва Znamionowe ciśnienie rozrywające Becsült szakítónyomás Jmenovitý tlak prasknutí Menovitý tlak prasknutia Anma Patlama Basıncı Arvestuslik purunemisrõhk Aprēķinātais sprādziena spiediens Minimalus išplėtimo slėgis Naznačen delovni tlak Granični pritisak pucanja Presiunea nominală de explozie Номинално налягане на разкъсване Номинальний тиск розриву Nazivni tlak prsnuća

 Contents	
Contents Contenu Stück Unidades Conteúdo Unità Stuks Styck Indhold Innhold Sisältö Περιεχόμενα Содержание Zawartość Tartalom Obsah Obsah İçindekiler Sisu Satur Sudėtis Vsebina Sadržaj Conținut Зміст Вміст Sadržaj	Do not use if package is damaged Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Inhalt beschädigter Packung nicht verwenden No usar si el paquete está dañado Não usar se a embalagem estiver danificada Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is Använd inte om förpackningen är skadad Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget Må ikke brukes hvis forpakningen er ødelagt Älä käyttää jos pakkaus on vahingoittunut Μην το χρησιμοποιήσετε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη Не использовать, если упаковка повреждена Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania Ne használja, ha a csomagolás sérült! Nepoužívejte, bylo-li balení poškozeno Nepoužívať, ak je obal poškodený Paket hasarlıysa kullanmayınız Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud Nelietot, ja sterilais iepakojums ir bojāts Jei pakuotė pažeista, nenaudoti Ne uporabljajte ga, če je ovojnina poškodovana. Ne upotrebljavati ukoliko je pakovanje oštećeno A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat Не използвайте, ако опаковка е повредена Не використовувати, якщо пакування пошкоджено Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno
	
Balloon diameter Diamètre du ballon Durchmesser des Ballons Diámetro del balón Diâmetro do balão Diametro del palloncino Ballondiameter Ballongdiameter Ballondiameter Ballongdiameter Pallon halkaisija Διάμετρος μπαλονιού Диаметр баллона Średnica balonu Ballon átmérő Průměr balónku Priemer balóna Balon çapı Ballooni diameeter Balona diametrs Baliono diametras Premier balona Prečnik balona Diametrul balonului Диаметър на балона Диаметр балону Promjer balona	Balloon length Longueur du ballon Länge des Ballons Longitud de balón Comprimento do Balão Lunghezza del palloncino Ballonlengte Ballonglängd Ballonlængde Ballonglengde Pallon pituus Μήκος Μπαλονιού Длина баллона Długość balonu Ballon hossz Délka Balonku Dĺžka balóna Balon Uzunluğu Ballooni pikkus Balona garums Baliono ilgis Dolžina balona Dužina balona Lungimea balonului Дължина на балона Довжина балону Duljina balona

EC REP	
Authorized Representative in the European Community Rep. CE (Mandataire européen) Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft Representante autorizado de la Comunidad europea Representante autorizado na CE Rappresentante autorizzato nella comunità europea Gemaaktigde vertegenwoordiger in de EU (Europese Unie) Auktoriserad återförsäljare inom EU-området Autoriseret forhandler indenfor EU området Autoriseret representant i Det europeiske Fællesmarked EY edustaja Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Авторизованный представитель Европейского сообщества Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej Az Európai Közösésgben a képviselőre jogosult Zástupce Evropského společenství Predstaviteľ Európskej únie Yetkili AB temsilcisi Esindaja EL-s ES pārstāvis Įgaliotas atstovas Europos bendrijoje Zastopnik v Evropski Skupnosti Predstavnik u Evropskoj Uniji Reprezentant UE Упълномощен представител в ЕС Уповноважений представник в Европейському Союзу Ovlašteni predstavnik u europskoj zajednici	Do not resterilize Ne pas restériliser Nicht wieder sterilisieren No reesterilizar Não re-esterilizar Non risterilizzare Niet hersteriliseren Får ej omsteriliseras Må ikke resteriliseres Må ikke re-steriliseres Ei uudelleen steriloitua Να μην επαναποστερωθεί Не стерилизовать повторно Nie sterylizować ponownie Nem sterilizálható újra! Nesterilizujte opakovane Nesterilizujte Yeniden sterilize etmeyin Ärge steriliseerige uuesti Nesterilizēt atkārtoti Pakartotina! nesterilizuoti Ne resterilizirati Ne resterilisati Nu resterilizați Да не се стерилизира повторно Повторно не стерилизувати Ne ponovo sterilizirati
	
Manufacturing Site Site de fabrication Herstellungsort Lugar de fabricación Site do fabricante Sito di produzione Productielocatie Tillverkningsplats Produktionssted Produksjonssted Valmistuspaikka Τόπος Κατασκευής Произведено Miejsce produkcji Gyártóhely Misto výroby Miesto výroby Üretim Yeri Tootmiskoht Ražotne Gamybos vieta Proizvodno mesto Mesto proizvodnje Locul de Productie Место на производство Виробнича дільниця Mjesto proizvodnje	Keep dry Conserver au sec Vor Nässe schützen Mantener seco Manter seco Conservare in luogo asciutto Droog bewaren Håll torr Holdes tør Holdes tørr Pidä kuivassa Διτηρήστε το στεγνό Беречь от влаги Przechowywać w miejscu suchym Nedvességtől védett helyen tartandó Udržujte v suchu Udržujte ja suchom mieste Kuru tutunuz Hoida kuivas Sargāt no mitruma Laikyti sausoje vietoje Izogibajte se dežju Čuvati na suvom mestu A se păstra în locuri ferite de umezeală Съхранявайте на сухо Зберігати в сухому місці Držati suho

	
Keep away from sunlight Craint la chaleur Vor Sonnenlicht schützen Mantener alejado de la luz solar Manter ao resguardo da luz solar Tenere lontano da fonti di calore Niet blootstellen aan zonlicht Aktas för solljus Må ikke udsættes for sollys Unngå sollys Suojattava auringonvalolta Φυλάξτε το μακριά από το ηλιακό φως Избегать прямого солнечного света Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych Napfénytől védett helyen tartandó Chraňte pred slnečným žiarením Udržujte mimo slnečného žiarenia Güneş ışıgından uzak tutunuz Kaitsta otsese päikesevalgus eest Sargāt no saules stariem Saugoti nuo saulės šviesos Izogibajte se sončni svetlobi Ne izlagati sunčevoy svetlosti A se pástra la umbră Пазете от слънчева светлина Зберігати подалі від сонячного проміння Drżać dalej od sunčevog svjetla	Over-the-Wire type Coaxial Over-the-wire-Type Coaxial Sobre o Fio-Guia Tipo Over-the-Wire Over-de-voerdraad type Över ledare Over the wire-type Over the wire Over-the-wire Τύπου Πάνω Από Το Σύρμα Тип На Проводнике Typ over the wire Végig vezetőd්රóton futó típus Aplikace přes vodičí drát Typ s použitím cez drôt Tel Üstü Tipi Kasutamiseks juhtetraadi peal Lietojams ar stīgu Ant vielos įvedamas tipas Tip OTW (preko žice) OTW sistem dostave, koaksijalni Tipul coaxial тип По Жицата тип OTW OTW tip, koaksijalni

Rx ONLY

CAUTION: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

ATTENTION : Conformément au droit fédéral des Etats-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par ou sur prescription d'un médecin.

VORSICHT: Das Bundesgesetz in den USA beschränkt den Verkauf des Geräts auf die Verschreibung durch einen Arzt.

ATENCIÓN: La Ley Federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o bien por orden de este.

ATENÇÃO: A Lei Federal dos E.U. A. restringe a venda deste dispositivo por médicos ou por sua prescrição.

ATTENZIONE: La Legge Federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo prodotto esclusivamente ai Medici o dietro prescrizione medica.

OPGELET: In overeenstemming met de federale wetgeving (VS) mag dit hulpmiddel enkel door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

VARNING: Federal lagstiftning i USA tillåter endast att denna produkt säljs genom eller på ordination av läkare.

ADVARSEL: Ifølge amerikansk føderal lov må det te produkt kun sælges af en læge eller på ordination af en læge.

FORSIKTIG: Denne enheten kan i følge amerikansk lov kun selges til leger eller ved bestilling fra leger.

HUOM: USA:n liit tovaltion lain mukaan tämä tuote voidaan myydä vain lääkärille tai hänen määräyksestään.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι νόμοι των Η.Π.Α. περιορίζουν την πώληση αυτής της συσκευής μόνο με συνταγή ιατρού.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Федеральный закон (США) строго регламентирует продажу данного устройства только по предписанию врача.

UWAGA: Prawo federalne (U.S.A.) przewiduje, że urządzenie to może być sprzedawane tylko przez lub na zamówienie lekarza.

FIGYELMEZTETÉS: Az USA szövetségi törvénye az eszköz árusítását korlátozza, azt csak orvosi javaslatra vagy orvos előírására lehet forgalmazni.

UPOZORNENÍ: Podle amerických federálních zákonů může být toto zařízení prodáváno pouze lékařem nebo na jeho předpis.

POZOR: Federálny zákon (v USA) povoľuje predaj tohto prístroja jedine na základe požiadavky lekára.

UYARI: Eyalet yasaları (U.S.A.) bu cihazın satışını bir hekimin talebi veya siparişi ile sınırlandırmaktadır.

TÄHELEPANU! USA föderaaliseaduse järgi võib antud vahendit müüa ainult arst või arsti retsepti olemasolul.

UZMANIBU! Federala (ASV) likumdošana ierobežo šī aprīkojuma tirdzniecību tikai ārstiem vai saskaņā ar to atļauju.

ISPEJIMAS: Federalinis istatymas (JAV) draudžia gydytojams parduoti ar išrašyti šį prietaisą.

POZOR: Po zveznem zakonu (ZDA) smejo to napravu prodajati le zdravniku oz. se sme prodajati le na recept zdravnika.

MERE ZAŠTITE: Savezni (USA) zakon dozvoljava prodaju ovog proizvoda od ili po nalogu lekara.

ATTENTIE: În conformitate cu legea federală (SUA), vînderea acestui dispozitiv este permisă doar medicului sau la prescripția medicului.

ВНИМАНИЕ: Федерален закон (САЩ) регламентира продажбата на това изделие само от лекари или по тяхно предписание.

УВАГА! : Згідно з Федеральним законодавством (США), цей виріб може бути проданий лише лікарем або за його призначенням.


OPREZ: Savezni zakon (SAD-a) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili po nalogu liječnika.

[PRODUCT DESCRIPTION]

Metacross OTW is a Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) Balloon Dilatation Catheter for peripheral indications. Metacross OTW is an over the wire (OTW) type and the maximum diameter of the compatible guidewire is 0.035 inches (0.89 mm).

The distal section of this catheter consists of a balloon and dual lumen shafts (co-axial). The outer lumen is used for inflation and deflation of the balloon with contrast medium diluted with saline solution. The inner lumen (the guidewire lumen; from the distal tip to the guidewire port) is for inserting a compatible guidewire to facilitate advancing the catheter through the stenotic lesion or stent to be dilated. The proximal section is a double lumen shaft with dual luer port Manifold; one for inflation/deflation of the balloon, the other for guidewire lumen access. Inside the balloon, two radiopaque markers, which indicate the working length of the balloon, are placed to guide the physician for positioning the balloon properly in the targeted lesion under fluoroscopy. Metacross OTW is available in various balloon sizes by its diameter and length at recommended inflation pressures (Nominal pressure). Upon inflation, the balloon diameter varies according to the inflating pressure. The balloon compliance chart of Metacross OTW is provided in Table 1 at the end of this Instructions for Use. In the sterilization package, the device is equipped with the protective materials, a balloon protective tube and a stylet, which are to be removed before use. The balloon protective tube is placed over the balloon folded in a low profile and the stylet is inserted into the guidewire lumen to prevent collapsing the catheter shaft. The catheter's distal tip is tapered to facilitate the catheter's advancing into the stenotic lesion or stent.

<NAME OF EACH PART>

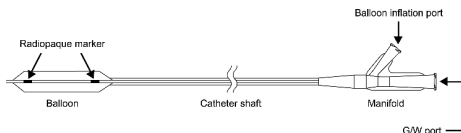

Sterile and non pyrogenic in an undamaged and unopened blister pouch. This device is sterilized by ethylene oxide.

Recommended guidewire diameter:

Maximum diameter: 0.035"(0.89 mm)

Recommended inflation pressure and maximum inflation pressure

Nominal pressure:

- Balloon diameter: smaller than 6 mm: 10 atm
- Balloon diameter: 6 mm and larger: 8 atm

Rated burst pressure:

- Balloon diameter: smaller than 5 mm: 20 atm
- Balloon diameter: 5 mm : 18 atm
- Balloon diameter: 6mm, 7 mm, 8 mm : 14 atm
- Balloon diameter: 9 mm and larger: 12 atm

[INDICATIONS]

The Metacross OTW PTA balloon dilatation catheter is intended to dilate stenosis in the iliac, femoral, ilio-femoral, popliteal, infra-popliteal and renal arteries, and for the treatment of obstructive lesions of native or synthetic arteriovenous dialysis fistulae. This device is also indicated for stent post-dilatation in the peripheral vasculature.

Note: The verification test for stent post-dilatation of Metacross OTW was conducted using Complete® SE Vascular Stent System (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) and Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation).

[CONTRA-INDICATIONS]

1. Patients who have developed anastomotic stenosis within one month after AV shunt construction.
2. Patients having lesions which communicate with a pseudoaneurysm.
3. Patients who are pregnant.
4. Patients who cannot tolerate antiplatelet therapy or anticoagulant therapy.

[WARNINGS AND PRECAUTIONS]

[Warnings]

1. This device is for single use only. Do not reuse. Do not resterilize. Do not reprocess. Reprocessing may compromise the sterility, the biocompatibility and the physical integrity of the device.
2. Do not use if the product or the unit packaging has been damaged.
3. Do not inflate the balloon exceeding the diameter of the blood vessel proximal and distal to the stenotic lesion.
4. Do not inflate the balloon to a pressure exceeding the rated burst pressure.
5. Do not use this catheter in the central circulatory system.

[Precautions related to procedures]

1. Do it carefully and slowly to remove this device out of the carrier tube and to remove protection parts from this device. Careless handling may damage the balloon and/or the catheter shaft of this device to impair balloon inflation and/or deflation.
2. Inflate the balloon with the contrast medium diluted with saline in the ratio of 1:1 (hereafter, inflation fluid). No gaseous medium such as air should be used for inflation. (Balloon may be inflated irregularly.)
3. Prior to use, expel all the air in the balloon and balloon inflation lumen and replace it with the inflation fluid. (In case of incomplete air removal, balloon inflation state can not be observed under fluoroscopy.)
4. In case of serious stenotic lesions such as calcified lesions, the blood vessel can not be dilated fully. Do not apply a pressure exceeding the rated burst pressure in such a case. (The balloon may burst and the debris may remain inside the body.)
5. As for the medical devices used in conjunction with this catheter, follow the instructions for use of such devices. (When the balloon catheter is used for post-dilatation of stent during peripheral stent placement procedure, refer to the manufacturer's instructions for use.)
6. For insertion into stent, withdrawal from stent or in-stent dilatation of the balloon, proceed with caution under fluoroscopy. (Doing so without fluoroscopy may damage this catheter or injure the blood vessel.)
7. Do not attempt to pass the Metacross OTW PTA balloon dilatation catheter through a smaller sized introducer sheath than indicated on the label. Refer to product labeling.

[Precautions during usage]

1. Use the device immediately after the sterile package is opened.
2. The entire procedure should be carried out aseptically.
3. This catheter should be used only by physicians skilled in percutaneous vascular therapy.
4. Select the catheter with appropriate balloon size (balloon diameter, balloon length) according to the following (procedures) criteria.
 - 1) The inflated balloon diameter shall not exceed the inner vessel diameter proximal and distal to the lesion.
 - 2) The length of the inflated balloon shall not exceed the length of the lesion to be treated.

(Inappropriate catheter selection may lead to acute vascular occlusion.)

5. Use this catheter only when emergency surgery can be performed at any time.
6. The physician in charge of the procedure should determine the duration and number of balloon inflations based on his/her past experiences.
7. Heparinized saline should be infused for anti-coagulation while this balloon catheter is inserted in the blood vessel.
8. Never inflate the balloon or advance the guidewire with the catheter bent or kinked.
9. Manipulate the catheter carefully in the blood vessel verifying the location and movement of its tip under fluoroscopy or DSA (Digital Subtraction Angiography) monitoring.
10. Always inflate the balloon while observing its inflation state under fluoroscopy. Inflate the balloon carefully while verifying its movement with the radiopaque markers. If any abnormality is found such as a little resistance, immovable catheter during manipulation or kinked distal tip of the guidewire, the procedure should be discontinued immediately and this catheter should be removed slowly together with the guidewire.
11. Do not insert or remove the catheter rapidly. (Operating rapidly may damage the catheter or injure the vascular intima.)
12. Do not move the catheter with the balloon inflated. (Moving the catheter with the balloon inflated may result in balloon burst or catheter shaft breakage.)
13. Do not inflate or deflate the balloon rapidly in the blood vessel. (Rapid inflation or deflation may damage the blood vessel or cause the balloon to burst resulting in the debris left inside the body.)
14. Do not use an injector (automatic injection device) for inflating the balloon.
15. Precautions should be taken to prevent any damage to the catheter by a surgical knife or scissors.
16. If any abnormality such as strong resistance is experienced while manipulating the catheter, the procedure should be discontinued immediately. The cause should be verified and appropriate measures should be taken. (Continuing the operation with excessive force may result in damage to the catheter or in vascular wall injury.)
17. Always pay attention to the patient's condition and monitor the body temperature, pulse, and breathing. When any abnormality is found, discontinue the use of the catheter immediately or take appropriate measures for the patient's condition on the discretion of the physician.
18. After use dispose the catheter as medical waste according to hospital procedures.
19. Do not use agents containing organic solvents or oleaginous contrast media. Contact with these agents may lead to damage of the catheter.
20. While manipulating this catheter, do not twist or rotate the catheter.
21. While inserting this device into the blood vessel or removing this device from the blood vessel, make sure that the balloon is completely deflated. (A device with larger and longer balloon requires a longer deflation time.)
22. If resistance is felt during post procedural withdrawal of this device, it is recommended to withdraw the entire system together with the introducer / guide sheath.
23. Always use the catheter along a guide wire inserted into the guide wire lumen.

[Operational Instructions]

Materials typically required for PTA with the Metacross OTW PTA balloon dilatation catheter include:

- Guidewire(s) of appropriate diameter and length
- Appropriate introducer/guide sheath and dilator set
- Vial of contrast medium
- Vial of sterile saline
- Inflation device with manometer
- Luer-lock syringe
- Three-way stopcock

[Operation method or instructions for use]

1. Selection of the catheter
Prior to use, verify the blood vessel inner diameter proximal and distal to the stenotic lesion under fluoroscopy, and select the catheter with appropriate balloon size. If two sizes are applicable to the diameter verified, select the smaller size.
2. Preparations
 - 1) After aseptically removing the catheter from the package container, remove the protective materials from the catheter.
 - 2) Replace the air in the balloon and balloon inflation lumen with inflation fluid according to the following procedures.
 - a) Attach the inflation device (not included in this kit) filled with the inflation fluid onto the balloon inflation port.
 - b) After applying negative pressure for approximately 10 seconds to the inflation device, direct the catheter shaft tip downward and release the negative pressure slowly to allow the fluid to fill the balloon and balloon inflation lumen and to expel the air.
 - c) When any air is found in the balloon and balloon inflation lumen, repeat the procedure b) until the air is expelled completely.
 - d) Detach the inflation device from the balloon inflation port and remove air from the cylinder of the inflation device.
 - e) Reattach the inflation device onto the balloon inflation port and maintain negative pressure. Verify that the air no longer returns into the syringe.
 - 3) Flush the guidewire lumen with heparinized saline and fill the lumen with the heparinized saline.
 - 4) Immerse the entire Metacross OTW PTA balloon dilatation catheter in saline.
3. Insertion and inflation of the balloon catheter
Prior to use, please check if this catheter is compatible to the guide catheter (not included in this kit), the introducer sheath (not included in this kit), and the guidewire (not included in this kit) by the following table.

Catalogue number	Balloon diameter (mm)	Compatible sheath (Fr/mm)	Maximum diameter for the guidewire (inch/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (excluding 200 mm Balloon Length), 7 mm (20 mm, 40 mm Balloon Length)	5Fr / 1.66 mm	0.035 inch (0.89 mm)
	6 mm (only 200 mm Balloon Length), 7 mm (excluding 20 mm, 40 mm Balloon Length), 8 mm	6 Fr / 2.00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2.33 mm	

When using the catheter inserted in the introducer sheath or guide catheter

- 1) When using the catheter in the guide catheter, loosen the hemostatic valve while keeping it tight enough to prevent blood leakage.

- 2) Gradually insert the catheter, with the balloon deflated completely, into the introducer sheath or guide catheter over the guidewire and advance to the distal periphery of the lesion. Under fluoroscopy, advance the catheter slowly to make its radiopaque marker in the balloon reach the target site.
- 3) Under fluoroscopy, verify the position of the radiopaque marker in the balloon and determine the dilatation site.
- 4) Attach the inflation device securely to the balloon inflation port.
- 5) Inflate the balloon gradually to the target diameter verifying the inflation pressure and dilate the stenotic lesion (for inflated balloon diameters, consult the balloon compliance chart provided in Table 1. at the end of this Instructions for Use).
4. Removal of the catheter
 - 1) After applying negative pressure to deflate the balloon completely, remove the catheter.
5. Re-insertion of the catheter
 - 1) If a re-insertion of the removed catheter with deflated balloon is required, ensure the balloon is completely deflated and folded before re-inserting it into the patient's blood vessel. On re-insertion use the catheter as per "Insertion and inflation of the balloon catheter" section herein.
 - 2) If any resistance is encountered while re-inserting the catheter, stop advancing it and carefully remove it out of the patient's blood vessel. Prepare to use a new Metacross OTW in accordance with the procedures provided above in this section of this Instruction for Use.

[Complications]

Device Failures:

- Balloon rupture
- Insufficient inflation / deflation of the balloon
- Breakage of the balloon and / or the catheter shaft
- Difficulty in removing the device
- Leakage of inflation fluid

Adverse Events:

- Local or systemic infections
- Local internal bleeding or hematoma
- Intimal rupture
- Vascular dissection
- Vascular perforation
- Vascular rupture
- Aneurysm
- Arrhythmia
- Acute vascular occlusion
- Venous thromboembolism
- Vasospasm
- Formation of pseudoaneurysm
- Arteriovenous fistula
- Bleeding requiring transfusion
- Allergic response to the contrast media / renal failure
- Ache or pressing pain
- Death
- Embolism
- Endocarditis
- Fever
- Hypertension / Hypotension
- Inflammation

- Myocardial Infarction
- Sepsis
- Shock
- Stroke
- Transient Ischemic Attack

[Storage and expiration date]

1. Store in a cool, dry, dark place. Avoid exposure to water, direct sunlight.
2. The expiration date is indicated on the box. Do not use after the expiration date.

[Package]

1 set/box

[Name and address of manufacturer]



Manufacturer : KANEKA CORPORATION

Address: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
TEL No.: (+81)-(0) 6-6226-5256
FAX No.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Authorized representative in the European Community:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Address: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
TEL No.: (+32)-(0) 14-256-297
FAX No.: (+32)-(0) 14-256-298

EU Distributor : TERUMO EUROPE N.V.

Address: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgium
TEL No.: (+32)-(0) 16 381 211
FAX No.: (+32)-(0) 16 400 249

All brand names are trademarks or registered trademarks of TERUMO CORPORATION and their respective owners.

Table 1. Metacross OTW Balloon Compliance Chart

Pressure (atm)	Balloon Diameter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96*	6.98*	8.00*	8.98*	9.90*	11.98*
10	3.01*	3.98*	5.06*	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35**	10.42**	12.61**
14	3.14	4.13	5.27	6.39**	7.48**	8.58**	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50**						
20	3.36**	4.38**	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

* Nominal pressure

** Rated Burst Pressure


[DESCRIPTIF DU PRODUIT]

Metacross OTW est un cathéter de dilatation à ballonnet pour l'angioplastie transluminale percutanée (PTA) périphérique. Metacross OTW est un cathéter sur guide (OTW, « over the wire ») et le diamètre maximal du guide compatible est de 0,035 pouces (0,89 mm).

La partie distale de ce cathéter est composée d'un ballonnet et d'un corps à double lumière (co-axial). La lumière externe est utilisée pour gonfler et dégonfler le ballonnet à l'aide d'un produit de contraste dilué dans du sérum physiologique. La lumière interne (lumière du guide ; de l'extrémité distale à l'orifice du guide) permet d'insérer un guide compatible afin de faciliter le passage du cathéter au travers de la lésion sténosante ou du stent à dilater. La partie proximale est constituée d'un corps à double lumière et d'une embase de connexion Luer double ; l'une pour le gonflage/ dégonflage du ballonnet, l'autre pour accéder à la lumière du guide.

À l'intérieur du ballonnet, deux marqueurs radio-opaques, indiquant la longueur utile du ballonnet, sont présents pour aider le médecin à positionner le ballonnet correctement dans la lésion cible sous radioscopie. Metacross OTW est disponible avec plusieurs tailles de ballonnet déterminant son diamètre et sa longueur aux pressions de gonflage recommandées (pression nominale). Lors du gonflage, le diamètre du ballonnet varie en fonction de la pression de gonflage. Les valeurs de compléance du ballonnet du dispositif Metacross OTW sont fournies dans le tableau 1, à la fin de ces instructions d'utilisation. Dans le conditionnement stérile, le dispositif est équipé de couches protectrices, un tube de protection du ballonnet et un stylet, qui doivent être retirés avant utilisation. Le tube de protection du ballonnet est placé sur le ballonnet, replié en position compacte, et le stylet est inséré dans la lumière du guide afin d'empêcher le corps du cathéter de s'écraser. L'extrémité distale du cathéter est fuselée pour faciliter la progression du cathéter dans la lésion sténosante ou le stent.

<NOM DE CHAQUE SEGMENT>

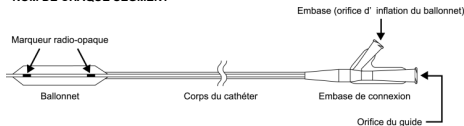

Produit fourni stérile et apyrogène dans un blister fermé et intact. Ce dispositif a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Diamètre du guide recommandé :

Diamètre maximal : 0,035" (0,89 mm)

Pression d'inflation recommandée et pression d'inflation maximale

Pression nominale :

- Diamètre du ballonnet : inférieur à 6 mm : 10 atm
- Diamètre du ballonnet : 6 mm et plus : 8 atm

Pression de rupture nominale :

- Diamètre du ballonnet : inférieur à 5 mm : 20 atm
- Diamètre du ballonnet : 5 mm : 18 atm
- Diamètre du ballonnet : 6 mm, 7 mm, 8 mm : 14 atm
- Diamètre du ballonnet : 9 mm et plus : 12 atm

[INDICATIONS]

Le cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA Metacross OTW est destiné à la dilatation des sténoses dans les artères iliaques, fémorales, ilio-fémorales, poplitées, infra-poplitées et rénales et au traitement des lésions obstructives au niveau des fistules artério-veineuses (AV) spontanées ou artificielles pour dialyse. Ce dispositif est également indiqué pour la post-dilatation du stent dans le réseau vasculaire périphérique.

Remarque : le test de vérification concernant la post-dilatation du stent avec Metacross OTW a été réalisé en utilisant le système de stent vasculaire Complete® SE (Medtronic, Inc), le système de stent

vasculaire S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) et le système de stent vasculaire auto-expansible Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[CONTRE-INDICATIONS]

1. Patients ayant développé une sténose anastomotique dans le mois suivant la mise en place d'une dérivation AV (shunt).
2. Patients présentant des lésions communiquant avec un pseudo-anévrisme.
3. Patientes enceintes.
4. Patients intolérants au traitement antiplaquettaire ou anticoagulant.

[AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS]

[Avertissements]

1. Ce dispositif est à strict usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas stériliser. Ne pas re-traiter. Le retraitement peut compromettre la stérilité, la biocompatibilité et l'intégrité fonctionnelle du dispositif.
2. Ne pas utiliser si le produit ou le conditionnement individuel est endommagé.
3. Ne pas gonfler le ballonnet au-delà du diamètre du vaisseau sanguin en amont et en aval de la sténose.
4. Ne pas gonfler le ballonnet à un niveau de pression dépassant la pression de rupture nominale.
5. Ne pas utiliser ce cathéter dans le système circulatoire central.

[Précautions à respecter lors des procédures]

1. Retirer lentement et avec précaution ce dispositif du tube support et enlever les segments de protection de ce dispositif. Une manipulation imprudente pourrait endommager le ballonnet et/ou le corps du cathéter, ce qui risquerait d'entraver l'inflation et/ou la déflation du ballonnet.
2. Gonfler le ballonnet à l'aide du produit de contraste dilué dans du sérum physiologique en proportion de 1/1 (appelé ci-après « liquide d'inflation »). Aucun produit gazeux tel que l'air ne doit être utilisé pour l'inflation. (L'inflation du ballonnet risquerait d'être irrégulière.)
3. Avant utilisation, expulser tout l'air présent dans le ballonnet et au sein de la lumière du conduit d'inflation du ballonnet et le remplacer par le liquide d'inflation. (Si l'air n'a pas été totalement éliminé, le niveau d'inflation du ballonnet ne pourra être observé sous radioscopie.)
4. En cas de lésions sténosantes graves, telles que des lésions calcifiées, le vaisseau sanguin ne peut pas être entièrement dilaté. Dans ce cas, ne pas appliquer une pression dépassant la pression de rupture nominale. (Le ballonnet risquerait d'éclater et pourrait laisser des débris dans l'organisme.)
5. S'agissant des dispositifs médicaux utilisés en association avec ce cathéter, suivre les instructions d'utilisation des dispositifs en question. (Si le cathéter à ballonnet est utilisé pour la post-dilatation du stent au cours d'une procédure de pose d'un stent périphérique, se reporter aux instructions d'utilisation du fabricant.)
6. Pour insérer le ballonnet dans le stent, le retirer ou le dilater à l'intérieur du stent, procéder avec précaution sous radioscopie. (La réalisation de ces opérations sans recours à la radioscopie pourrait endommager le cathéter ou léser le vaisseau sanguin.)
7. Ne pas tenter de faire passer le cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA Metacross OTW au travers d'un introducteur de taille inférieure à celle indiquée sur l'étiquetage. Se reporter à l'étiquetage du produit.

[Précautions à observer en cours d'utilisation]

1. Utiliser immédiatement le dispositif une fois le conditionnement stérile ouvert.
2. La totalité de la procédure doit être réalisée dans des conditions d'asepsie.
3. Ce cathéter doit être utilisé exclusivement par des médecins expérimentés dans le domaine du traitement vasculaire percutané.

4. Sélectionner le cathéter disposant d'un ballonnet de taille appropriée (diamètre du ballonnet, longueur du ballonnet) sur la base des critères (des procédures) suivants.
 - 1) Le diamètre du ballonnet gonflé ne doit pas dépasser le diamètre interne du vaisseau en amont et en aval de la lésion.
 - 2) La longueur du ballonnet gonflé ne doit pas dépasser la longueur de la lésion à traiter. (Une sélection inappropriée du cathéter pourrait entraîner une occlusion vasculaire aiguë.)
5. Utiliser ce cathéter uniquement si une intervention chirurgicale en urgence peut être pratiquée à tout moment.
6. Le médecin chargé de la procédure devra déterminer la durée et le nombre d'inflations du ballonnet sur la base de son expérience professionnelle.
7. Du sérum physiologique hépariné doit être injecté en perfusion en tant qu' anticoagulant lorsque ce cathéter à ballonnet est introduit dans le vaisseau sanguin.
8. Ne jamais gonfler le ballonnet ou faire avancer le guide si le cathéter est courbé ou plié.
9. Manipuler le cathéter avec précaution dans le vaisseau sanguin, en vérifiant la localisation et le déplacement de son extrémité sous radioscopie ou angiographie numérisée (DSA, Digital Subtraction Angiography).
10. Veiller à toujours gonfler le ballonnet en surveillant le niveau de l'inflation sous radioscopie. Gonfler le ballonnet avec précaution en vérifiant ses déplacements à l'aide des marqueurs radio-opaques. Si la moindre anomalie est observée, comme une légère résistance, un blocage du cathéter lors de la manipulation ou une piqure de l'extrémité distale du guide, la procédure doit être immédiatement interrompue et le cathéter doit être retiré lentement, conjointement avec le guide.
11. Ne pas insérer ou retirer rapidement le cathéter. (Tout déplacement brusque pourrait endommager le cathéter ou léser la paroi interne du vaisseau.)
12. Ne pas déplacer le cathéter lorsque le ballonnet est gonflé. (Si le cathéter est déplacé alors que le ballonnet est gonflé, le ballonnet pourrait éclater ou le corps du cathéter pourrait se rompre.)
13. Ne pas gonfler ou dégonfler le ballonnet rapidement dans le vaisseau sanguin. (En cas d'inflation ou de déflation rapide, le vaisseau sanguin pourrait être lésé ou le ballonnet pourrait éclater, laissant des débris dans l'organisme.)
14. Ne pas utiliser d'injecteur (appareil d'injection automatique) pour gonfler le ballonnet.
15. Prendre les précautions pour ne pas endommager le cathéter avec un bistouri ou des ciseaux chirurgicaux.
16. Si la moindre anomalie, telle une forte résistance, survient pendant la manipulation du cathéter, la procédure doit être immédiatement interrompue. La cause du problème doit être recherchée et les mesures appropriées doivent être prises. (Poursuivre l'opération en appliquant une force excessive pourrait endommager le cathéter ou léser la paroi vasculaire.)
17. Veiller à toujours prêter attention à l'état du patient et surveiller sa température corporelle, son pouls et sa respiration. Si une anomalie est observée, interrompre immédiatement l'utilisation du cathéter ou prendre les mesures adaptées à l'état du patient, à la discrétion du médecin.
18. Après utilisation, éliminer le cathéter comme il convient pour un déchet médical selon les procédures de l'hôpital.
19. N'utiliser aucun agent contenant des solvants organiques ni aucun produit de contraste oléagineux. Tout contact avec ces agents pourrait endommager le cathéter.
20. Ne pas tordre ou faire tourner le cathéter lors de sa manipulation.
21. Lors de l'insertion de ce dispositif dans le vaisseau sanguin ou de son retrait hors du vaisseau sanguin, s'assurer de la déflation totale du ballonnet. (Le temps de déflation nécessaire pour un ballonnet de taille et de longueur supérieure est plus important.)
22. Si une résistance se fait sentir lors du retrait du dispositif après la procédure, il est recommandé de retirer l'ensemble du système, l'introducteur et le guide.
23. Le cathéter doit toujours être utilisé le long d'un guide, inséré dans la lumière du guide.

[Instructions pour la procédure]

Le matériel habituellement nécessaire pour réaliser la PTA avec le cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA Metacross OTW comprend :

- Guide(s) de diamètre et de longueur appropriés
- Introducteur/guide et dilateur/appropriés
- Flacon de produit de contraste
- Flacon de sérum physiologique stérile
- Dispositif de gonflage avec manomètre
- Seringue Luer-Lock
- Robinet à trois voies

[Mode de fonctionnement ou instructions d'utilisation]

1. Sélection du cathéter
Avant utilisation, évaluer le diamètre interne du vaisseau sanguin en amont et en aval de la sténose sous radioscopie, puis choisir le cathéter disposant d'un ballonnet de taille appropriée. Si deux tailles correspondent au diamètre mesuré, choisir la plus petite.
2. Préparation
 - 1) Une fois le cathéter sorti de l'emballage dans des conditions d'asepsie, retirer les couches protectrices du cathéter.
 - 2) Remplacer l'air présent dans le ballonnet et dans la lumière du conduit d'inflation du ballonnet par le liquide d'inflation en procédant comme indiqué ci-dessous.
 - a) Raccorder le dispositif d'inflation (non fourni) rempli de liquide à l'orifice d'inflation du ballonnet.
 - b) Après avoir appliqué une pression négative pendant environ 10 secondes dans le dispositif d'inflation, orienter l'extrémité du corps du cathéter vers le bas et libérer lentement la pression négative afin de permettre au liquide de remplir le ballonnet et la lumière du conduit d'inflation du ballonnet et pour permettre l'expulsion de l'air.
 - c) Si de l'air est encore présent dans le ballonnet et la lumière du conduit d'inflation du ballonnet, répéter l'étape b) jusqu'à expulsion totale de l'air.
 - d) Déconnecter le dispositif d'inflation de l'orifice d'inflation du ballonnet et éliminer l'air présent dans le cylindre.
 - e) Raccorder à nouveau le dispositif d'inflation à l'orifice d'inflation du ballonnet et maintenir une pression négative. Vérifier que l'air ne rentre plus dans la seringue.
 - 3) Rincer la lumière du guide à l'aide de sérum physiologique hépariné et remplir la lumière de sérum physiologique hépariné.
 - 4) Immerger entièrement le cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA Metacross OTW dans du sérum physiologique.
3. Insertion du cathéter et gonflage du ballonnet
Avant utilisation, vérifier que ce cathéter est compatible avec le cathéter guide (non fourni), l'introducteur (non fourni) et le guide (non fourni) à l'aide du tableau suivant.

Référence	Diamètre du ballonnet (mm)	Introducteur compatible (Fr/mm)	Diamètre maximal du guide (pouces/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L7020CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (à l'exception des ballonnets de 200 mm de long), 7 mm (ballonnets de 20 mm, 40 mm de long)	5 Fr / 1,66 mm	0,035 pouces (0,89 mm)
	6 mm (ballonnets de 200 mm de long uniquement), 7 mm (à l'exception des ballonnets de 20 mm, 40 mm de long), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Lorsque le cathéter est inséré dans l'introducteur ou le cathéter guide:

- 1) Lorsque le cathéter est utilisé dans le cathéter guide, relâcher la valve hémostatique tout en la laissant suffisamment serrée pour éviter toute fuite de sang.
- 2) Insérer progressivement le cathéter, avec le ballonnet entièrement dégonflé, dans l'introducteur ou le cathéter guide en passant sur le guide et le faire avancer en direction de la

périphérie de la lésion, en aval de celle-ci. Sous radioscopie, faire avancer lentement le cathéter jusqu'à ce que son marqueur radio-opaque, dans le ballonnet, atteigne le site cible.

- 3) Sous radioscopie, contrôler la position du marqueur radio-opaque dans le ballonnet et repérer le site à dilater.
- 4) Fixer solidement le dispositif d'inflation sur l'orifice d'inflation du ballonnet.
- 5) Gonfler progressivement le ballonnet jusqu'à atteindre le diamètre cible tout en contrôlant la pression de gonflage et dilater la lésion sténosante (pour connaître les diamètres du ballonnet gonflé, consulter les valeurs de complianse du ballonnet fournies dans le tableau 1, à la fin de ces instructions d'utilisation).
4. Retrait du cathéter
 - 1) Après avoir appliqué une pression négative afin de dégonfler totalement le ballonnet, retirer le cathéter.
5. Ré-insertion du cathéter
 - 1) S'il est nécessaire de ré-insérer le cathéter retiré avec le ballonnet dégonflé, vérifier que le ballonnet est entièrement dégonflé et replié avant de le ré-insérer dans le vaisseau sanguin du patient. Lors de la ré-insertion, utiliser le cathéter comme indiqué dans la section « Insertion du cathéter et gonflage du ballonnet » de ce document.
 - 2) Si une résistance se fait sentir lors de la ré-insertion du cathéter, arrêter de le faire avancer et le retirer avec précaution du vaisseau sanguin du patient. Préparer l'utilisation d'un nouveau dispositif Metacross OTW conformément aux procédures décrites ci-dessus dans cette section des instructions d'utilisation.

[Complications]

Défaillances du dispositif :

- Rupture du ballonnet
- Inflation/déflation insuffisante du ballonnet
- Rupture du ballonnet et/ou du corps du cathéter
- Difficultés à retirer le dispositif
- Fuite du liquide d'inflation

Événements indésirables :

- Infections locales ou généralisées
- Hémorragie ou hématomes internes localisés
- Rupture de la paroi vasculaire interne
- Dissection vasculaire
- Perforation vasculaire
- Rupture vasculaire
- Anévrisme
- Arythmies
- Occlusion vasculaire aiguë
- Thrombo-embolie veineuse
- Vasospasme
- Formation d'un pseudo-anévrisme
- Fistule artério-veineuse
- Hémorragie nécessitant une transfusion
- Réaction allergique au produit de contraste/insuffisance rénale
- Douleur ou pression douloureuse
- Décès
- Embolie
- Endocardite
- Fièvre
- Hypertension/hypotension
- Inflammation
- Infarctus du myocarde
- Sepsie
- Choc
- Accident vasculaire cérébral
- Accident ischémique transitoire

[Stockage et date de péremption]

1. Conserver le dispositif dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Éviter toute exposition à l'eau et à la lumière directe du soleil.
2. La date de péremption est indiquée sur la boîte. Ne pas utiliser après la date de péremption.

[Conditionnement]

1 jeu/boîte

[Nom et adresse du fabricant ou représentant]



Fabricant: KANEKA CORPORATION

Adresse : 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tél. : (+81)-(0) 6-6226-5256
Fax : (+81)-(0) 6-6226-5143



Représentant agréé dans la Communauté européenne :

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresse : Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tél. : (+32)-(0) 14-256-297
Fax : (+32)-(0) 14-256-298

Distributeur dans l'UE : TERUMO EUROPE N.V.

Adresse : INTERLEUVENLAAN 40,3001 LOUVAIN, Belgique
Tél. : (+32)-(0) 16 381 211
Fax : (+32)-(0) 16 400 249

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs.

Tableau 1: Valeurs de compliance du ballonnet Metacross OTW

Pression (atm)	Diamètre du ballonnet (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										


* Pression nominale

** Pression de rupture

[PRODUKTBESCHREIBUNG]

Metacross OTW ist ein Ballondilatationskatheter zur perkutanen transluminalen Angioplastie (PTA) in peripheren Gefäßen. Metacross OTW ist ein Ballondilatationskatheter vom OTW (Over The Wire)-Typ. Der maximale Durchmesser des kompatiblen Führungsdrahts beträgt 0.035 inch. (0,89 mm). Der distale Teil dieses Katheters besteht aus einem Ballon und dualen Lumenschäften (koaxial). Das äußere Lumen dient zur Inflation und Deflation des Ballons mit einem mit Kochsalzlösung verdünnten Kontrastmittel. Das innere Lumen (das Führungsdrahtlumen; von der distalen Spitze bis zum Führungsdrahtport) dient zum Einführen eines kompatiblen Führungsdrahts, um das Vorschieben des Katheters durch die stenotische Läsion oder den zu dilatierenden Stent zu vereinfachen. Der proximale Teil ist ein doppelter Lumenschacht mit einem doppelten Luer-Port-Hub – einem für die Inflation/Deflation des Ballons, der andere für den Lumenzugang des Führungsdrahtes. Im Ballon sind zwei röntgendichte Marker, welche die Arbeitslänge des Ballons anzeigen, platziert, um den Arzt bei der korrekten Positionierung des Ballons unter Durchleuchtung zu unterstützen. Metacross OTW ist in verschiedenen Ballongrößen gemäß dem entsprechenden Durchmesser und der entsprechenden Länge bei den empfohlenen Inflationsdrücken (Nenndruck) erhältlich. Bei der Inflation verändert sich der Ballondurchmesser gemäß dem Inflationsdruck. Das Ballon-Compliance-Diagramm des Metacross OTW finden Sie in Tabelle 1 am Ende dieser Gebrauchsanweisung. In der sterilen Verpackung ist der Ballonkatheter mit den Schutzvorrichtungen, einem Ballon-Schutztubus und einem Mandrin, versehen, die vor dem Gebrauch entfernt werden müssen. Der Ballon-Schutztubus ist über den flach zusammengefalteten Ballon gezogen; der Mandrin ist in das Führungsdrahtlumen eingeführt, um ein Kollabieren des Katheterschafts zu verhindern. Die distale Spitze des Katheters ist konisch, um das Vorschieben des Katheters in die stenotische Läsion oder den Stent zu vereinfachen.

<BENENNUNG DER EINZELNEN BESTANDTEILE>

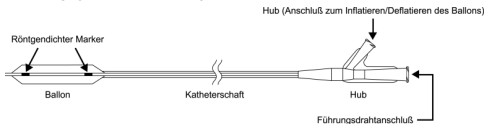

Steril und in unbeschädigter und ungeöffneter Blisterverpackung. Dieses Produkt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert.

Empfohlener Führungsdrahtdurchmesser:

Maximaler Durchmesser: 0.035" (0,89 mm)

Empfohlener und maximaler Inflationsdruck

Nominaldruck:

- Ballondurchmesser: kleiner als 6 mm: 10 atm
- Ballondurchmesser: 6 mm und größer: 8 atm

Nennberstdruck:

- Ballondurchmesser: kleiner als 5 mm: 20 atm
- Ballondurchmesser: 5 mm: 18 atm
- Ballondurchmesser: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Ballondurchmesser: 9 mm und größer: 12 atm

[INDIKATIONEN]

Der Metacross OTW PTA-Ballondilatationskatheter ist vorgesehen zur Dilatation von Stenosen in der A. iliaca, A. femoralis, A. poplitea, A. infra-poplitea und der A. renalis sowie für die Behandlungen von obstruktiven Läsionen nativer oder synthetischer arteriovenöser Dialysefisteln. Das Produkt ist zudem für die Post-Dilatation von Stents in peripheren Gefäßen zugelassen.

Hinweis: Der Verifizierungstest für die Stent-Postdilatation des Metacross OTW wurde mithilfe des Vaskulären Stentsystems Complete® SE (Medtronic, Inc), des vaskulären Stentsystems S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) und des

selbstexpandierenden vaskulären Stent-Systems Epic™ (Boston Scientific Corporation) durchgeführt.

[KONTRAINDIKATIONEN]

1. Bei Patienten, die innerhalb von einem Monat nach Anlage eines arteriovenösen Shunts eine Stenose im Bereich der Anastomose entwickelt haben.
2. Bei Patienten, die mit einem Pseudoaneurysma kommunizierende Läsionen aufweisen.
3. Bei schwangeren Patientinnen.
4. Bei Patienten, die keine plättchenhemmende Therapie oder Antikoagulationstherapie vertragen.

[WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN]

[Warnungen]

1. Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen. Nicht wiederverwenden. Nicht resterilisieren. Nicht wiederaufbereiten. Das Wiederaufbereiten kann die Sterilität, die Biokompatibilität und die physikalische Integrität des Produktes beeinträchtigen.
2. Nicht verwenden, wenn das Produkt oder seine Verpackung beschädigt ist.
3. Der inflatierte Ballon darf den inneren Gefäßdurchmesser proximal und distal der Läsion nicht überschreiten
4. Den Ballon nicht weiter als bis zum Nennberstdruck inflatieren.
5. Dieser Katheter darf nicht am zentralen Kreislaufsystem eingesetzt werden.

[Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Verfahren]

1. Den Ballonkatheter vorsichtig und langsam aus dem Schutzhrohr entnehmen und die Schutzelemente entfernen. Durch unachtsame Handhabung kann der Ballon und/oder der Katheterschaft des Ballons beschädigt werden, was die Inflation und/oder Deflation des Ballons beeinträchtigt.
2. Den Ballon nur mit Kontrastmittel, das im Verhältnis 1:1 mit Kochsalzlösung verdünnt wurde befüllen (nachstehend als „Inflationsflüssigkeit“ bezeichnet). Zur Inflation sollte kein gasförmiges Medium, wie Luft, verwendet werden. (Der Ballon kann sich ungleichmäßig füllen.)
3. Vor dem Gebrauch sämtliche Luft aus dem Ballon und dem Inflationslumen entfernen und durch Inflationsflüssigkeit ersetzen. (Wenn die Luft nicht vollständig entfernt wird, kann der Inflationsstatus des Ballons nicht unter Durchleuchtung beobachtet werden.)
4. In Fällen von schweren stenotischen Läsionen, wie kalifizierten Läsionen, kann das Blutgefäß nicht vollständig dilatiert werden. In diesem Fall keinen Druck ausüben, der den Nennberstdruck übersteigt. (Der Ballon kann bersten und Bestandteile können im Körper verbleiben.)
5. Für die Medizinprodukte, die zusammen mit diesem Katheter verwendet werden, sind die jeweiligen Gebrauchsanweisungen zu befolgen. (Weitere Informationen zum Verwenden des Ballonkatheters für die Post-Dilatation von Stents bei der peripheren Stentplatzierung finden Sie in der Herstelleranleitung.)
6. Beim Einführen des Ballons in den Stent, Zurückziehen des Ballons aus dem Stent oder der Dilatation des Ballons im Stent gehen Sie vorsichtig und unter Durchleuchtung vor. (Bei einer Manipulation ohne Durchleuchtung kann der Katheter beschädigt oder das Gefäß verletzt werden.)
7. Versuchen Sie nicht, den Metacross OTW PTA-Ballondilatationskatheter durch eine Einführschleuse von einer kleineren Größe als auf dem Typenschild angegeben einzuführen. Siehe das Typenschild am Produkt.

[Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch]

1. Produkt unmittelbar nach Öffnen der sterilen Verpackung verwenden.
2. Der gesamte Eingriff ist unter sterilen Bedingungen durchzuführen.

3. Dieser Katheter sollte nur von Ärzten verwendet werden, die mit der perkutanen Gefäßtherapie vertraut sind.
4. Katheter mit geeigneter Ballongröße (Ballondurchmesser, Ballonlänge) gemäß den folgenden (Operations-)Kriterien auswählen.
 - 1) Der Durchmesser des inflatierten Ballons darf den inneren Gefäßdurchmesser proximal und distal der Läsion nicht überschreiten.
 - 2) Die Länge des inflatierten Ballons darf die Länge der zu behandelnden Läsion nicht überschreiten.
(Die Wahl eines ungeeigneten Katheters kann zu einer akuten vaskulären Okklusion führen.)
5. Dieser Katheter darf nur verwendet werden, wenn zu jedem Zeitpunkt eine Notoperation durchgeführt werden kann.
6. Der operierende Arzt sollte die Dauer und die Anzahl der Balloninflationen aufgrund seiner Erfahrungen festlegen.
7. Während der Katheter ins Blutgefäß eingeführt ist, sollte heparinisierte Kochsalzlösung zur Gerinnungshemmung infundiert werden.
8. Wenn der Katheter verbogen oder geknickt ist, darf der Ballon nicht inflatiert und der Führungsdraht nicht vorgeschoben werden.
9. Den Katheter vorsichtig im Blutgefäß bewegen. Dabei die Position und die Bewegung seiner Spitze unter Durchleuchtung oder mit einem DSA-Monitor (Digitale Subtraktionsangiographie) überwachen.
10. Den Ballon stets unter Beobachtung seines Inflationsstatus unter Durchleuchtung befüllen. Ballon vorsichtig inflatieren und seine Bewegung anhand der röntgengedichten Marker kontrollieren. Wenn Anomalien (z. B. ein leichter Widerstand, ein Katheter, der sich nicht bewegen lässt, oder eine geknickte distale Spitze des Führungsdrahts) auftreten, sollte die Prozedur sofort abgebrochen und der Katheter zusammen mit dem Führungsdraht langsam entfernt werden.
11. Der Katheter darf nicht schnell eingeführt oder entfernt werden.
(Durch ein schnelles bewegen kann der Katheter beschädigt oder die Tunica intima verletzt werden.)
12. Bewegen Sie den Dilatationskatheter erst, nachdem der Ballon vollständig deflatiert ist. (Wenn der Katheter mit gefülltem Ballon bewegt wird, kann der Ballon platzen oder der Katheterschaft brechen.)
13. Der Ballon darf im Gefäß nicht schnell gefüllt oder entleert werden.
(Schnelles Füllen oder Entleeren kann dazu führen, dass das Gefäß beschädigt wird oder der Ballon platzt und Teile des Ballons im Körper verbleiben.)
14. Keinen Injektor (automatisches Injektionsgerät) zur Inflation des Ballons verwenden.
15. Es sollten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um Beschädigungen durch ein chirurgisches Messer oder eine chirurgische Schere am Katheter zu vermeiden.
16. Wenn beim Bewegen des Katheters Anomalien, wie beispielsweise ein starker Widerstand, auftreten, muss das Verfahren sofort eingestellt werden. Die Ursache sollte festgestellt und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. (Die Fortsetzung des Eingriffs mit übermäßiger Kraftanwendung kann zu Schäden am Katheter oder Verletzungen der Gefäßwand führen.)
17. Stets auf den Zustand des Patienten achten und Körpertemperatur, Puls und Atmung überwachen. Bei Anomalien sollte der Arzt nach seinem Ermessen den Einsatz des Katheters sofort beenden oder entsprechende Maßnahmen ergreifen, um den Zustand des Patienten zu verbessern.
18. Nach dem Gebrauch ist der Katheter gemäß den Standardverfahren des Krankenhauses als medizinischer Abfall zu entsorgen.
19. Keine Substanzen mit organischen Lösungsmitteln oder ölhaltige Kontrastmittel verwenden. Ein Kontakt mit diesen Mitteln kann zu Schäden am Katheter führen.
20. Bei der Betätigung dieses Katheters den Katheter nicht verdrehen oder verwickeln
21. Beim Einführen dieses Produktes in das Blutgefäß oder beim Zurückziehen dieses Produktes aus dem Blutgefäß sicherstellen,

dass der Ballon vollständig deflatiert wird. (Bei größeren und längeren Ballonen ist eine längere Zeit zur Deflation erforderlich.)

22. Wenn beim Zurückziehen nach der Intervention ein Widerstand zu spüren ist, wird empfohlen, das gesamte System zusammen als eine Einheit mit Einführ-/Führungsschleuse zurückzuziehen.
23. Den Katheter stets über einen Führungsdraht, der in das Führungsdrathlumen eingeführt ist, verwenden.

Betriebsanleitung

Die Materialien, die üblicherweise für eine PTA mit dem Metacross OTW PTA-Ballondilatationskatheter benötigt werden, umfassen u. a. Folgendes:

- Führungsdraht (Führungsdrähte) von geeignetem Durchmesser und adäquater Länge
- Geeignete Einführ-/Führungsschleuse und Dilator-Set
- Fläschchen mit Kontrastmittel
- Fläschchen mit steriler Kochsalzlösung
- Inflationsgerät mit Manometer
- Luer-Lock-Spritze
- Drei-Wege-Hahn

[Bedienung oder Gebrauchsanweisung]

1. Wahl des Katheters
Vor dem Gebrauch unter Durchleuchtung den Innendurchmesser des Gefäßes proximal und distal zur stenotischen Läsion bestimmen und den Katheter mit der geeigneten Ballongröße wählen. Falls zwei Größen für den ermittelten Durchmesser in Frage kommen, sollte die kleinere gewählt werden.
2. Vorbereitungen
 - 1) Nachdem der Katheter unter aseptischen Bedingungen aus seiner Verpackung entnommen wurde, ist das Schutzmaterial vom Ballonkatheter zu entfernen.
 - 2) Die Luft im Ballon und Inflationslumen gemäß den folgenden Schritten durch Inflationsflüssigkeit ersetzen:
 - a) Das mit Inflationsflüssigkeit gefüllte Inflationsgerät (nicht in diesem Set enthalten) an den Füllanschluss anschließen.
 - b) Ca. 10 Sekunden lang Unterdruck an das Inflationsgerät anlegen. Anschließend die Katheterschaftspitze nach unten halten und den Unterdruck langsam entweichen lassen, damit die Flüssigkeit den Ballon und das Inflationslumen füllen und die Luft verdrängen kann.
 - c) Wenn sich nach dem Befüllen des Ballons mit der Inflationsflüssigkeit noch Luft im Ballon oder am Anschlusstück befindet, ist Schritt b) so lange zu wiederholen, bis die Luft vollständig entfernt ist.
 - d) Inflationsgerät vom Füllanschluss abnehmen und die Luft im Zylinder des Inflationsgeräts entfernen.
 - e) Inflationsgerät wieder am Inflationsanschluss des Ballons anbringen und den Unterdruck beibehalten. Sicherstellen, dass die Luft nicht mehr in die Spritze zurückkehrt.
 - 3) Das Lumen des Führungsdrahtes mit heparinisierte Kochsalzlösung spülen und dann mit der heparinisierten Kochsalzlösung füllen.
 - 4) Den gesamten Metacross OTW PTA-Ballondilatationskatheter in Kochsalzlösung eintauchen.
3. Einführung und Inflation des Ballonkatheters
Prüfen Sie vor dem Gebrauch gemäß der folgenden Tabelle, ob dieser Katheter mit dem Führungskatheter (in diesem Kit nicht enthalten), der Einführschleuse (in diesem Kit nicht enthalten) und dem Führungsdraht (in diesem Kit nicht enthalten) kompatibel ist.

Katalognummer	Ballondurchmesser (mm)	Kompatible Schleuse (Fr/mm)	Maximaler Führungsdrahtdurchmesser (inch./mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (außer Ballonlänge 200 mm), 7 mm (Ballonlängen 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0.035 inch. (0,89 mm)
	6 mm (nur Ballonlänge 200 mm), 7 mm (außer Ballonlängen 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Verwendung des in die Einführschleuse oder den Führungskatheter eingeführten Katheter

- 1) Bei Verwendung des Katheters im Führungskatheter:
Hämostatisches Ventil lockern, aber so stark angezogen lassen, dass kein Blut austritt.
- 2) Den Katheter langsam und mit vollständig deflatiertem Ballon in die Einführschleuse einführen. Den Katheter über einen Führungsdraht in die distale Peripherie der Läsion vorschieben. Den Katheter langsam und unter Durchleuchtung vorschieben, damit sein röntgendichter Marker im Ballon die Zielposition erreicht.
- 3) Unter Durchleuchtung die Position des röntgendichten Markers im Ballon verifizieren und die Dilatationsstelle bestimmen.
- 4) Das Inflationsgerät sicher am Inflationsanschluss des Ballons anschließen.
- 5) Ballon allmählich unter Kontrolle des Inflationsdrucks bis zum Zieldurchmesser füllen und die stenotische Läsion aufweiten (die Durchmesser des inflatierten Ballons finden Sie im Ballon-Compliance-Diagramm in Tabelle 1 am Ende dieser Gebrauchsanweisung).
4. Entfernen des Katheters
 - 1) Unterdruck anlegen, um den Ballon vollständig zu entleeren, und dann den Katheter entfernen.
5. Wiedereinführung des Katheters
 - 1) Wenn eine Wiedereinführung des entfernten Katheters mit dem deflatierten Ballon erforderlich ist, sicherstellen, dass der Ballon vollständig deflatiert und zusammengefalt ist, bevor er wieder in das Blutgefäß des Patienten eingeführt wird. Nach der Wiedereinführung den Katheter gemäß dem Abschnitt „Einführung und Inflation des Ballonkatheters“ in dieser Bedienungsanleitung verwenden.
 - 2) Wenn bei der Wiedereinführung des Katheters Widerstand zu spüren ist, den Katheter nicht weiter vorschieben. Stattdessen den Katheter vorsichtig aus dem Blutgefäß des Patienten entfernen. Die Verwendung eines neuen Metacross OTW gemäß den oben in diesem Abschnitt der Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren vorbereiten.

[Komplikationen]

Produktversagen:

- Ballonruptur
- Unzureichende Inflation/Deflation des Ballons
- Bruch des Ballons und/oder des Katheterschafts
- Probleme beim Zurückziehen des Produktes
- Austreten von Inflationsflüssigkeit

Unerwünschte Ereignisse:

- Lokale oder systemische Infektionen
- Lokale innere Blutungen oder Hämatome
- Intimaruptur
- Gefäßdissektion
- Gefäßperforation
- Gefäßruptur
- Aneurysma
- Arrhythmie
- Akuter Gefäßverschluss
- Venöse Thromboembolie
- Vasospasmus
- Bildung eines Pseudoaneurysmas
- Arteriovenöse Fistel
- Blutungen, die eine Transfusion erfordern
- Allergische Reaktion auf das Kontrastmittel/Nierenversagen
- Anhaltender oder drückender Schmerz
- Tod
- Embolie
- Endokarditis
- Fieber
- Hypotension/Hypertension
- Entzündung
- Myokardinfarkt
- Sepsis
- Schock

- Schlaganfall
- ischämische Attacke (TIA)

[Aufbewahrung und Verfallsdatum]

1. An einem kühlen, trocken und dunklen Ort aufbewahren. Das Produkt vor Wasser und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
2. Das Verfallsdatum ist auf der Schachtel angegeben. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

[Packung]

1 Set/Schachtel

[Name und Adresse des Herstellers oder Vertreters]



Hersteller: KANEKA CORPORATION

Adresse: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN

TEL-Nr.: (+81)-(0) 6-6226-5256

FAX-Nr.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Union:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresse: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

TEL-Nr.: (+32)-(0) 14-256-297

FAX-Nr.: (+32)-(0) 14-256-298

Vertrieb, EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresse: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, Belgien

TEL-Nr.: (+32)-(0) 16 381 211

FAX-Nr.: (+32)-(0) 16 400 249

Alle Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von TERUMO CORPORATION und ihrer jeweiligen Inhaber.

Tabelle 1: Compliance-Diagramm für Metacross OTW -Ballone

Druck (atm)	Ballondurchmesser (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										


* Nominaldruck

** Nennberstdruck

[DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO]

Metacross OTW es un catéter de dilatación de balón para angioplastia transluminal percutánea (ATP) en indicaciones periféricas. Metacross OTW es un tipo de catéter sobre guía (OTW) y el diámetro máximo de la guía compatible es de 0.035 pulgadas (0.89 mm). La sección distal de este catéter se compone de un balón y de un eje de doble lumen (coaxial). El lumen externo se utiliza para inflar y desinflar el balón con medio de contraste diluido en solución salina. El lumen interior (el lumen de la guía; desde la punta distal hasta el puerto de la guía) es para insertar una guía compatible y facilitar el avance del catéter a través de la lesión estenótica o stent que hay que dilatar. La sección proximal de este catéter es un eje de doble lumen con una llave de doble puerto Luer; uno para inflar/desinflar el balón y el otro para acceder al lumen de la guía. Dentro del balón hay colocados dos marcadores radiopacos que indican la longitud de trabajo del balón y sirven para guiar al médico en el posicionado correcto del balón en la lesión meta bajo fluoroscopia. Metacross OTW está disponible en diferentes tamaños de balón según el diámetro y longitud a las presión de inflado recomendada (presión nominal). Tras el inflado, el diámetro del balón varía en función de la presión de inflado. La tabla de presiones de rotura del balón Metacross OTW es la Tabla 1 que se encuentra al final de estas Instrucciones de uso. En el envase de esterilización el producto cuenta con materiales de protección, un tubo protector de balón y una guía que se deben quitar antes del uso. El tubo protector del balón está colocado sobre el balón plegado de bajo perfil y la guía está insertada en el lumen de la guía para evitar que el eje del catéter se rompa. La punta distal del catéter está tapada para facilitar el avance del catéter hacia la lesión estenótica o stent.

<NOMBRE DE CADA PARTE>

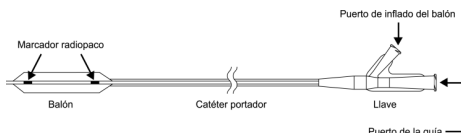

Estéril y no pirógeno en blíster no dañado y cerrado. Este producto se ha esterilizado con óxido de etileno.

Diámetro recomendado de la guía:

Diámetro máximo: 0,035" (0,89 mm)

Presión de inflado recomendada y presión máxima de inflado

Presión nominal:

- Diámetro del balón: inferior a 6 mm: 10 atm
- Diámetro del balón: 6 mm o más: 8 atm

Presión de ruptura

- Diámetro del balón: inferior a 5 mm: 20 atm
- Diámetro del balón: 5 mm: 18 atm
- Diámetro del balón: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Diámetro del balón: 9 mm o más: 12 atm

[INDICACIONES]

El catéter de dilatación de balón para ATP Metacross OTW tiene como función la dilatación de la estenosis en las arterias ilíaca, femoral, poplitea, infrapoplíteas y renal, así como el tratamiento de lesiones oclusivas de fistulas arteriovenosas nativas o sintéticas. Este producto también está indicado para la postdilatación de la endoprótesis en la vasculatura periférica.

Nota: el ensayo de verificación de stent postdilatación de Metacross OTW se ha llevado a cabo utilizando el Sistema de Stent Vascular Complete® SE (Medtronic, Inc), el Sistema de Stent Vascular S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) y el Sistema de Stent Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System auto-expandible Vascular (Boston Scientific Corporation).

[CONTRAINDICACIONES]

1. Pacientes que hayan sufrido una estenosis anastomótica dentro del mes siguiente a la derivación arteriovenosa.
2. Pacientes que tengan lesiones que se comunican con un pseudoaneurisma.
3. Pacientes embarazadas.
4. Pacientes que no toleran un tratamiento antiplaquetario o una terapia anticoagulante.

[ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES]

[Advertencias]

1. Este producto es para un solo uso. No reutilizar. No reesterilizar. No reprocesar. El reprocesamiento puede comprometer la esterilidad, la biocompatibilidad y la integridad física del producto.
2. No utilizar si el envase del producto o de la unidad está dañado.
3. No inflar el balón más allá del diámetro del vaso sanguíneo proximal y distal respecto a la lesión estenótica.
4. No inflar el balón a una presión que sobrepase la presión de estallido.
5. No utilizar este catéter en el sistema circulatorio central.

[Precauciones relacionadas con los procedimientos]

1. Saque el producto con cuidado y lentamente del tubo portador y retire las piezas de protección. Si se maneja sin cuidado, se puede dañar el balón y/o el eje del catéter del producto, perjudicando el inflado y/o desinflado del balón.
2. Infle el balón con un medio de contraste diluido en solución salina en proporción de 1:1 (en lo sucesivo, el "fluido de inflado"). No se debe utilizar un medio gaseoso, como por ejemplo el aire, para el inflado. (El balón podría inflarse de forma irregular).
3. Antes de su uso, extraiga todo el aire del balón y el lumen de inflado del balón, y sustitúyalo por el fluido de inflado. (Si no se extrae el aire por completo, no se podrá observar el estado de inflado del balón bajo fluoroscopia).
4. En caso de lesiones estenóticas graves, tales como lesiones calcificadas, el vaso sanguíneo no puede dilatarse totalmente. En ese caso, no aplique una presión superior a la presión de estallido. (El balón podría explotar y quedar los restos dentro del cuerpo).
5. En cuanto a los dispositivos médicos utilizados en combinación con este catéter, hay que seguir las instrucciones de uso de dichos dispositivos. (Cuando se usa el catéter de balón para la postdilatación de la endoprótesis durante el procedimiento de colocación periférica de la endoprótesis, es necesario consultar las instrucciones de uso del fabricante).
6. Para la inserción en la endoprótesis, la retirada de la endoprótesis o la dilatación del balón en la endoprótesis, hay proceder con precaución bajo fluoroscopia. (Si esto se realiza sin fluoroscopia, se puede dañar este catéter o lesionar el vaso sanguíneo).
7. No intente pasar el catéter de dilatación de balón para ATP Metacross OTW a través de una vaina de un introductor de un tamaño menor al indicado en la etiqueta. Consulte la etiqueta del producto.

[Precauciones durante el uso]

1. Utilizar el dispositivo inmediatamente después de la apertura del envase estéril.
2. Todo el procedimiento deberá realizarse en condiciones asepticas.
3. Este catéter solo debe ser utilizado por médicos especializados en terapia vascular percutánea.
4. Seleccione el catéter con el tamaño de balón adecuado (diámetro y longitud del balón) de acuerdo con los siguientes criterios (procedimientos).
 - 1) El diámetro del balón inflado no debe sobrepasar el diámetro interior del vaso proximal y distal respecto a la lesión.
 - 2) La longitud del balón inflado no debe sobrepasar la longitud de la lesión que se vaya a tratar.

(Una selección inadecuada del catéter puede provocar una oclusión vascular aguda).

5. Utilizar este catéter solo cuando se pueda realizar una cirugía de urgencia en cualquier momento.
6. El médico encargado del procedimiento debe determinar la duración y el número de inflados del balón basándose en su experiencia previa.
7. Se debe infundir suero salino heparinizado como anticoagulante mientras se inserta el catéter de balón en el vaso sanguíneo.
8. No inflar nunca el balón o hacer avanzar la guía con el catéter doblado o torcido.
9. Manipular cuidadosamente el catéter en el vaso sanguíneo verificando la ubicación y el movimiento de la punta bajo fluoroscopia o monitor de DSA (angiografía por sustracción digital).
10. Inflar siempre el balón observando su estado de inflado bajo fluoroscopia. Inflar el balón con cuidado verificando su movimiento con los marcadores radiopacos. Si se detecta alguna irregularidad, como una leve resistencia, catéter no movable durante la manipulación o punta distal de la guía torcida, se debe interrumpir inmediatamente el procedimiento y se debe quitar lentamente el catéter junto con la guía.
11. No insertar ni quitar rápido el catéter. (Si se actúa muy rápido, se puede dañar el catéter o lesionar la íntima vascular).
12. No mueva el catéter con el balón inflado. (Si se mueve el catéter con el balón inflado, puede estallar el balón o romperse el eje del catéter).
13. No inflar o desinflar rápido el balón en el vaso sanguíneo. (El inflado o desinflado rápido puede dañar el vaso sanguíneo o hacer que estalle el balón quedando los restos en el interior del cuerpo).
14. No utilizar un inyector (dispositivo de inyección automático) para inflar el balón.
15. Se deben tomar precauciones para evitar cualquier daño al catéter con el bisturí o las tijeras.
16. Si se detecta alguna irregularidad, como una fuerte resistencia mientras se manipula el catéter, se debe interrumpir inmediatamente el procedimiento. Se deberá verificar la causa y se deberán tomar las medidas adecuadas. (Si se continúa el procedimiento con una fuerza excesiva, se puede dañar el catéter o lesionar la pared vascular).
17. Hay que prestar atención siempre al estado del paciente y controlar la temperatura corporal, el pulso y la respiración. Cuando se detecte alguna irregularidad, interrumpir inmediatamente el uso del catéter o tomar las medidas adecuadas en función del estado del paciente y a discreción del médico.
18. Tras el uso, desechar el catéter como un residuo médico de conformidad con los procedimientos hospitalarios.
19. No utilice agentes que contengan disolventes orgánicos o medios de contraste oleaginosos. El contacto con estos agentes puede producir daños en el catéter.
20. Durante su manipulación, no tuerza ni gire el catéter.
21. Durante la inserción de este dispositivo en el vaso sanguíneo o su retirada del mismo, hay que asegurarse de que el balón esté completamente desinflado. (Un dispositivo con un balón más grande y más largo requiere un tiempo de desinflado mayor).
22. Si se siente resistencia durante la retirada del dispositivo después del procedimiento, se recomienda retirar todo el sistema, junto con la vaina introductora/guía.
23. Utilice siempre el catéter junto una guía insertada en la luz de la guía.

[Instrucciones de funcionamiento]

Entre los materiales que se requieren normalmente para ATP con el catéter de dilatación de balón para ATP Metacross OTW, se incluyen:

- Guía(s) de diámetro y longitud adecuados
- Vaina introductora/guía adecuada y juego de dilatadores
- Vial del medio de contraste
- Vial de suero salino esterilizado
- Dispositivo de inflado con manómetro
- Jeringuilla con bloqueo Luer
- Válvula de tres vías

[Método de manipulación o instrucciones de uso]

1. Selección del catéter
Antes del uso y bajo fluoroscopia, verificar el diámetro interior del vaso sanguíneo proximal y distal respecto a la lesiónestenótica y seleccionar el catéter con el tamaño de balón adecuado. Si se pueden utilizar dos medidas con el diámetro verificado, seleccionar el tamaño más pequeño.
2. Preparación
 - 1) Tras haber sacado asépticamente el catéter del contenedor, retirar el material protector del catéter.
 - 2) Sustituir el aire del balón y el lumen de inflado del balón conforme al siguiente procedimiento.
 - a) Conectar el dispositivo de inflado (no incluido en el kit), lleno de fluido de inflado al puerto de inflado del balón.
 - b) Tras aplicar presión negativa durante aproximadamente 10 segundos al dispositivo de inflado, dirigir la punta del eje del catéter hacia abajo y liberar la presión negativa lentamente para permitir que el fluido llene el balón y el lumen de inflado del balón, y expela el aire.
 - c) Si hay aire en el balón y en el lumen de inflado del balón, repetir el procedimiento b) hasta que el aire sea expelido por completo.
 - d) Desconectar el dispositivo de inflado del puerto de inflado del balón y quitar el aire del cilindro del dispositivo de inflado.
 - e) Volver a conectar el dispositivo de inflado en el puerto de inflado del balón y mantener presión negativa. Verificar que el aire ya no regresa a la jeringuilla.
 - 3) Enjuagar la luz de la guía con una solución salina heparinizada y llenar el lumen con ella.
 - 4) Sumergir todo el catéter de dilatación de balón para ATP Metacross OTW en la solución salina.
3. Inserción e inflado del catéter de balón
Antes de su uso, compruebe si el catéter es compatible con el catéter guía (no incluido en este kit), el introductor de vaina (no incluido en este kit) y la guía (no incluida en este kit), en la tabla siguiente.

Número de referencia	Diámetro del balón (mm)	Vaina compatible (Fr/mm)	Diámetro máximo de la guía (pulgadas/mm)
BDL30020SW ~ BDL70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (excluida la longitud de balón de 200 mm), 7 mm (longitud de balón 20 mm y 40 mm)	5 Fr / 1.66 mm	(0.035 pulgadas / 0.89 mm)
	6 mm (solo longitud de balón de 200 mm), 7 mm (excluida longitud de balón de 20 mm y 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2.00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2.33 mm	

Si se usa el catéter insertado en el introductor de vaina o el catéter guía

- 1) Si se usa el catéter en el catéter guía, aflojar la válvula hemostática manteniéndola a la vez lo suficientemente apretada como para evitar que salga sangre.
- 2) Insertar el catéter poco a poco, con el balón completamente desinflado, en la vaina introductora o el catéter guía sobre la guía y avanzar hasta la periferia distal de la lesión. Bajo fluoroscopia, avanzar el catéter lentamente para que su marcador radiopaco en el balón alcance el punto deseado.
- 3) Bajo fluoroscopia, verificar la posición del marcador radiopaco en el balón y determinar el sitio de dilatación.
- 4) Conectar el dispositivo de inflado de forma segura al puerto de inflado del balón.
- 5) Inflar el balón gradualmente hasta llegar al diámetro objetivo, verificando la presión de inflado, y dilatar la lesiónestenótica (para saber los diámetros de inflado del balón, consultar la tabla de presión de rotura del balón de la Tabla 1. al final de estas Instrucciones de Uso).

4. Extracción del catéter

- 1) Tras aplicar presión negativa para desinflar el balón por completo, quitar el catéter.

5. Reinserción del catéter

- 1) Si es necesario volver a insertar el catéter con el balón desinflado que se ha quitado, asegurarse de que el balón está completamente desinflado y plegado antes de volver a insertarlo en el vaso sanguíneo del paciente. Para saber cómo reinsertar el catéter, consultar la sección "Inserción e inflado del catéter de balón".
- 2) Si se percibe cualquier resistencia al reinsertar el catéter, detener el avance y sacarlo con cuidado del vaso sanguíneo del paciente. Preparar un nuevo Metacross OTW para usarlo conforme a los procedimientos descritos más arriba de esta sección de la Instrucciones de Uso.



Representante autorizado en la Comunidad Europea:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Dirección: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

N.º TELF.: (+32)-(0) 14-256-297

N.º FAX: (+32)-(0) 14-256-298

Distribuidor para la UE: TERUMO EUROPE N.V.

Dirección: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LOVAINA, Bélgica

N.º TELF.: (+32)-(0) 16 381 211

N.º FAX: (+32)-(0) 16 400 249

Todas las marcas son marcas comerciales o marcas registradas de TERUMO CORPORATION y sus respectivos dueños.

[Complicaciones]

Fallos del dispositivo:

- Rotura del balón
- Inflado/desinflado insuficiente del balón
- Rotura del balón y/o el eje del catéter
- Dificultad para retirar el dispositivo
- Fuga del fluido de inflado

Reacciones adversas:

- Infecciones locales o sistémicas
- Sangrado local interno o hematoma
- Rotura de intima
- Disección vascular
- Perforación vascular
- Rotura vascular
- Aneurisma
- Arritmia
- Oclusión vascular aguda
- Tromboembolismo venoso
- Vasoespasmio
- Formación de pseudoaneurisma
- Fistula arteriovenosa
- Sangrado que requiere transfusión
- Respuesta alérgica al medio de contraste/fallo renal
- Dolor o dolor a la presión
- Muerte
- Embolia
- Endocarditis
- Fiebre
- Hipertensión/hipotensión
- Inflamación
- Infarto de miocardio
- Septicemia
- Shock
- Ictus
- Ataque isquémico transitorio

[Almacenamiento y fecha de caducidad]

1. Almacenar en un lugar seco, fresco y oscuro. Evítese la exposición al agua y a la luz solar directa.
2. La fecha de caducidad se indica en la caja. No utilizar después de la fecha de caducidad.

[Envase]

1 set/caja

[Nombre y dirección del fabricante o representante]



Fabricante: KANEKA CORPORATION

Dirección: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,

OSAKA, 530-8288 JAPAN

N.º TELF.: (+81)-(0) 6-6226-5256

N.º FAX: (+81)-(0) 6-6226-5143

PM-05579
22/115 (3210-2)

Tabla 1: Tabla de presiones de rotura del balón Metacross OTW

Presión (atm)	Diámetro del balón (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96"	6.98"	8.00"	8.98"	9.90"	11.98"
10	3.01"	3.98"	5.06"	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50"						
20	3.36"	4.38"	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							


* Presión nominal

** Presión de ruptura

[DESCRIÇÃO DO PRODUTO]

Metacross OTW é um Cateter de Dilatação de Balão para Angioplastia Transluminal Percutânea (ATP) para indicações periféricas. O Metacross OTW consiste num cateter do tipo sobre o fio-guia (OTW), sendo o diâmetro máximo do fio-guia compatível de 0.035 polegadas (0,89 mm). A secção distal deste cateter é composta por um balão e um cabo de lúmen duplo (co-axial). O lúmen externo é utilizado para a insuflação e o esvaziamento do balão com meio de contraste diluído em solução salina. O lúmen interno (o lúmen do fio-guia; desde a ponta distal até à porta do fio-guia) é utilizado para a inserção de um fio-guia compatível, a fim de facilitar o avanço do cateter através da lesão estenótica e do stent a serem dilatados. A secção proximal é composta por um cabo de lúmen duplo com um coletor de ligação de luer dupla; uma para a insuflação/desinsuflação do balão e a outra para o acesso ao lúmen do fio-guia. No interior do balão, dois marcadores radiopacos, que indicam o comprimento funcional do balão, guiam o médico durante o posicionamento correcto do balão na lesão-alvo sob fluoroscopia. O Metacross OTW encontra-se disponível em vários tamanhos de balão (medidos por diâmetro e comprimento), a pressões de insuflação recomendadas (pressão nominal). Após a insuflação, o diâmetro do balão varia de acordo com a pressão de insuflação. A tabela de conformidade do balão do Metacross OTW é fornecida no final destas Instruções de Utilização (Tabela 1). Na embalagem esterilizada, o dispositivo encontra-se envolvido nos materiais de protecção, uma bainha de protecção do balão e um estilete, que devem ser removidos antes da respectiva utilização. A bainha de protecção do balão é colocada sobre o balão dobrado e o estilete é inserido no lúmen do fio-guia a fim de prevenir o colapso do cabo do cateter. A ponta distal do cateter é afunilada para facilitar a introdução do cateter na lesão estenótica ou no stent.

<NOME DE CADA PEÇA>

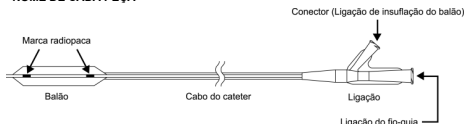

Esteril e não pirogénico, contido numa bolsa de plástico fechada e intacta. Este produto é esterilizado com óxido de etileno.

Diâmetro recomendado do fio-guia:

Diâmetro máximo: 0.035" (0,89 mm)

Pressão de insuflação recomendada e pressão de insuflação máxima

Pressão nominal:

- Diâmetro do balão: inferior a 6 mm: 10 atm
- Diâmetro do balão: 6 mm ou superior: 8 atm

Pressão nominal de ruptura:

- Diâmetro do balão: inferior a 5 mm: 20 atm
- Diâmetro do balão: 5 mm: 18 atm
- Diâmetro do balão: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Diâmetro do balão: 9 mm ou superior: 12 atm

[INDICAÇÕES]

O cateter de dilatação de balão para ATP Metacross OTW destina-se a dilatar estenoses nas artérias ilíacas, femorais, iliofemorais, popliteas, infra-popliteas e renais, assim como ao tratamento de lesões oclusivas de fistulas de diálise arteriovenosas nativas ou sintéticas. Este dispositivo está igualmente indicado para a pós-dilatação de stents na vasculatura periférica.

Nota: O teste de verificação da pós-dilatação do stent do Metacross OTW foi conduzido utilizando um Sistema de Stent Vascular Complete® SE (Medtronic, Inc), um Sistema de Stent Vascular S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) e um Sistema de Stent Vascular Auto-Expansível Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[CONTRA-INDICAÇÕES]

1. Doentes que desenvolveram estenose anastomótica no período de um mês após a construção do shunt AV.
2. Doentes com lesões que contactem com um pseudoaneurisma.
3. Doentes grávidas.
4. Doentes com intolerância a terapia antiplaquetária ou anticoagulante.

[ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES]

[Advertências]

1. Este dispositivo destina-se a uma única utilização. Não reutilizar. Não reesterilizar. Não reprocessar. O reprocessamento pode comprometer a esterilidade, a biocompatibilidade e a integridade física deste produto.
2. Não utilize se o produto ou a embalagem unitária se encontrarem danificados.
3. Não insufla o balão de modo a exceder o diâmetro do vaso sanguíneo proximal e distal à lesão estenótica.
4. Não insufla o balão a uma pressão que exceda a pressão nominal de ruptura.
5. Não utilize este cateter no sistema circulatório central.

[Precauções relacionadas com os procedimentos]

1. Remova lenta e cuidadosamente o dispositivo do tubo de transporte e retire as peças protectoras do dispositivo. Um manuseamento negligente pode provocar danos no balão e/ou no cabo do cateter, comprometendo a insuflação e a desinsuflação do balão.
2. Insufla o balão com o meio de contraste diluído em solução salina na proporção de 1:1 (daqui em diante denominado "fluido de insuflação"). Não deve ser utilizado para a sua insuflação um meio gasoso, tal como ar. (O balão pode ficar irregularmente insuflado.)
3. Antes de utilizar, extraia todo o ar do balão e do lúmen de insuflação do balão, substituindo-o pelo fluido de insuflação. (No caso do ar não ser completamente removido, o estado de insuflação do balão não pode ser observado sob fluoroscopia.)
4. No caso de lesões estenóticas graves, tais como lesões calcificadas, o vaso sanguíneo pode não ficar totalmente dilatado. Nesse caso, não aplique uma pressão superior à pressão nominal de ruptura. (O balão pode rebentar e os resíduos podem permanecer no interior do organismo.)
5. Relativamente aos dispositivos médicos utilizados em conjunto com este cateter, siga as instruções respectivas. (Sempre que o cateter de balão for utilizado para a pós-dilatação do stent durante o procedimento de colocação de um stent periférico, consulte as respectivas instruções de utilização do fabricante.)
6. Para a inserção no stent, a remoção do interior do stent ou a dilatação do balão no interior do stent, proceda com cuidado sob fluoroscopia. (Realizar este procedimento sem monitorização por fluoroscopia pode danificar este cateter ou lesionar o vaso sanguíneo.)
7. Não tente passar o cateter de dilatação de balão para ATP Metacross OTW através de uma bainha introdutora de tamanho inferior ao indicado no rótulo. Consulte o rótulo do produto.

[Precauções durante a utilização]

1. Utilize o dispositivo imediatamente após a abertura da embalagem esterilizada.
2. Todo o procedimento deve ser realizado em condições assépticas.
3. Este cateter deve ser utilizado apenas por médicos especializados em terapia vascular percutânea.
4. Selecione o cateter com o tamanho de balão adequado (diâmetro e comprimento do balão), de acordo com os seguintes critérios (procedimentos).
 - 1) O diâmetro do balão insuflado não deve exceder o diâmetro interno do vaso proximal e distal à lesão.
 - 2) O comprimento do balão insuflado não deve exceder o comprimento da lesão a ser tratada.

(A selecção de um cateter inadequado pode levar a oclusão vascular aguda.)

5. Utilize este cateter apenas quando for possível realizar cirurgia de emergência.
6. O médico responsável pelo procedimento deve definir a duração e o número insuflações do balão com base na sua experiência.
7. Deve ser administrada solução salina heparinizada para anticoagulação, enquanto o cateter de balão é introduzido no vaso sanguíneo.
8. Nunca insufla o balão ou faça avançar o fio-guia com o cateter dobrado ou retorcido.
9. Manipule cuidadosamente o cateter no vaso sanguíneo, verificando a localização e o movimento da respectiva ponta no monitor de fluoroscopia ou de Angiografia de Subtracção Digital (ASD).
10. Encha sempre o balão enquanto observa o seu estado de insuflação sob fluoroscopia. Insufla o balão cuidadosamente, verificando o seu movimento através das marcas radiopacas. Se for detectada qualquer anomalia, tal como resistência mesmo que pequena, cateter imóvel durante a manipulação ou ponta distal do fio-guia retorcida, o procedimento deve ser interrompido de imediato e o cateter removido lentamente em simultâneo com o fio-guia.
11. Não insira ou remova este cateter rapidamente. (A manipulação rápida pode danificar o cateter ou lesionar a íntima vascular.)
12. Não movimente o cateter com o balão insuflado. (A deslocação do cateter com o balão insuflado pode resultar na ruptura do balão ou na quebra do cabo do cateter.)
13. Não insufla ou desinsufla o balão rapidamente no interior do vaso sanguíneo. (A rápida insuflação ou desinsuflação pode danificar o vaso sanguíneo ou provocar a ruptura do balão, resultando na permanência de resíduos no interior do organismo.)
14. Não utilize um injector (dispositivo automático de injeção) para insuflar o balão.
15. Devem ser tomadas precauções para prevenir quaisquer danos no cateter por meio de bisturi ou tesoura.
16. No de caso de ocorrer qualquer anomalia tal como forte resistência durante a manipulação do cateter, o procedimento deve ser interrompido de imediato. Deve ser determinada a causa e tomadas as medidas adequadas em conformidade. (A continuação da operação exercendo força excessiva pode provocar danos no cateter ou lesão na parede da vasculatura.)
17. Preste sempre atenção ao estado do doente, monitorizando a sua temperatura corporal, pulsação e respiração. Se detectar alguma anomalia, interrompa de imediato a utilização deste cateter ou tome medidas adequadas relativas ao estado do doente, segundo o critério do médico.
18. Após a utilização, elimine o cateter como desperdícios médicos, em conformidade com os procedimentos hospitalares.
19. Não utilize agentes contendo solventes orgânicos ou meios de contraste oleaginosos. O contacto com tais agentes pode danificar o cateter.
20. Ao manipular este cateter, não torça ou rode o mesmo.
21. Durante a inserção deste dispositivo no vaso sanguíneo, ou durante a remoção deste dispositivo do vaso sanguíneo, certifique-se de que o balão se encontra completamente desinsuflado. (Um dispositivo com um balão maior e mais comprido requer um período de desinsuflação superior.)
22. Se detectar resistência durante a remoção do dispositivo após o procedimento, recomenda-se que retire o sistema completo em simultâneo com a bainha introdutora / guia.
23. Use sempre o cateter em conjunto com um fio-guia inserido no lúmen do fio-guia.

[Instruções de Funcionamento]

Os materiais tipicamente requeridos para ATP com o cateter de dilatação de balão para ATP Metacross OTW incluem:

- Fio(s)-guia de diâmetro e comprimento adequados
- Bainha introdutora/guia e conjunto de dilatação adequados
- Frasco de meio de contraste
- Frasco de solução salina esterilizada
- Dispositivo de insuflação com manómetro

- Seringa com luer-lock
- Torneira de três vias

[Método de funcionamento ou instruções de utilização]

1. Selecção do cateter
Antes de utilizar, verifique o diâmetro interno do vaso sanguíneo proximal e distal à lesãoestenótica sob fluoroscopia e seleccione o cateter com o tamanho de balão adequado. Se forem aplicáveis dois tamanhos face ao diâmetro verificado, seleccione o de tamanho inferior.
2. Preparação
 - 1) Após remover de modo asséptico este cateter da embalagem, retire os materiais de protecção.
 - 2) Substitua o ar no interior do balão e o lúmen de insuflação do balão pelo fluido de insuflação de acordo com os seguintes procedimentos.
 - a) Preencha o dispositivo de insuflação (não incluído neste conjunto) cheio com fluido de insuflação à ligação de insuflação do balão.
 - b) Depois de aplicar pressão negativa durante aproximadamente 10 segundos ao dispositivo de insuflação, direcione a ponta do cabo do cateter para baixo e liberte lentamente a pressão negativa a fim de permitir que o fluido encha o balão e o lúmen de insuflação do balão, expelindo o ar.
 - c) Se detectar ar no balão e no lúmen de insuflação do balão, repita o procedimento b) até expelir completamente o ar.
 - d) Desprenda o dispositivo de insuflação da ligação de insuflação do balão e retire o ar do cilindro do dispositivo de insuflação.
 - e) Volte a prender o dispositivo de insuflação à ligação de insuflação do balão e mantenha a pressão negativa. Confirme que o ar não volta a entrar na seringa.
 - 3) Enxagúe o lúmen do fio-guia com solução salina heparinizada e encha o lúmen com solução salina heparinizada.
 - 4) Mergulhe por completo o cateter de dilatação de balão para ATP Metacross OTW em solução salina.
3. Inserção e insuflação do cateter de balão
Antes de utilizar, verifique se este cateter é compatível com o cateter de orientação (não incluído neste conjunto), a bainha introdutora (não incluída neste conjunto) e o fio-guia (não incluído neste conjunto) de acordo com a tabela que se segue.

Referência do catálogo	Diâmetro do balão (mm)	Bainha compatível (Fr/mm)	Diâmetro máximo do fio-guia (polegadas/mm)
BDL30020SW ~ BDL70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (excluindo comprimento do balão de 200 mm), 7 mm (comprimento do balão de 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0.035 polegadas (0,89 mm)
	6 mm (apenas para comprimento do balão de 200 mm), 7 mm (excluindo comprimento do balão de 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Ao utilizar este cateter inserido na bainha introdutora ou no cateter de orientação

- 1) Ao utilizar este cateter no cateter de orientação, desaperte a válvula hemostática, enquanto a mantém suficientemente apertada para prevenir derrame sanguíneo.
- 2) Insira gradualmente o cateter, com o balão totalmente desinsuflado, na bainha introdutora ou no cateter de orientação sobre o fio-guia e faça-os avançar até à periferia distal da lesão. Sob fluoroscopia, faça avançar o cateter lentamente até a marca radiopaca atingir o local pretendido.
- 3) Ainda sob fluoroscopia, verifique a posição da marca radiopaca no balão e determine o local de dilatação.
- 4) Preencha firmemente o dispositivo de insuflação à ligação de insuflação do balão.
- 5) Insufla gradualmente o balão até atingir o diâmetro alvo, verificando a pressão de insuflação, e dilate a lesãoestenótica (para mais informações sobre o diâmetro do balão insuflado,

consulte a tabela de conformidade do balão fornecida no final destas Instruções de Utilização, a Tabela 1).

4. Remoção do cateter

- 1) Após aplicar pressão negativa para desinsuflar o balão por completo, remova o cateter.

5. Reintrodução do cateter

- 1) Se for necessária a reinserção do cateter removido com o balão vazio, certifique-se de que o balão se encontra totalmente vazio e dobrado antes de o voltar a introduzir no vaso sanguíneo do paciente. Aquando da reinserção, utilize o cateter conforme descrito na secção "Inserção e insuflação do cateter de balão" aqui incluída.
- 2) Se sentir qualquer resistência durante a reinserção do cateter, interrompa a sua introdução e retire-o cuidadosamente do vaso sanguíneo do paciente. Prepare a utilização de um novo Metacross OTW de acordo com os procedimentos anteriormente descritos nesta secção das presentes Instruções de Utilização.

[Complicações]

Falha do Dispositivo:

- Ruptura do balão
- Insuflação / desinsuflação insuficiente do balão
- Quebra do balão e / ou do respectivo cabo
- Dificuldade na remoção do dispositivo
- Derrame do fluido de insuflação

Ocorrências Adversas:

- Infecção local ou sistémica
- Hemorragia interna local ou hematoma
- Ruptura da íntima
- Dissecção vascular
- Perfuração vascular
- Ruptura vascular
- Aneurisma
- Arritmia
- Oclusão aguda do shunt
- Tromboembolia venosa
- Espasmo vascular
- Formação de pseudoaneurisma
- Fístula arteriovenosa
- Hemorragia com necessidade de transfusão
- Reacção alérgica aos meios de contraste
- Dor normal ou persistente
- Morte
- Embolia
- Endocardite
- Febre
- Hipertensão / Hipotensão
- Inflamação
- Enfarte do miocárdio
- Sépsis
- Choque
- Trombose
- Ataque isquémico transitório

[Armazenamento e data de validade]

1. Armazene em local fresco, seco e escuro. Evite a exposição directa a água ou à luz solar.
2. O prazo de validade encontra-se indicado na embalagem. Não utilizar após o prazo de validade.

[Embalagem]

1 conjunto/caixa

[Nome e endereço do fabricante ou representante]



Fabricante: KANEKA CORPORATION

Endereço: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city, OSAKA, 530-8288 JAPAN

Nº de Telefone: (+81)-(0) 6-6226-5256

Nº de FAX: (+81)-(0) 6-6226-5143



Representante autorizado na Comunidade Europeia:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Endereço: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Nº de Telefone: (+32)-(0) 14-256-297

Nº de FAX: (+32)-(0) 14-256-298

Distribuidor na UE: TERUMO EUROPE N.V.

Endereço: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BÉLGICA

Nº de Telefone: (+32)-(0) 16 381 211

Nº de FAX: (+32)-(0) 16 400 249

Todos os nomes de empresas e marcas são marcas comerciais ou marcas registradas da TERUMO CORPORATION e seus respectivos proprietários.

Tabela 1. Tabela de Conformidade do Balão Metacross OTW


Pressão (atm)	Diâmetro do balão (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										

* Pressão nominal

** Pressão nominal de ruptura

[DESCRIZIONE PRODOTTO]

Metacross OTW è un catetere con palloncino di dilatazione per angioplastica percutanea transluminale (PTA) per indicazioni periferiche. Metacross OTW è di tipo over the wire (OTW) e il diametro massimo del filo guida compatibile è 0.035 pollici (0,89 mm). La sezione distale di questo catetere è costituita da un palloncino e da steli a doppio lume (coassiali). Il lume esterno è utilizzato per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del palloncino con mezzo di contrasto diluito con soluzione salina. Il lume interno (il lume del filo guida, dalla punta distale alla porta del filo guida) serve per l'inserimento di un filo guida compatibile per facilitare l'avanzamento del catetere attraverso la lesione stenotica o lo stent da dilatare. La sezione distale è costituita da uno stelo a doppio lume con un collettore a doppio luer. Uno per il gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino, l'altro per accesso al lume del filo guida. All'interno del palloncino, due marker radiopachi che indicano la lunghezza di lavoro del palloncino, sono posizionati per guidare il medico nel posizionare correttamente il palloncino nella lesione mirata sotto fluoroscopia. Metacross OTW è disponibile in varie misure del palloncino per diametro e lunghezza a pressioni di gonfiaggio consigliate (pressione nominale). Al gonfiaggio, il diametro del palloncino varia a seconda della pressione di gonfiaggio. Il grafico di compatibilità del palloncino di Metacross OTW è fornito nella tabella 1 al termine di queste Istruzioni per l'uso. Nel pacchetto di sterilizzazione, il dispositivo è dotato dei materiali protettivi, un tubo di protezione per il palloncino e un mandrino, che devono essere rimossi prima dell'uso. Il tubo di protezione del palloncino viene posizionato sopra il palloncino ripiegato in un profilo basso e il mandrino viene inserito nel lume del filo guida per impedire il collasso dello stelo del catetere. La punta distale del catetere è rastremata per facilitare l'avanzamento del catetere nella lesione stenotica o nello stent.
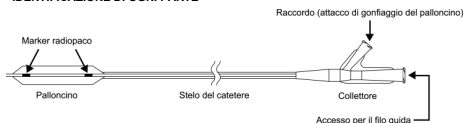
<IDENTIFICAZIONE DI OGNI PARTE>

Sterile e non pirogenico se in confezione non danneggiata e non aperto. Questo dispositivo è sterilizzato con ossido di etilene.

Diametro del filo guida raccomandato:

Diametro massimo: 0.035"/0,89 mm

Pressione di gonfiaggio e pressione massima di gonfiaggio raccomandate

Pressione nominale:

- Diametro del palloncino: inferiore a 6 mm: 10 atm
- Diametro palloncino: 6 mm e superiore: 8 atm

Pressione massima di sicurezza:

- Diametro del palloncino: inferiore a 5 mm: 20 atm
- Diametro palloncino: 5 mm: 18 atm
- Diametro palloncino: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Diametro palloncino: 9 mm e superiore: 12 atm

[INDICAZIONI]

Il catetere con palloncino di dilatazione per PTA Metacross OTW è destinato per dilatare stenosi nelle arterie iliache, femorali, ilio-femorali, poplitee, infra-poplitee e renali e per il trattamento delle lesioni ostruttive di fistole da dialisi arterovenosa native o sintetiche. Questo dispositivo è indicato anche per post-dilatazione di stent nel sistema vascolare periferico.

Nota: il test di verifica test per la post-dilatazione dello stent di Metacross OTW è stato condotto utilizzando il sistema di stent vascolare Complete® SE (Medtronic, Inc), il sistema di stent vascolare S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) e il sistema di stent vascolare auto-espandibile Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[CONTROINDICAZIONI]

1. Pazienti che hanno sviluppato stenosi anastomotica entro un mese dalla costruzione di shunt AV.
2. Pazienti con lesioni comunicanti con uno pseudoaneurisma.
3. Pazienti in stato di gravidanza.
4. Pazienti che non tollerano la terapia antiaggregante o terapia anticoagulante.

[AVVERTENZE E PRECAUZIONI]**[Avvertenze]**

1. Dispositivo monouso. Non riutilizzare. Non risterilizzare. Non riprocessare. Ritirare un prodotto già utilizzato può compromettere la sterilità, la biocompatibilità e l'integrità fisica del prodotto.
2. Non utilizzare se il prodotto o la confezione dell'unità sono stati danneggiati.
3. Non gonfiare il palloncino superando il diametro del vaso sanguigno prossimale e distale alla lesione stenotica.
4. Non gonfiare il palloncino a una pressione superiore alla pressione massima di sicurezza
5. Non utilizzare questo catetere nel sistema circolatorio centrale

[Precauzioni relative alle procedure]

1. Rimuovere con cautela e lentamente il dispositivo dalla confezione e togliere le parti di protezione dal dispositivo. La mancanza di cautela potrebbe danneggiare il palloncino e/o lo stelo del catetere del dispositivo, compromettendo il gonfiaggio e/o lo sgonfiaggio del palloncino.
2. Gonfiare il palloncino con il mezzo di contrasto diluito con soluzione salina in rapporto di 1:1 (in seguito, "fluido per il gonfiaggio"). Nessuna mezzo gassoso come l'aria deve essere usato per il gonfiaggio (il palloncino potrebbe essere gonfiato in modo irregolare).
3. Prima dell'uso, aspirare tutta l'aria dal palloncino e dal lume di gonfiaggio del palloncino e sostituirla con il liquido di gonfiaggio (in caso di rimozione incompleta dell'aria, non è possibile verificare lo stato di gonfiaggio del palloncino mediante fluoroscopia).
4. In caso di gravi lesioni stenotiche come lesioni calcificate, il vaso sanguigno non può essere dilatato completamente. Non applicare una pressione superiore alla pressione di rottura nominale in tal caso (il palloncino può scoppiare e i detriti possono rimanere all'interno del corpo).
5. Come per i dispositivi medicali utilizzati con questo catetere, seguire le istruzioni per l'uso di questi dispositivi (quando il catetere a palloncino viene utilizzato per la post-dilatazione di stent durante la procedura di impianto di stent periferici, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del produttore).
6. Per l'inserimento nello stent, il ritiro dallo stent o la dilatazione del palloncino all'interno dello stent, procedere con cautela sotto fluoroscopia (l'utilizzo senza fluoroscopia potrebbe danneggiare il catetere o causare una lesione all'intima vascolare).
7. Non tentare di far passare il catetere con palloncino di dilatazione per PTA Metacross OTW attraverso un introduttore di dimensioni inferiori a quanto indicato in etichetta. Fare riferimento all'etichettatura dei prodotti.

[Precauzioni durante l'utilizzo]

1. Utilizzare il dispositivo immediatamente dopo l'apertura della confezione sterile.
2. L'intera procedura deve essere effettuata in ambiente sterile.
3. Questo catetere deve essere utilizzato solo da medici qualificati nella terapia percutanea vascolare.
4. Selezionare il catetere con la dimensione del palloncino appropriata (diametro del palloncino, lunghezza del palloncino secondo i seguenti criteri procedurali.
 - 1) Il diametro del palloncino gonfiato non deve superare il diametro interno del vaso prossimale e distale alla lesione.
 - 2) La lunghezza del palloncino gonfiato non deve superare la lunghezza della lesione da trattare

(la selezione inappropriata del catetere può portare ad un'occlusione vascolare acuta).

- Utilizzare questo catetere solo se è possibile effettuare un intervento chirurgico di emergenza in qualsiasi momento.
- Il medico addetto alla procedura deve determinare la durata e il numero di gonfiaggi del palloncino in base all'esperienza.
- Infondere la soluzione salina eparinizzata per l'anticoagulazione mentre il catetere a palloncino è inserito nel vaso sanguigno.
- Non gonfiare il palloncino o far avanzare il filo guida con il catetere piegato o attorcigliato.
- Manipolare il catetere con attenzione dentro il vaso sanguigno verificando sempre posizione e movimento della punta mediante fluoroscopia o monitor AST (angiografia a sottrazione digitale).
- Gonfiare sempre il palloncino osservando lo stato di gonfiaggio mediante fluoroscopia. Gonfiare il palloncino accuratamente verificandone la stabilità tramite i markers radiopachi. In caso di anomalie come una piccola resistenza, catetere immobile durante la manipolazione, o punta distale del filo guida attorcigliata, interrompere immediatamente la procedura e rimuovere il catetere lentamente insieme al filo guida.
- Non inserire o rimuovere il catetere rapidamente (un'operazione rapida potrebbe danneggiare il catetere o causare una lesione all'intima vascolare).
- Non spostare il pallone prima di averlo sgonfiato completamente (lo spostamento del catetere con il palloncino gonfiato potrebbe rompere il palloncino e/o lo stelo del catetere).
- Non gonfiare o sgonfiare il palloncino rapidamente nel vaso sanguigno (un gonfiaggio o sgonfiaggio rapido potrebbe danneggiare il vaso sanguigno o rompere il palloncino lasciando residui all'interno del corpo).
- Non utilizzare un iniettore (dispositivo di iniezione automatico) per gonfiare il palloncino.
- Prendere precauzioni per evitare danni al catetere con bisturi o forbici.
- Qualora, durante la manipolazione del catetere di verificassero anomalie, come una forte resistenza, la procedura deve essere interrotta immediatamente. La causa deve essere verificata e devono essere prese misure appropriate (continuando l'operazione con forza eccessiva si possono provocare danni al catetere e/o lesioni alla parete vascolare).
- Prestare sempre attenzione alle condizioni del paziente e monitorare la temperatura corporea, le pulsazioni e il respiro. In caso di anomalie, interrompere immediatamente l'utilizzo del catetere o adottare le misure appropriate alle condizioni del paziente a discrezione del medico.
- Dopo l'uso, smaltire il catetere come rifiuto sanitario in conformità alle procedure ospedaliere.
- Non utilizzare prodotti contenenti solventi organici o mezzi di contrasto oleaginosi. Il contatto con questi farmaci può portare a danni del catetere.
- Mentre si manipola questo catetere, non torcere né ruotare il catetere.
- Inserendo questo dispositivo nel vaso sanguigno o rimuovendo il dispositivo dal vaso sanguigno, assicurarsi che il palloncino sia completamente sgonfiato (un dispositivo con un palloncino più grande e più lungo richiede un tempo di sgonfiaggio più lungo).
- Se si avverte resistenza durante il ritiro post-intervento di questo dispositivo, si consiglia di ritirare l'intero sistema insieme all'introduttore/guida.
- Utilizzare sempre il catetere lungo un filo guida inserito nel lume del filo guida.

[Istruzioni Operative]

I materiali tipicamente richiesti per la PTA con il catetere con palloncino di dilatazione per PTA Metacross OTW sono:

- Filo guida di diametro e lunghezza adeguate
- Set introduttore/introduttore guida e dilatatore appropriato
- Flacone mezzo di contrasto
- Flacone di soluzione fisiologica sterile
- Dispositivo di gonfiaggio con manometro
- Siringa Luer-lock
- Rubinetto a tre vie

[Metodo operativo o istruzioni per l'uso]

- Selezione del catetere dilatatore
Prima dell'uso, verificare il diametro interno del vaso sanguigno prossimale e distale della lesione stenotica mediante fluoroscopia e selezionare il catetere con la dimensione del palloncino appropriata. Se ci sono due dimensioni applicabili al diametro selezionato, scegliere la più piccola.
- Preparazione
 - Dopo aver rimosso in maniera asettica il catetere dal contenitore, staccare i materiali protettivi.
 - Aspirare l'aria nel palloncino e nel lume di gonfiaggio del palloncino, quindi riempire la siringa di gonfiaggio con mezzo di contrasto diluito con soluzione salina con un rapporto di 1:1 (da qui in poi verrà chiamato liquido di gonfiaggio) secondo le procedure seguenti.
 - Collegare il dispositivo di gonfiaggio (non incluso nel kit) riempito con il liquido di gonfiaggio sulla porta di gonfiaggio del palloncino.
 - Dopo aver applicato una pressione negativa per circa 10 secondi al dispositivo di gonfiaggio, dirigere la punta dello stelo del catetere verso il basso e rilasciare lentamente la pressione negativa per consentire che il liquido riempia il palloncino e il lume di gonfiaggio del palloncino e per espellere l'aria.
 - Se è ancora presente dell'aria nel palloncino e nel raccordo dopo che il palloncino è stato gonfiato con il liquido, ripetere la procedura b) fino a espellere l'aria completamente.
 - Staccare il dispositivo di gonfiaggio dalla porta di gonfiaggio del palloncino e rimuovere l'aria dal cilindro del dispositivo di gonfiaggio.
 - Ricollegare il dispositivo di gonfiaggio alla porta di gonfiaggio del palloncino e mantenere la pressione negativa. Verificare che l'aria non ritorni nella siringa.
 - Sciagurare il lume del filo guida con soluzione salina eparinizzata e riempire il lume con la soluzione fisiologica eparinizzata.
 - Immergere l'intero catetere con palloncino di dilatazione per PTA Metacross OTW in soluzione salina.
- Inserimento e gonfiaggio del catetere a palloncino
Prima dell'uso, verificare se questo catetere sia compatibile con il catetere guida (non incluso nel kit), la guaina di introduzione (non inclusa nel kit) e il filo guida (non incluso nel kit) nella tabella seguente.

Numero del catalogo	Diametro palloncino (mm)	Compatibilità introduttore (Fr/mm)	Diametro massimo per il filo guida (pollici/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (esclusa la lunghezza del palloncino di 200 mm), 7 mm (lunghezza del palloncino 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0.035" (0.89 mm)
	6 mm (solo 200 mm lunghezza del palloncino di 200 mm), 7 mm (esclusa la lunghezza del palloncino 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Quando si utilizza il catetere inserito nell' introduttore guida/catetere guida

- Quando si utilizza il catetere nel catetere guida, allentare la valvola emostatica tenendola in modo da evitare perdite ematiche.
- Gradualmente inserire il catetere con il palloncino sgonfiato completamente nell'introduttore guida/catetere guida sul filo guida e farlo avanzare fino alla periferia distale della lesione. Sotto fluoroscopia, far avanzare il catetere lentamente fino a che il marcatore radiopaco nel palloncino non raggiunge il sito di destinazione.
- Sotto fluoroscopia, verificare la posizione del marker radiopaco nel palloncino e determinare il sito della dilatazione.
- Collegare il dispositivo di gonfiaggio correttamente alla porta di gonfiaggio del palloncino.

- 5) Gonfiare gradualmente il palloncino fino a raggiungere il diametro target verificando la pressione di gonfiaggio e dilatare la lesione stenotica (per i diametri del palloncino gonfio, consultare il grafico di compatibilità del palloncino indicato nella Tabella 1 alla fine di queste Istruzioni per l'uso).
4. Rimozione del catetere
 - 1) Dopo aver applicato una pressione negativa per sgonfiare completamente il palloncino, rimuovere il catetere.
5. Reinserimento del catetere
 - 1) Se è necessario un secondo inserimento del catetere rimosso con palloncino sgonfio, accertarsi che il palloncino sia completamente sgonfio e piegato prima reinserirlo nel vaso sanguigno del paziente. Al reinserimento utilizzare il catetere in base alla sezione "Inserimento e gonfiaggio del catetere a palloncino".
 - 2) Se si incontra resistenza durante il reinserimento del catetere, interrompere l'avanzamento e rimuoverlo con cautela dal vaso sanguigno del paziente. Prepararsi ad utilizzare un nuovo Metacross OTW in conformità con le procedure previste in precedenza in questa sezione di queste Istruzioni per l'uso.

[Complicanze]

Problemi al dispositivo:

- Rottura del palloncino
- Gonfiaggio/sgonfiaggio insufficiente del palloncino
- Rottura del palloncino e/o stelo del catetere
- Difficoltà nel rimuovere il dispositivo
- Perdita di fluido di riempimento

Eventi avversi:

- Infezione locale o sistemica
- Sanguinamento locale interno o ematoma
- Rottura dell'intima
- Dissezione vascolare
- Perforazione vascolare
- Rottura vascolare
- Aneurisma
- Aritmia
- Occlusione acuta vascolare
- Tromboembolia venosa
- Vasospasmo
- Formazione di pseudoaneurisma
- Fistola arterovenosa
- Sanguinamento (che necessita una trasfusione)
- Risposta allergica al mezzo di contrasto
- Dolore o dolore da pressione
- Morte
- Embolia
- Endocardite
- Febbre
- Ipotensione/ipertensione
- Infiammazione
- Infarto miocardico
- Sepsì
- Shock
- Ictus
- Attacco ischemico transitorio

[Conservazione e data di scadenza]

1. Conservare in un posto fresco e asciutto e al buio. Evitare l'esposizione all'acqua e alla luce solare diretta.
2. La data di scadenza è indicata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

[Confezione]

1 set/confezione

[Nome e indirizzo del produttore o rappresentante]



Produttore: KANEKA CORPORATION

Indirizzo: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN

N. di TEL: (+81)-(0) 6-6226-5256

N di FAX: (+81)-(0) 6-6226-5143



Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Indirizzo: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

N. di TEL: (+32)-(0) 14-256-297

N di FAX: (+32)-(0) 14-256-298

Distributore UE: TERUMO EUROPE N.V.

Indirizzo: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgio

N. di TEL: (+32)-(0) 16 381 211

N di FAX: (+32)-(0) 16 400 249

Tutte le denominazioni commerciali sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà di TERUMO CORPORATION e dei loro rispettivi proprietari.

Tabella 1. Grafico di compatibilità per il palloncino Metacross OTW

Pressione (atm)	Diametro palloncino (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50"						
20	3.36"	4.38"	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							


* Pressione nominale

** Pressione massima di sicurezza

[PRODUCTBESCHRIJVING]

Metacross OTW is een ballondilatatiekatheter voor percutane transminimale angioplastiek (PTA) voor perifere indicaties. Metacross OTW is een over-de-voerdraad-katheter (OTW, over the wire) en de maximale diameter van de compatibele voerdraad is 0,035 inches (0,89 mm). Het distale gedeelte van deze katheter bestaat uit een ballon en een schacht met dubbel lumen (coaxiaal). Het buitenlumen wordt gebruikt voor het vullen en legen van de ballon met contrastmiddel verdund met zoutoplossing. Het binnenlumen (het voerdraatlumen; van de distale tip tot aan de voerdraadpoort) is voor het inbrengen van een compatibele voerdraad ten behoeve van het opvoeren van de katheter door de te dilateren stenotische laesie of stent. Het proximale deel bestaat uit een schacht met dubbel lumen en een aanzetstuk met dubbele luerpoort; een voor vullen/legen van de ballon, de andere voor inbrengen van de voerdraad. Binnen in de ballon zijn twee radio-opake markeringen aangebracht die de werklengte van de ballon aangeven, als hulpmiddel voor de arts bij een correcte plaatsing van de ballon in de doellaesie onder fluoroscopie. Metacross OTW is verkrijgbaar in verschillende ballonmaten wat betreft de diameter en lengte bij de aanbevolen vuldruk (nominale druk). Eenmaal gevuld varieert de ballondiameter afhankelijk van de vuldruk. De balloncompliance van Metacross OTW is vermeld in tabel aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. In de sterilisatieverpakking is het hulpmiddel voorzien van beschermingsmaterialen, een ballonbeschermhuls en een stilet, die vóór het gebruik moeten worden verwijderd. De ballonbeschermhuls is aangebracht over de met laag profiel geplooid ballon en het stilet is in het voerdraatlumen gestoken om inklinken van de katheterschacht te voorkomen. De distale tip van de katheter is conisch om het opvoeren van de katheter in de stenotische laesie of stent te vergemakkelijken.

<NAAM VAN DE ONDERDELEN>

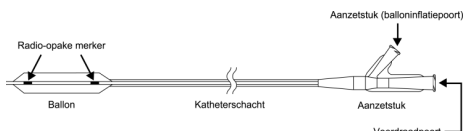

Steriel en pyrogeenvrij in een onbeschadigde en ongeopende blisterverpakking. Dit medisch hulpmiddel is gesteriliseerd met ethyleenoxide.

Aanbevolen voerdraaddiameter:

Maximumdiameter: 0,89 mm (0,035")

Aanbevolen inflatiedruk en maximale inflatiedruk

Nominale druk:

- Ballondiameter: kleiner dan 6 mm: 10 atm
- Ballondiameter: 6 mm en groter: 8 atm

Bepaalde scheurdruk

- Ballondiameter: kleiner dan 5 mm: 20 atm
- Ballondiameter: 5 mm: 18 atm
- Ballondiameter: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Ballondiameter: 9 mm en groter: 12 atm

[INDICATIES]

De Metacross OTW PTA ballondilatatiekatheter is bestemd voor de dilatie van stenosen in de aa. iliaca, femoralis, iliofemorale, popliteale, infrapopliteale en renalis, en voor de behandeling van obstructieve laesies van native of synthetische arterioveneuze dialysefistels. Gebruik van dit hulpmiddel is tevens geïndiceerd voor postdilatie van stents in het perifere vaatstelsel.

Opmerking: de verificatietest voor postdilatie van stents met Metacross OTW werd verricht met een Complete® SE vasculair stentsysteem (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® vasculair stentsysteem (Cordis Corporation) en een Epic™ vasculair zelfexpanderend stentsysteem (Boston Scientific Corporation).

[CONTRA-INDICATIES]

1. Patiënten die binnen één maand na een AV-shuntconstructie een anastomotische stenose hebben ontwikkeld.
2. Patiënten met laesies die met een pseudoaneurysma verbonden zijn.
3. Zwangere patiënten.
4. Patiënten die behandeling met antibloedplaatjetherapie of anticoagulatie niet kunnen verdragen.

[WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]

[Waarschuwingen]

1. Dit hulpmiddel is bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken. Niet opnieuw steriliseren. Niet herwerken. Het product herwerken kan de steriliteit, de biocompatibiliteit en de functionele integriteit ervan compromitteren.
2. Niet gebruiken als het product of de eenheidsverpakking beschadigd is.
3. Vul de ballon niet verder dan de diameter van het bloedvat proximaal en distaal van de stenotische laesie.
4. Vul de ballon niet tot een druk hoger dan de bepaalde scheurdruk (RBP).
5. Gebruik deze katheter niet in het centrale circulatoire systeem.

[Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot procedures]

1. Ga voorzichtig en langzaam te werk wanneer u het hulpmiddel uit de houder haalt en verwijder de beschermingsmaterialen van dit hulpmiddel. Door onvoorzichtige hantering kan de ballon en/of de katheterschacht van het hulpmiddel worden beschadigd, waardoor het vullen en/of legen van de ballon kan worden belemmerd.
2. Vul de ballon met het contrastmiddel dat in een verhouding van 1:1 is verdund met fysiologische zoutoplossing (hierna "de inflatievloeistof" genoemd). Er mag geen gasvormig medium zoals lucht worden gebruikt om de ballon te vullen. (Hierdoor kan de ballon ongelijkmatig worden gevuld.)
3. Verwijder vóór gebruik alle lucht uit de ballon en het balloninflatielumen en vervang dit door de inflatievloeistof. (Als de lucht niet volledig wordt verwijderd, kan de inflatietoestand van de ballon niet met fluoroscopie worden waargenomen.)
4. Bij ernstige stenotische laesies zoals verkalkte laesies kan het bloedvat niet volledig worden gedilateerd. Oefen in dat geval geen druk uit die hoger is dan de bepaalde scheurdruk. (De ballon kan dan barsten en de resten kunnen achterblijven in het lichaam.)
5. Voor wat betreft de medische hulpmiddelen die in combinatie met deze katheter worden gebruikt, volgt u de gebruiksinstructies van deze hulpmiddelen. (Als de ballonkatheter wordt gebruikt voor postdilatie van de stent tijdens een perifere stentplaatsingsprocedure raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.)
6. Voorzichtig te werk gaan met behulp van fluoroscopie bij het inbrengen in de stent, terugtrekken uit de stent en dilateren van de ballon in de stent. (Het niet uitvoeren onder fluoroscopie, kan deze katheter of het bloedvat beschadigen.)
7. Probeer de Metacross OTW PTA ballondilatatiekatheter niet door een inbrenghuls te voeren die kleiner is dan de op het etiket vermelde maat. Zie het productetiket.

[Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik]

1. Gebruik het hulpmiddel onmiddellijk na het openen van de steriele verpakking.
2. De gehele procedure dient aseptisch te worden uitgevoerd.
3. Deze katheter mag uitsluitend worden gebruikt door artsen met ervaring in percutane vasculaire therapie.
4. Kies een katheter met de juiste ballonaanmetingen (ballondiameter, ballonlengte) op basis van de volgende criteria (procedures).
 - 1) De diameter van de gevulde ballon mag niet groter zijn dan de inwendige diameter van het bloedvat proximaal en distaal van de laesie.
 - 2) De lengte van de gevulde ballon mag niet groter zijn dan de lengte van de te behandelen laesie. (Een verkeerd gekozen katheter kan leiden tot acute vaatocclusie.)

- Gebruik deze katheter uitsluitend als de mogelijkheid bestaat om op elk gewenst moment een spoedoperatie uit te voeren.
- De arts die de leiding over de ingreep heeft, bepaalt de duur en het aantal balloninflaties op basis van zijn/haar ervaring.
- Zolang de ballonkatheter in het bloedvat is ingebracht, wordt gehepariniseerde fysiologische zoutoplossing toegediend voor anticoagulatie.
- Vul de ballon nooit en voer de voerdraad nooit op als de katheter gebogen of geknikt is.
- Manipuleer de katheter voorzichtig in het bloedvat, waarbij u de locatie en beweging van de tip controleert met behulp van fluoroscopie of DSA-bewaking (digitale subtractieangiografie).
- Vul de ballon altijd terwijl de inflatietoestand wordt gecontroleerd met behulp van fluoroscopie. Vul de ballon voorzichtig terwijl u de beweging controleert aan de hand van de radio-opake markeringen. Als een abnormaliteit wordt opgemerkt, zoals geringe weerstand, een onbeweeglijke katheter tijdens de manipulatie of een geknikte distale tip van de voerdraad, moet de procedure onmiddellijk worden gestaakt en moet deze katheter langzaam worden verwijderd samen met de voerdraad.
- De katheter niet snel inbrengen of verwijderen. (Een snelle handeling kan de katheter of de vasculaire intima beschadigen.)
- Verplaats de katheter niet terwijl de ballon gevuld is. (Door verplaatsing van de katheter terwijl de ballon gevuld is, kan de ballon barsten of de katheterschacht breken.)
- Vul of leeg de ballon niet snel in het bloedvat. (Door snel vullen of legen kan het bloedvat worden beschadigd of de ballon barsten, waarbij resten in het lichaam kunnen achterblijven.)
- Gebruik geen injector (automatisch injectieapparaat) voor het vullen van de ballon.
- Er moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om beschadiging van de katheter door een scalpel of schaar te voorkomen.
- Als tijdens het manipuleren van de katheter een abnormaliteit wordt opgemerkt, zoals sterke weerstand, moet de procedure onmiddellijk worden gestaakt. De oorzaak moet worden vastgesteld en er moeten passende maatregelen worden getroffen. (Vortzetting van de ingreep met overmatige kracht kan de katheter of de vaatwand beschadigen.)
- Let altijd op de toestand van de patiënt en bewaak de lichaamstemperatuur, hartslag en ademhaling. Als er een afwijking wordt waargenomen, moet het gebruik van de katheter onmiddellijk worden gestaakt of moeten passende maatregelen worden getroffen met het oog op de toestand van de patiënt, naar de beoordeling van de arts.
- Werp de katheter na gebruik weg als medisch afval volgens de in het ziekenhuis geldende procedures.
- Gebruik geen middelen die organische oplosmiddelen of olieachtige contrastvloeistoffen bevatten. Door aanraking met deze middelen kan de katheter worden beschadigd.
- Bij het manipuleren van deze katheter mag de katheter niet worden gedraaid of verdraaid.
- Zorg dat de ballon volledig geleegd is wanneer u dit hulpmiddel in het bloedvat inbrengt of uit het bloedvat verwijdert. (Voor een hulpmiddel met een grotere en langere ballon is een langere deflatietijd vereist.)
- Als bij het terugtrekken van dit hulpmiddel na de procedure weerstand wordt ondervonden, wordt aanbevolen om het gehele systeem samen met de inbrenghuls/geleideschacht terug te trekken.
- Gebruik de katheter altijd met een voerdraad ingebracht in het voerdraادلumen.

[Gebruiksaanwijzingen]

De materialen die over het algemeen nodig zijn voor PTA met de Metacross OTW PTA ballondilatatiekatheter zijn:

- Een of meer voerdraden met de juiste diameter en lengte
- Een geschikte set met inbrenghuls/geleideschacht en dilatator
- Flacon contrastmiddel
- Flacon steriele fysiologische zoutoplossing
- Inflatie-instrument met manometer
- Luer-lockspuit

- Driewegafsluitkraan

[Bedieningsmethode of gebruiksaanwijzingen]

- Keuze van de katheter
Controleer vóór gebruik met behulp van fluoroscopie de inwendige diameter van het bloedvat proximaal en distaal van de stenotische laesie en kies de katheter met de juiste ballonmaat. Als er twee maten in aanmerking komen voor de betreffende diameter, kiest u de kleinste maat.
- Vorbereiding
 - Neem de katheter op aseptische wijze uit de verpakking en verwijder de beschermende materialen van de katheter.
 - Vervang de lucht in de ballon en het balloninflatielumen met inflatievloeistof, waarbij u de volgende procedures opvolgt.
 - Sluit het inflatie-instrument (niet inbegrepen in deze kit) gevuld met de inflatievloeistof aan op de balloninflatiepoort.
 - Oefen ongeveer 10 seconden onderdruk uit op het inflatie-instrument, richt de tip van de katheterschacht naar beneden en neem de onderdruk langzaam weg zodat de vloeistof de ballon en het balloninflatielumen kan vullen en de lucht wordt verdreven.
 - Als er nog lucht aanwezig is in de ballon en het balloninflatielumen, herhaalt u procedure b) tot de lucht volledig is verdreven.
 - Maak het inflatie-instrument los van de balloninflatiepoort en verwijder de lucht uit de cilinder van het inflatie-instrument.
 - Bevestig het inflatie-instrument weer aan de balloninflatiepoort en handhaaf de onderdruk. Controleer of er geen lucht meer terugstroomt in de spuit.
 - Spoel het voerdraادلumen met gehepariniseerde zoutoplossing en vul het lumen met gehepariniseerde zoutoplossing.
 - Dompel de gehele Metacross OTW PTA ballondilatatiekatheter onder in fysiologische zoutoplossing.
- Inbrengen en vullen van de ballonkatheter
Controleer vóór het gebruik aan de hand van de volgende tabel of deze katheter compatibel is met de geleidekatheter (niet inbegrepen in deze kit), de inbrenghuls (niet inbegrepen in deze kit) en de voerdraad (niet inbegrepen in deze kit).

Catalogusnummer	Ballondiameter (mm)	Compatibele inbrenghuls (Fr/mm)	Maximumdiameter voor de voerdraad (inch/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L7020CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (exclusief 200 mm ballonlengte), 7 mm (20 mm, 40 mm ballonlengte)	5 Fr / 1,66 mm	0.035 inch (0,89mm)
	6 mm (alleen 200 mm ballonlengte), 7 mm (exclusief 20 mm, 40 mm ballonlengte), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Bij gebruik van de katheter, ingebracht in de inbrenghuls of geleidekatheter

- Bij gebruik van de katheter in de geleidekatheter moet de hemostatische klep worden losgemaakt, maar zodanig dat er geen bloedlekkage kan optreden.
- Breng de katheter, met de ballon volledig geleegd, geleidelijk in de inbrenghuls of geleidekatheter in over de voerdraad en voer de katheter op naar de distale rand van de laesie. Voer de katheter langzaam onder fluoroscopie op tot de radio-opake merker in de ballon de beoogde plaats bereikt.
- Controleer met behulp van fluoroscopie de positie van de radio-opake merker in de ballon en bepaal de dilatatieplaats.
- Bevestig het inflatie-instrument stevig aan de balloninflatiepoort.
- Vul de ballon geleidelijk tot de doeldiameter, controleer hierbij de inflatiedruk en dilateer de stenotische laesie (de diameters van de gevulde ballon vindt u in de balloncompliantietabel, tabel 1, aan het einde van deze gebruiksaanwijzing).

4. Verwijderen van de katheter

- 1) Oefen onderdruk uit om de ballon volledig te legen en verwijder vervolgens de katheter.

5. Opnieuw inbrengen van de katheter

- 1) Als het opnieuw inbrengen van de verwijderde katheter met geleegde ballon vereist is, moet u zorgen dat de ballon volledig geleegd en opgevouwen is voordat u hem opnieuw inbrengt in het bloedvat van de patiënt. Na het opnieuw inbrengen gebruikt u de katheter volgens de paragraaf "Inbrengen en vullen van de ballonkatheter" in deze gebruiksaanwijzing.
- 2) Als er bij het opnieuw inbrengen van de katheter weerstand ondervonden wordt, stopt u met het opvoeren en verwijderd u hem voorzichtig uit het bloedvat van de patiënt. Bereid het gebruik van een nieuwe Metacross OTW voor, overeenkomstig de bovenstaande procedures in dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing.

[Complicaties]

Problemen met het hulpmiddel

- Scheuren van de ballon
- Onvoldoende vullen/leggen van de ballon
- Breken van de ballon en/of de katheterschacht
- Moeilijkheden bij het verwijderen van het hulpmiddel
- Lekkage van inflatievloeistof

Ongunstige gebeurtenissen:

- Plaatselijke of systemische infecties
- Plaatselijke inwendige bloeding of hematoom
- Intimaruptuur
- Vaatdissectie
- Vaatperforatie
- Vaatruptuur
- Aneurysma
- Aritmie
- Acute vaatocclusie
- Veneuze trombo-embolie
- Vasospasme
- Vorming van een pseudo-aneurysma
- Arterioveneuze fistel
- Bloeding waardoor bloedtransfusie nodig is
- Allergische reactie op het contrastmiddel/nierinsufficiëntie
- Pijn of drukpijn
- Overlijden
- Embolie
- Endocarditis
- Koorts
- Hypertensie/hypotensie
- Ontsteking
- Myocardinfarct
- Sepsis
- Shock
- CVA
- TIA

[Opslag en uiterste gebruiksdatum]

1. Op een koele, droge en donkere plaats bewaren. Vermijd blootstelling aan water en direct zonlicht.
2. De uiterste gebruiksdatum is op de doos vermeld. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.

[Verpakking]

1 set/doos

[Naam en adres van fabrikant of vertegenwoordiger]



Fabrikant: KANEKA CORPORATION

Adres: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Telefoonnr.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Faxnr.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Gemachtigde in de EU:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adres: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Telefoonnr.: (+32)-(0) 14-256-297
Faxnr.: (+32)-(0) 14-256-298

Distributeur in de EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adres: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, België
Telefoonnr.: (+32)-(0) 16 381 211
Faxnr.: (+32)-(0) 16 400 249

Alle merknamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TERUMO CORPORATION en hun respectievelijke eigenaren.

Tabel 1. Balloncompliantietabel Metacross OTW

Druk (atm)	Ballondiameter (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										


* Nominale druk

** Bepaalde scheurdruk

[PRODUKTBESKRIVNING]

Metacross OTW är en ballongdilationskateter för perkutan transluminal angioplastik (PTA) för perifer ateroskleros. Metacross OTW är av typen "över en ledare" (OTW, Over The Wire) och den maximala diametern för den kompatibla ledaren är 0,89 mm (0,035 tum). Den distala delen av katetern består av en ballong och dubbla lumenaxlar (koaxiala). Den yttre lumen används för uppblåsning och tömning av ballongen med kontrastmedel som späts ut med koksaltlösning. Den inre lumen (ledarlumen; från den distala spetsen till ledaröppningen) är för införing av en kompatibel ledare för att underlätta frammatning av katetern genom den stenotiska lesionen eller stenten som ska dilateras. Den proximala delen är en dubbellenaxel med grenrör och dubbel luerport, en för uppblåsning/tömning av ballongen och den andra för åtkomst till ledarlumen. De är placerade för att vägleda läkaren vid placering av ballongen på rätt sätt i mållesionen under fluoroskopi. Metacross OTW finns i olika ballongstorlekar beroende på ballongens diameter och längd med rekommenderat uppblåsningstryck (nominellt tryck). Vid uppblåsning varierar ballongens diameter enligt uppblåsningstrycket. Ett diagram över ballongöverensstämmelse för Metacross OTW finns i tabell 1 i slutet av denna bruksanvisning. I den sterila förpackningen är enheten utrustad med skyddsmaterial, ett förvaringsrör för ballongen och en mandrin, som ska avlägsnas före användning. Ballongens förvaringsrör är placerad över ballongen vikt i en låg profil. Mandrinen är införd i ledarlumen för att förhindra kollaps av kateterskafet. Kateterns distala spets har en avsmalnande form för att underlätta kateterns införing i den stenotiska lesionen eller stenten.

<NAMN PÅ VARJE DEL>

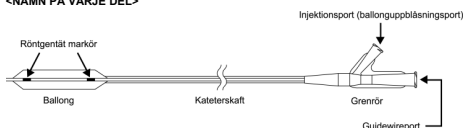

Steril och icke pyrogen i en oskadad och öppen blisterpåse. Denna produkt har steriliserats med etylenoxidgas.

Rekommenderad ledardiameter:

Maximal diameter: 0,89 mm (0,035")

Rekommenderat inflationstryck och max inflationstryck

Nominellt tryck:

– Ballongdiameter: mindre än 6 mm:	10 atm
– Ballongdiameter: 6 mm och större:	8 atm

Märkt bristningstryck:

– Ballongdiameter: mindre än 5 mm:	20 atm
– Ballongdiameter: 5 mm:	18 atm
– Ballongdiameter: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 atm
– Ballongdiameter: 9 mm och större:	12 atm

[INDIKATIONER]

Metacross OTW PTA ballongdilationskateter är avsedd för att tjäna ut stenosis i iliaca-, femoral-, ilio-femoral-, popliteal-, infra-popliteal- och njurarterier, samt för behandling av obstruktiva lesioner av naturlig eller syntetisk arteriovenös dialysfistel. Enheten är även avsedd för stent efterdilatation i periferivaskulaturen.

Obs! Verifieringstestet för stent efterdilatation av Metacross OTW genomfördes med Complete® SE vaskulära stentsystem (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® vaskulära stentsystem (Cordis Corporation) och Epic™ vaskulära självexpanderande stentsystem (Boston Scientific Corporation).

[KONTRAINDIKATIONER]

1. Patienter som har utvecklat anastomotisk stenosis inom en månad efter konstruktion av AV-shunt.
2. Patienter som har lesioner som kommunicerar med ett pseudoaneurysm.

3. Patienter som är gravida.
4. Patienter som inte klarar trombocythämmande behandling eller blodförtunningsbehandling.

[VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]

[Varningar]

1. Enheten är endast avsedd för engångsbruk. Får ej återanvändas. Får ej omsteriliseras. Får ej ombearbetas. Ombearbetning kan äventyra sterilitet, biokompatibilitet och funktionella egenskaper hos produkten.
2. Använd inte produkten om produkten eller förpackningen har skadats.
3. Blås inte upp ballongen mer än till diametern på blodkärlet proximalt och distalt till den stenotiska lesionen.
4. Blås inte upp ballongen till ett tryck över det märkta bristningstrycket
5. Använd inte denna kateter i det centrala cirkulationssystemet

[Försiktighetsåtgärder gällande procedurer]

1. Ta försiktigt och långsamt ut enheten ur förvaringsröret och ta bort skyddsdelarna från enheten. Vårdslös hantering kan skada ballongen och/eller kateterskafet på enheten, vilket försämrar ballonguppblåsningen och/eller tömningen.
2. Blås upp ballongen med kontrastmedel utspätt med saltlösning med blandningsförhållandet 1:1 (nedan kallat "uppblåsningsvätska"). Inga gaser, till exempel luft, får användas för uppblåsningen. (Ballongen kan bli oregelbundet uppblåst.)
3. Före användning ska all luft i ballongen och ballonguppblåsningslumen tappas ur och ersättas med uppblåsningsvätska. (Om inte all luft töms ur kan ballonguppblåsningstillståndet inte observeras under fluoroskopi.)
4. Vid allvariga stenotiska lesioner, till exempel förkalkade lesioner, kan inte blodkärlet dilateras fullt. Blås i så fall inte upp ballongen till ett tryck över det märkta bristningstrycket. (Ballongen kan spricka och material kan lämnas kvar i kroppen.)
5. Precis som för medicinsk utrustning, som används tillsammans med denna kateter, skall användningsinstruktionerna för sådan utrustning användas. (När ballongkateter används för postdilatation av stent under perifer stentplacering, se tillverkarens användningsinstruktioner.)
6. Vid införing i stenten, utdragning från stenen eller dilatation av ballongen i stenten, utför arbetet med försiktighet under fluoroskopi. (Om detta görs utan fluoroskopi kan katetern eller blodkärlet skadas.)
7. Försök inte föra genom Metacross OTW PTA ballongdilationskateter genom en mindre introducer än vad som anges på etiketten. Se produktmärkning.

[Försiktighetsåtgärder under användning]

1. Använd produkten direkt efter att den sterila förpackningen har öppnats.
2. Hela proceduren skall utföras aseptiskt.
3. Denna kateter får endast användas av läkare som har kunskap om perkutan vaskulär behandling.
4. Välj den kateter med korrekt ballongstorlek (ballongdiameter, ballonglängd) enligt följande (procedurer) kriterier.
 - 1) Den uppblåsta ballongdiameteren får inte överskrida kärlets inre diameter proximalt och distalt till lesionen.
 - 2) Den uppblåsta ballongens längd får inte överskrida längden på lesionen som ska behandlas. (Felaktigt val av kateter kan leda till akut vaskulär ocklusion.)
5. Använd endast denna kateter när nödfallskirurgi omedelbart kan utföras.
6. Läkaren som ansvarar för ingreppet skall fastställa varaktighet och antal ballonguppblåsningar baserat på hans/hennes senaste erfarenheter.
7. Heparin saltlösning skall ges för antikoagulation medan denna ballongkateter är införd i blodkärlet.

8. Fyll inte ballongen och för inte in ledaren med katetern böjd eller knäckt.
9. Manipulera försiktigt katetern i blodkärlet för att verifiera dess placering och förflyttning av dess spets under fluoroskopi eller DSA-monitor (Digital Subtraction Angiography).
10. Fyll alltid ballongen medan dess tillstånd studeras under fluoroskopi. Fyll försiktigt ballongen samtidigt som dess rörelse observeras med de röntgentäta markörerna. Om någon abnormitet upptäcks som till exempel motstånd, orörlig kateter under manipulering eller knäckt distal spets på ledaren ska proceduren genast avbrytas och katetern skall långsamt tas bort tillsammans med ledaren.
11. För inte in och ta inte ut denna kateter snabbt. (Utförs detta snabbt kan katetern eller kärlets intima skadas.)
12. Flytta inte denna kateter med ballongen uppblåst. (Flyttas denna kateter med ballongen uppblåst kan det orsaka att ballongen brister eller kateterskaftet bryts.)
13. Blås inte upp och töm inte ballongen snabbt i blodkärlet. (Snabb uppblåsning eller tömning kan skada blodkärlet eller leda till att ballongen brister vilket i sin tur leder till att smuts lämnas kvar i kroppen.)
14. Använd i inte injektor (automatisk injektionsenhet) för att blåsa upp ballongen.
15. Var försiktig så att inte katetern skadas av kirurgisk kniv eller sax.
16. Om någon abnormitet, till exempel kraftigt motstånd, upplevs under manipulering av katetern ska proceduren genast avbrytas. Orsaken ska verifieras och lämpliga åtgärder ska vidtas. (Om arbetet fortsätts med för mycket kraft kan orsaka att katetern eller kärlväggen skadas.)
17. Var alltid uppmärksam på patientens tillstånd och observera kroppstemperaturen, pulsen och andningen. Om abnormitet upptäcks, avbryt genast användningen av katetern eller vidta lämplig åtgärd för patientens tillstånd enligt läkarens bedömning.
18. Efter användning skall katetern avfallshanteras som medicinskt avfall i enlighet med sjukhusets föreskrifter.
19. Använd inte medel som innehåller organiska lösningsmedel eller oljehaltiga kontrastmedel. Kontakt med dessa medel kan leda till att katetern skadas.
20. Vrid eller rotera inte katetern under manipuleringen.
21. Kontrollera att ballongen är helt tömd när enheten förs in eller tas ut ur blodkärlet. (En enhet med större och längre ballong kräver längre tömningstid.)
22. Om motstånd påträffas utdragningen av enheten rekommenderas att hela systemet dras ut tillsammans med introducer/styrhylsan.
23. Använd alltid katetern längs en ledare införd i guide wirelumen.

[Användningsinstruktioner]

Material som vanligtvis krävs för PTA med Metacross OTW PTA ballongdilationskateter omfattar:

- Ledare med lämplig diameter och längd
- Lämplig introducer/styrhylsa och dilator set
- Ampull med kontrastmedel
- Ampull med steril saltlösning
- Upplåsningsanordning med manometer
- Luer-lock-spruta
- Trevägskran

[Användningsmetod eller användningsinstruktioner]

1. Val av kateter
Kontrollera, före användning blodkärlets innerdiameter med fluoroskopi före och distalt till den stenotiska lesionen och välj kateter med lämplig ballongstorlek. Om två storlekar kan användas till den verifierade diametern ska den mindre storleken väljas.
2. Förberedelser
 - 1) Efter att denna kateter aseptiskt har tagits ur förpackningsbehållaren skall de skyddande materialen tas bort.
 - 2) Ersätt luften i ballongen och ballongupplåsningslumen med upplåsningsvätska enligt följande metod.
 - a) Anslut upplåsningsanordningen (ingår inte i detta set) fylld med upplåsningsvätskan till ballongens upplåsningsport.

- b) Efter att det negativa trycket har applicerats i ungefär 10 sekunder på upplåsningsanordningen, riktas kateterns axelspets nedåt och det negativa trycket frigörs sakta för att låta vätskan fylla ballongen och ballongupplåsningslumen och släppa ut luften.
- c) Om det finns någon luft kvar i ballongen och injektionsporten när ballongen har blåsts upp skall proceduren b) upprepas tills att all luft är utsläppt.
- d) Koppla från upplåsningsanordningen från ballongupplåsningsporten och luften tappas ur i cylindern till upplåsningsanordningen.
- e) Anslut upplåsningsanordningen till ballongens upplåsningsport och bibehåll negativt tryck. Verifiera att luften inte längre kommer tillbaka till sprutan.
- 3) Spola ledarlumen med hepariniserad saltlösning och fyll lumen med hepariniserad saltlösning.
- 4) Sänk ner hela Metacross OTW PTA ballongdilationskateter i saltlösning.
3. Införing och uppblåsning av ballongkatetern
Kontrollera före användning att katetern är kompatibel med ledarkatetern (ingår inte i detta set), introducerhylsan (ingår inte i detta set) och ledaren (ingår inte i detta set) med hjälp av följande tabell.

Katalognummer	Ballongdiameter (mm)	Kompatibel hylsa (Fr/mm)	Maximal ledardiameter (tum/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (exklusive 200 mm ballonglängd), 7 mm (20 mm, 40 mm ballonglängd)	5 Fr / 1,66 mm	0,89 mm (0,035 tum)
	6 mm (endast 200 mm ballonglängd), 7 mm (exklusive 20 mm, 40 mm ballonglängd), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Vid användning av denna kateter införd i introducerhylsan eller ledarkatetern

- 1) Vid användning av denna kateter i ledarkatetern, lossa den hemostatiska ventilen medan den hålls tillräckligt tät så att blodläckage förhindras.
- 2) För gradvis in katetern, med ballongen helt tömd, i introducerhylsan eller ledarkatetern förbi ledaren och för in den till lesionens distala periferi. För sakta fram katetern under fluoroskopi tills de röntgentäta markörerna når målplatsen.
- 3) Verifiera under fluoroskopi de röntgentäta markörernas position i ballongen och bestäm dilationsplatsen.
- 4) Anslut upplåsningsanordningen till ballongens upplåsningsport.
- 5) Blås gradvis upp ballongen till måldiametern och verifiera upplåsningsstrycket och tånj ut den stenotiska lesionen (se tabellen över ballongöversensstämmelse i slutet av den här bruksanvisningen för upplåst ballongdiameter).
4. Utdragning av kateter
 - 1) När det negativa trycket har applicerats för att tömma ballongen helt skall katetern dras ut.
5. Återinföring av katetern
 - 1) Om det krävs en återinföring av den borttagna katetern med tömd ballong, ska du kontrollera att ballongen är helt tömd och vikt innan den sätts in i patientens blodkärl. Vid återinföring ska katetern användas enligt avsnittet "Införing och uppblåsning av ballongkatetern" i detta dokument.
 - 2) Om något motstånd påträffas när katetern återinförs ska införingen avbrytas och katetern försiktigt tas ut ur patientens blodkärl. Förbered dig på att använda en ny Metacross OTW enligt de förfaranden som anges ovan i detta avsnitt av bruksanvisningen.

[Komplikationer]

Fel på enheten:

- Ballongbristning
- Otillräcklig uppblåsning/tömning av ballongen
- Ballongen och/eller kateterskftet går sönder
- Svårt att ta ut enheten
- Uppblåsningsvätska läcker ut

Biverkningar:

- Lokal eller systeminfektion
- Lokal intern blödning eller hematom
- Inre bristning
- Vaskulär dissektion
- Vaskulär perforation
- Vaskulär bristning
- Aneurysm
- Arytmi
- Akut vaskulär ocklusion
- Venös tromboembolism
- Vasospasm
- Bildning av pseudoaneurysm
- Arteriovenös fistel
- Blödning som kräver transfusion
- Allergisk reaktion på kontrastmedlet/njursvikt
- Värk eller trycksmärta
- Dödsfall
- Embolism
- Endokardit
- Feber
- Hypertension/hypotension
- Inflammation
- Myokardiinfarkt
- Sepsis
- Chock
- Stroke
- Transitorisk ischemisk attack

Alla märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör TERUMO CORPORATION och dess respektive ägare.

[Förvaring och bäst-före-datum]

1. Förvaras på sval, torr, mörk plats. Får ej utsättas för vatten eller direkt solljus.
2. Bäst-före-datum anges på lådan. Får ej användas efter bäst-före-datum.

[Förpackning]

1 set/låda

[Tillverkarens eller representantens adress]**Tillverkare: KANEKA CORPORATION**

Adress: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tfn: (+81)-(0) 6-6226-5256
Fax: (+81)-(0) 6-6226-5143



Auktoriserad återförsäljare inom EU-området

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adress: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tfn: (+32)-(0) 14-256-297
Fax: (+32)-(0) 14-256-298

EU-distributör: TERUMO EUROPE N.V.

Adress: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, Belgien
Tfn: (+32)-(0) 16 381 211
Fax: (+32)-(0) 16 400 249

Tabell 1. Diagram över ballongöverensstämmelse för Metacross OTW

Tryck (atm)	Ballongdiameter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35**	10.42**	12.61**
14	3.14	4.13	5.27	6.39**	7.48**	8.58**	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50**						
20	3.36**	4.38**	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							


* Nominellt tryck

** Märkt bristningstryck

[BESKRIVELSE AF PRODUKTET]

Metacross OTW er et perkutant transluminalt angioplastisk (PTA) ballondilationskateter til perifer indikationer. Metacross OTW er af typen over-the-wire (OTW = over the wire), og den kompatible guidewires maksimale diameter er 0,89 mm (0,035"). Dette kateters distale del består af en ballon og skafter med dobbeltlumen (koaksial). Den udvendige lumen anvendes til inflation af ballonen med kontrastmiddel fortyndet med saltvand og til tømning af ballonen. Den indvendige lumen (guidewirelumen, fra den distale spids til guidewireporten) er til isætning af en kompatibel guidewire, så det bliver lettere at føre kateteret gennem den stenotiske læsion eller stent, der skal udvides. Den proksimale sektion er et skaft med dobbeltlumen og med manifold med dobbelt luerport, den ene til inflation/tømning af ballonen og den anden til adgang til guidewirelumen. Inden i ballonen angiver to røntgenfaste markører ballonens arbejdslængde for at hjælpe lægen med at placere ballonen korrekt i mållæsionen under fluoroskopi. Metacross OTW fås med forskellige ballonstørrelser hvad angår diameter og længde ved de anbefalede inflationstryk (nominelt tryk). Efter inflation varierer ballondiameteren afhængigt af inflationstrykket. Der er et skema over ballontolerancer for Metacross OTW i tabel 1 sidst i denne brugsanvisning. I den sterile emballage er produktet forsynet med beskyttende materialer, et ballonbeskyttelsesrør og en stilet, som skal fjernes før brug. Ballonbeskyttelsesrøret er placeret over ballonen, der er foldet til en lav profil, og stiletten er ført ind i guidewires lumen for at forhindre kateterskafte i at kollapse. Kateterets distale spids er tilspidsset for at gøre det lettere at føre kateteret ind i den stenotiske læsion eller stent.

<KATETERETS DELE>

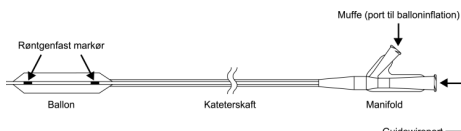

Sterilt og ikke-pyrogen i en ubeskadiget og uåbnet blisterpose. Produktet er steriliseret med ætlenoxid.

Anbefalet guidewirediameter:

Maksimal diameter: 0,89 mm (0,035")

Anbefalede inflationstryk og maksimalt inflationstryk

Nominelt tryk:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| - Ballondiameter: mindre end 6 mm: | 10 atm |
| - Ballondiameter: 6 mm og større: | 8 atm |

Nominelt sprængningstryk:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Ballondiameter: mindre end 5 mm: | 20 atm |
| - Ballondiameter: 5 mm: | 18 atm |
| - Ballondiameter: 6 mm, 7 mm, 8 mm: | 14 atm |
| - Ballondiameter: 9 mm og større: | 12 atm |

[INDIKATIONER]

Metacross OTW PTA ballon-dilationskateteret er beregnet til at dilaterer stenoser i iliac-arterier og i de femorale, iliofemorale, popliteale, infrapopliteale og renale arterier samt til behandling af obstruktive læsioner af naturlige eller syntetiske arteriovenøse dialysefistler. Produktet er desuden indikeret til postdilatation af stents i de perifere blodkar.

Bemærk: Verificeringstesten for stentpostdilatation med Metacross OTW blev udført med Complete® SE Vascular Stent System (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) og Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation).

[KONTRAIKATIONER]

1. Patienter, der har udviklet anastomosestenose inden for en måned efter konstruktion af en AV shunt.
2. Patienter, der har læsioner, som kommunikerer med en pseudoaneurisme.
3. Gravide patienter.
4. Patienter, der ikke kan tåle trombocythæmmende behandling eller antikoagulationsbehandling.

[ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER]

[Advarsler]

1. Dette produkt er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges. Må ikke resteriliseres. Må ikke omforarbejdes. Omforarbejdning kan kompromittere steriliteten, biokompatibiliteten og funktionen af produktet.
2. Må ikke bruges, hvis produktet eller produktemballagen er blevet beskadiget.
3. Ballonen må ikke inflateres til en diameter, der er større end diameteren af blodkarret proksimalt og distalt for stenosislæsionen.
4. Ballonen må ikke inflateres til et tryk, der overstiger det nominelle sprængningstryk.
5. Brug ikke dette kateter i det centrale kredsløb.

[Forholdsregler i forbindelse med procedurer]

1. Tag forsigtig og langsomt produktet ud af forsendelsesrøret, og fjern de beskyttende dele fra produktet. Uforsigtig håndtering kan beskadige ballonen og/eller kateterskafte, så det ikke er muligt at fylde og/eller tømme ballonen.
2. Inflater ballonen med kontrastmiddel fortyndet med saltvand i forholdet 1:1 (herefter kaldet inflationsvæske). Anvend ikke gasholdige midler som f.eks. luft til at fylde ballonen. (Udvildelsen af ballonen kan blive uregelmæssig.)
3. Inden brug skal ballonen og ballonens inflationslumen tømmes for luft, og luften skal erstattes af inflationsvæske. (Hvis luften ikke tømmes helt ud, kan ballonens inflationstilstand ikke observeres vha. fluoroskopi.)
4. I tilfælde af svært stenotiske læsioner, som f.eks. forkalkede læsioner, kan blodkarret ikke dilateres helt. Anvend ikke et tryk, der overskrider det nominelle sprængningstryk i sådanne tilfælde. (Ballonen kan springe, og rester kan forblive i kroppen.)
5. Hvad angår de medicinske produkter, der anvendes sammen med dette kateter, skal brugsanvisningen til hvert enkelt produkt følges. (Se producentens anvisninger i brug, når ballonkateteret anvendes til postdilatation af en stent under perifer stentanlæggelse.)
6. Indføring i stenten, tilbagetrekning fra stenten eller udvidelse af ballonen i stenten skal udføres med forsigtighed ved hjælp af fluoroskopi. (Hvis dette gøres uden fluoroskopisk vejledning, kan det medføre beskadigelse af kateteret eller skade af blodkarret.)
7. Forsøg ikke at føre Metacross OTW PTA ballon-dilationskateteret gennem en introducersheath, der er mindre end angivet på mærkaten. Se produktmærkningen.

[Forholdsregler under brug]

1. Brug produktet umiddelbart efter, at den sterile emballage er åbnet.
2. Hele proceduren skal udføres aseptisk.
3. Dette kateter bør kun anvendes af læger, der har erfaring i perkutan vaskulær behandling.
4. Vælg kateteret med en passende ballonstørrelse (ballondiameter, ballonlængde) i overensstemmelse med følgende (procedure) kriterier.
 - 1) Den inflaterede ballons diameter må ikke være større end den indvendige kardiameter proksimalt og distalt for læsionen.
 - 2) Den inflaterede ballons længde må ikke være større end længden af den læsion, der skal behandles. (Uhensigtsmæssigt valg af kateter kan medføre akut karokklusion.)
5. Brug kun dette kateter, hvis nødkirurgi til enhver tid kan udføres.
6. Den læge, der er ansvarlig for proceduren, skal bestemme varigheden og antallet af balloninflationer baseret på egne erfaringer.

7. Hepariniseret saltvand skal indgives med henblik på antikoagulation, mens dette ballonkateter føres ind i blodkarret.
8. Inflator aldrig ballonen, og før aldrig guidewiren frem, hvis kateteret er bøjet eller snoet.
9. Manipuler kateteret forsigtigt i blodkarret, og kontroller kateterspidens placering og bevægelse vha. fluoroskopi eller DSA (digital subtraktionsangiografi) overvågning.
10. Ballonen skal altid inflateres under fluoroskopi. Inflater ballonen forsigtigt, mens dens bevægelse kontrolleres ved hjælp af de røntgenfaste markører. Hvis der findes unormaliteter, f.eks. let modstand, fastsiddende kateter under manipulation eller snoet distal guidewirespids, skal proceduren afbrydes øjeblikkeligt, og kateteret skal langsomt fjernes sammen med guidewiren.
11. Kateteret må ikke føres ind eller fjernes hurtigt. (Hurtig indføring eller fjernelse kan beskadige kateteret eller skade blodkarrenes intima).
12. Kateteret må ikke bevæges, når ballonen er inflateret. (Hvis kateteret bevæges, mens ballonen er inflateret, kan det medføre, at ballonen springer, eller kateterskafet beskadiges.)
13. Ballonen må ikke fyldes eller tømmes hurtigt i blodkarret. (Hvis den fyldes eller tømmes hurtigt, kan blodkarret blive beskadiget, eller ballonen kan springe, og rester kan forblive i kroppen).
14. Brug ikke en injektor (automatisk injektor) til inflation af ballonen.
15. Udvis forsigtighed, så kateteret ikke bliver beskadiget af en skalpel eller saks.
16. Hvis der fornemmes stærk modstand under manipulation af kateteret, skal proceduren afbrydes øjeblikkeligt. Find årsagen til modstanden, og tag de nødvendige forholdsregler. (Anvend ikke overdreven kraft, da dette kan føre til beskadigelse af kateteret eller blodkarrets væg.)
17. Overvåg patientens tilstand konstant, og overvåg patientens kropstemperatur, puls og vejtrækning. Hvis der optræder unormalitet, skal brugen af kateteret ophøre øjeblikkeligt, eller der skal tages passende forholdsregler for patientens tilstand, ifølge lægens skøn.
18. Efter brug skal kateteret bortskaffes som medicinsk affald i henhold til hospitalets procedurer.
19. Anvend ikke midler, der indeholder organiske opløsningsmidler eller olieholdige kontrastmidler. Kontakt med disse midler kan beskadige kateteret.
20. Dette kateter må ikke drejes eller roteres, når det manipuleres.
21. Kontroller, at ballonen er helt tømt, mens dette produkt føres ind i blodkarret, eller når det fjernes fra blodkarret. (Et produkt med en større og længere ballon kræver længere tømningstid.)
22. Hvis der opstår modstand, når dette produkt trækkes tilbage efter proceduren, anbefales det at trække hele systemet tilbage sammen med introduderen/guidesheathen.
23. Anvend altid kateteret sammen med en guidewire, indført i guidewirens lumen.

[Nødvendigt tilbehør]

Materialer, der typisk er nødvendige til PTA med Metacross OTW

PTA ballon-dilatationskateteret omfatter:

- Guidewire(r) af passende diameter og længde
- Passende introducer/guidesheath og dilatatorsæt
- Hætteflaske med kontrastmiddel
- Hætteflaske med steril saltvand
- Inflator med manometer
- Luerlock-sprøjte
- Trevejsstophane

[Anvendelsesmetode eller anvisninger i brug]

1. Valg af kateteret
Inden brug verificeres blodkarrets indvendige diameter proksimalt og distalt for den stenotiske læsion vha. fluoroskopi. Vælg kateteret med den passende ballonstørrelse. Hvis to størrelser kan anvendes til den verificerede diameter, skal den mindste størrelse vælges.
2. Klargøring
1) Fjern kateteret aseptisk fra emballagebeholderen, og fjern de beskyttende materialer fra kateteret.

- 2) Tøm ballonen og ballonens inflationslumen for luft ved hjælp af inflationsvæske i overensstemmelse med nedenstående procedurer.
 - a) Sæt indeflatoren (følger ikke med i dette sæt) fyldt med inflationsvæske på porten til balloninflation.
 - b) Påfør undertryk på indeflatoren i ca. 10 sekunder, vend kateterskafets spids nedad, og udlign langsomt undertrykket, så væsken fylder ballonen og ballonens inflationslumen, og luften presses ud.
 - c) Hvis der stadig er luft i ballonen og ballonens inflationslumen, skal proceduren gentages, b) indtil ballonen er helt tømt for luft.
 - d) Kobl indeflatoren af porten til balloninflation, og tøm indeflatorens cylinder for luft.
 - e) Sæt indeflatoren fast på porten til balloninflation igen, og oprethold undertryk. Kontroller, at luften ikke kommer tilbage i sprøjten.
- 3) Skyl guidewirens lumen med hepariniseret saltvand og fyld lumen med det hepariniserede saltvand.
- 4) Sænk hele Metacross OTW PTA ballon-dilatationskateteret ned i skalpel.
3. Anlæggelse og inflation af ballonkateteret
Inden brug skal det kontrolleres, at dette kateter er kompatibelt med guidekateteret (følger ikke med i dette sæt), introducersheathen (følger ikke med i dette sæt) og guidewiren (følger ikke med i dette sæt) ved hjælp af den følgende tabel.

Varenummer	Ballondiameter (mm)	Kompatibel sheath (Fr/mm)	Maks. diameter for guidewiren (mm")
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (eksklusive ballonlængde på 200 mm), 7 mm (20 mm, 40 mm ballonlængde)	5 Fr / 1,66 mm	0,89 mm (0.035")
	6 mm (kun ballonlængde på 200 mm), 7 mm (eksklusive ballonlængde på 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Ved brug af kateteret indført i introducersheathen eller guidekateteret

- 1) Når kateteret anvendes i guidekateteret, skal hæmostaseventilen løsnes, men den skal dog være tilstrækkeligt fastspændt til at forhindre udsvivning af blod.
- 2) Før gradvist kateteret med ballonen helt tømt ind i introducersheathen eller guidekateteret over guidewiren, og før det frem til læsionens distale yderkant. Før ved hjælp af fluoroskopi langsomt kateteret frem, til den røntgenfaste markør i ballonen når målstedet.
- 3) Kontroller positionen af den røntgenfaste markør i ballonen ved hjælp af fluoroskopi, og bestem stedet for dilatation.
- 4) Fastgør indeflatoren sikkert til porten til balloninflation.
- 5) Inflater gradvist ballonen til måldiameteren, idet inflationstrykket kontrolleres, og udvid den stenotiske læsion (se diameter for inflaterede balloner i skemaet over ballontolerancer i tabel 1 sidst i denne brugsanvisning).
4. Fjernelse af kateteret
1) Påfør undertryk, indtil ballonen er tømt fuldstændigt, og fjern herefter kateteret.
5. Genanlæggelse af kateteret
1) Hvis genanlæggelse af et fjernet kateter med tømt ballon er nødvendig, skal det kontrolleres, at ballonen er helt tom og sammenfoldet, inden kateteret føres ind i patientens blodkar igen. Ved genanlæggelse skal kateteret anvendes som beskrevet i afsnittet "Anlæggelse og inflation af ballonkateteret" heri.
- 2) Hvis der opstår modstand, når kateteret genanlægges, skal anlæggelsen afbrydes, og kateteret skal tages forsigtigt ud af patientens blodkar. Gør klar til brug af et nyt Metacross OTW i overensstemmelse med procedurerne anført herover i dette afsnit i denne brugsanvisning.

[Komplikationer]

Produktsvigt:

- Ballonruptur
- Utilstrækkelig udvidelse/tømning af ballonen
- Beskadigelse af ballonen og/eller kateterskaftet
- Vanskeligt at fjerne produktet
- Lækage af inflationsvæske

Komplikationer:

- Lokal eller systemisk infektion
- Lokal intern blødning eller hæmatom
- Intimaruptur
- Kardissektion
- Karperforation
- Karruptur
- Aneurisme
- Arytmi
- Akut karokklusion
- Venøs tromboembolisme
- Vasospasmer
- Dannelse af pseudoaneurismer
- Arteriovenøs fistel
- Blødning, der nødvendiggør transfusion
- Allergisk reaktion overfor kontrastmidlet/nyresvigt
- Smerte eller stærke smerter
- Død
- Emboli
- Endocarditis
- Feber
- Hypertension / Hypotension
- Inflammation
- Myokardieinfarkt
- Sepsis
- Shock
- Slagtilfælde
- Transitorisk iskæmisk attack

[Opbevaring og udløbsdato]

1. Opbevares køligt, tørt og mørkt. Må ikke udsættes for vand eller direkte sollys.
2. Udløbsdatoen er anført på æsken. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

[Emballage]

1 sæt/æske

[Navn og adresse på producent eller repræsentant]



Producent: KANEKA CORPORATION

Adresse: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN
TLF.: (+81)-(0) 6-6226-5256
FAX: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresse: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
TLF.: (+32)-(0) 14-256-297
FAX: (+32)-(0) 14-256-298

Forhandler i EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresse: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, Belgien
TLF.: (+32)-(0) 16 381 211
FAX: (+32)-(0) 16 400 249

Alle mærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende TERUMO CORPORATION og deres respektive ejere.

Tabel 1. Metacross OTW Skema over ballontolerance

Tryk (atm)	Ballondiameter (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										


* Nominelt tryk

** Nominelt sprængningstryk

[PRODUKTBESKRIVELSE]

Metacross OTW er et perkutant transluminalt angioplastisk (PTA) ballongdilatasjonskateter for perifer indikasjon. Metacross OTW er en "over the wire"-type (OTW) og maks diameter til kompatibel guidewire er 0,89 mm (0,035 tommer). Den distale delen av dette kateteret består av en ballong og skaft (koaksiale) med dobbellumen. Det utvendige lumenet brukes for å fylle og tømme ballongen med kontrastvæske fortynnet med saltløsning. Det indre lumenet (guidewirelumenet; fra den distale tuppen til guidewireporten) er for innsetting av en kompatibel guidewire for å forenkle fremføringen av kateteret gjennom den stenotiske lesjonen eller stenten som skal dilateres. Det proksimale delen er et dobbelt lumenskaft med dobbellumen portmanifold. En for oppblåsing/tømming av ballongen, den andre for guidewire lumentilgang. Inni ballongen er det plassert to røntgentette markører, som indikerer ballongens arbeidslengde, for å veilede legen i riktig posisjonering av ballongen i mållesjonen under fluoroskopi. Metacross OTW er tilgjengelig i forskjellige ballongstørrelser etter diameter og lengde ved anbefalte oppblåsingstrykk (nominelt trykk). Ved oppblåsing varierer ballongens diameter avhengig av oppblåsingstrykket. Ballong-samsvarsdiagrammet (compliance) for Metacross OTW er i tabell 1 på slutten av denne bruksanvisningen. I den sterile pakken er enheten utstyrt med det beskyttende materialet, et ballongbeskyttelsesrør og en stilet, som skal fjernes før bruk. Ballongbeskyttelsesrøret plasseres over den sammenfoldede ballongen i en lav profil og stiletten føres inn i guidewire-lumenet for å forhindre at kateterskaftet kollapser. Kateterets distale tupp er avsmalnet for å forenkle fremføringen av kateteret inn i den stenotiske lesjonen eller stenten.

<NAVN PÅ DE ENKELTE DELENE>

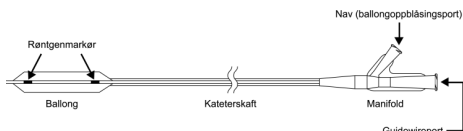

Steril og ikke-pyrogen i uskadet og uåpnet emballasje. Denne enheten er sterilisert med etylenoksidgass.

Anbefalt guidewirediameter,

Maksimal diameter: 0,035" (0,89 mm)

Anbefalt oppblåsingstrykk og maksimalt oppblåsingstrykk

Nominelt trykk:

- Ballongdiameter: mindre enn 6 mm : 10 atm

- Ballongdiameter: 6 mm og større: 8 atm

Antatt sprekketrykk:

- Ballongdiameter: mindre enn 5 mm: 20 atm

- Ballongdiameter: 5 mm: 18 atm

- Ballongdiameter: 6 mm, 7 mm, 8 mm : 14 atm

- Ballongdiameter: 9 mm og større: 12 atm

[INDIKASJONER]

Metacross OTW PTA ballongdilatasjonskateter er beregnet for dilatering av stenoser i arteria iliaca, arteria femoralis, ilio-femoralis, arteria poplitea, infra-popliteal arterie og arteria renales, og for behandling av obstruktive lesjoner i medfødt eller syntetisk arteriovenøs dialysefistel. Denne enheten er også indikert for post-dilatasjon av stent i den perifere vaskulaturen.

Merk: Verifiseringstesten for stent post-dilatasjon av Metacross OTW ble utført ved hjelp av Complete® SE vaskulært stentsystem (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® vaskulært stentsystem (Cordis Corporation) og Epic™ vaskulært selveksperanderende stentsystem (Boston Scientific Corporation).

KONTRAINDIKASJONER

1. Pasienter som har utviklet anastomotisk stenose innen en måned etter konstruksjon av AV-shunt.
2. Pasienter som har lesjoner som kommuniserer med en pseudoaneurisme.
3. Pasienter som er gravide.
4. Pasienter som ikke tåler blodplatehemmende behandling eller antikoagulasjonsbehandling.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

[Advarsler]

1. Denne enheten er kun til engangsbruk. Må ikke brukes på nytt. Må ikke resteriliseres. Må ikke omproduseres. Omproduksjon kan redusere steriliteten, biokompatibiliteten og den fysiske helheten til enheten.
2. Bruk ikke produktet dersom enheten eller emballasjen er skadet.
3. Blås ikke opp ballongen over diameteren til arterien proksimalt eller distalt for stenoselesjonen.
4. Blås ikke opp ballongen over et trykk som tilsvarer antatt sprengtrykk.
5. Bruk ikke dette katetret i det sentrale kretsløpssystemet.

[Forholdsregler relatert til prosedyrene]

1. Fjern enheten langsomt og forsiktig ut av transportrøret og ta av beskyttelsesdelene fra enheten. Uforsiktig håndtering kan skade ballongen og/eller enhetens kateterskaft, slik at ballongen ikke fylles og/eller tømmes.
2. Fyll ballongen med kontrastvæske fortynnet med saltløsning i forhold 1:1 (heretter kalt "inflasjonsvæske"). Bruk ikke gassholdige medier, f.eks. luft, for å fylle ballongen. (Ballongen kan blåses opp raskt.)
3. Fjern bruk, fjern all luft i ballongen og ballongoppblåsningslumenet og erstatt den med inflasjonsvæske. (I tilfelle ufullstendig fjerning av luft, kan ballongens oppblåsing ikke observeres under fluoroskopi.)
4. I tilfelle alvorlige stenotiske lesjoner, som f.eks. forkalkede lesjoner, kan ikke blodkaret dilateres helt. I slike tilfeller må det ikke påføres et trykk som overskrider det nominelle sprengtrykket. (Ballongen kan sprekke og restene kan bli igjen i kroppen.)
5. Når det gjelder medisinsk utstyr som brukes sammen med dette katetret, følg instruksjonene for bruken av slikt utstyr. (Se produsentens bruksanvisning når ballongkatetret brukes for post-dilatasjon av stent under prosedyrer med innsetting av perifer stent.)
6. Vær forsiktig og bruk fluoroskopi ved innsetting i stent, uttrekking fra stent eller dilatasjon av ballongen i stenten. (Hvis dette gjøres uten fluoroskopi, kan katetret eller den vaskulære overflaten bli skadet.)
7. Forsøk ikke å føre Metacross OTW PTA ballongdilatasjonskateter gjennom en innføringshylse som er mindre enn det som er angitt på etiketten. Se produktetiketten.

[Forholdsregler under bruk]

1. Bruk enheten umiddelbart etter at den sterile pakningen er åpnet.
2. Hele prosedyren må utføres aseptisk.
3. Dette katetret skal bare brukes avleger som har erfaring med perkutant vaskulær behandling.
4. Velg et kateter med passende ballongstørrelse (ballongdiameter, ballonglengde) i henhold til følgende (prosedyre)kriterier.
 - 1) Diameteren på den oppblåste ballongen må ikke være større enn indre kardiemater proksimalt og distalt for lesjonen.
 - 2) Lengden på den oppblåste ballongen må ikke være større enn lengden på lesjonen som skal behandles. (Valg av feil kateter kan føre til akutt vaskulær okklusjon.)
5. Bruk dette katetret kun når akutt kirurgi kan utføres.
6. Legen som har ansvaret for prosedyren, må bestemme varighet og antall ballongoppblåsing basert på sin tidligere erfaring.
7. Heparinisert saltvann må infunderes for antikoagulasjon mens ballongkatetret settes inn i blodåren.

8. Blås aldri opp ballongen eller før guidewiren inn mens katetret er bøyd eller brukt.
9. Manipuler katetret forsiktig i blodkaret for å verifisere plasseringen og bevegelsen av spissen under fluoroskopi eller monitorering med DSA (digital subtraksjonsangiografi).
10. Blås alltid opp ballongen under observasjon av inflassjonsstatus med fluoroskopi. Blås ballongen forsiktig opp mens bevegelsen kontrolleres ved hjelp av de røntgentette markørene. Hvis noe unormalt observeres, som f.eks. litt motstand, ubevegelig kateter under manipulerings eller knekket distal spiss på guidewiren, må prosedyren avbrytes umiddelbart og dette katetret må fjernes langsamt sammen med guidewiren.
11. Før ikke inn eller fjern dette katetret raskt. (Rask bruk kan skade katetret eller skade den vaskulære overflaten.)
12. Ikke bevege katetret når ballongen er blåst opp. (Hvis katetret bevegelse mens ballongen er oppblåst, kan det føre til at ballongen sprekker eller at katetret bryter.)
13. Ballongen må ikke fylles eller tømmes raskt i blodkaret. (Rask fylling eller tømming kan skade blodkaret eller føre til at ballongen sprekker og at restene blir igjen i kroppen.)
14. Bruk ikke en injektor (automatisk injeksjonsstyr) for å blåse opp ballongen.
15. Iverksett forebyggende tiltak for å forhindre at katetret blir skadet av en kirurgisk kniv eller saks.
16. Hvis noe unormalt observeres, som f.eks. kraftig motstand under manipulerings av katetret, må prosedyren avbrytes umiddelbart. Årsaken må bekreftes og egnede tiltak iverksettes. (Hvis inngrepet fortsetter med for stor kraft, kan det føre til skade på katetret eller skade på karveggen.)
17. Følg alltid med på pasientens tilstand og overvåk kroppstemperatur, puls og pust. Dersom noe unormalt oppdages, avbryt bruken av katetret umiddelbart og ta adekvate forholdsregler etter pasientens tilstand og legens vurdering.
18. Etter bruk må dette katetret kasseres i henhold til sykehusets prosedyrer.
19. Bruk ikke stoffer som inneholder organiske løsemidler eller oljeaktige kontrastmedier. Kontakt med disse stoffene kan føre til skade på katetret.
20. Katetret må ikke vris eller roteres ved manipulerings av katetret.
21. Når enheten settes inn i blodkaret eller enheten fjernes fra blodkaret, må det kontrolleres at ballongen er helt tømt. (Det tar lenger tid å tømme en enhet med større og lenger ballong.)
22. Dersom det kjennes motstand når enheten trekkes ut etter prosedyren, anbefales det å trekke ut hele systemet sammen med introduseren/innføringshylsen.
23. Bruk alltid katetret sammen med en guidewire ført inn i guidewirlumenet.

[Driftsinstruksjoner]

Materialer som typisk kreves ved PTA med Metacross OTW PTA ballongdilatationskateter, inkluderer:

- Guidewire (r) med egnet diameter og lengde
- Egnert introduser/innføringshylse og dilatatorsett
- Glass med kontrastmiddel
- Glass med steril saltløsning
- Oppblåsningsenhet med manometer
- Sprøyte med Luer-lås
- Treveis stoppekran

[Operasjonsmetode eller bruksanvisning]

1. Valg av kateter
Før bruk må den indre diameter av blodkaret proksimalt og distalt for den stenotiske lesjonen kontrolleres under fluoroskopi, og et kateter med passende ballongstørrelse velges. Dersom to størrelser passer til diameteren, velg den minste størrelsen.
2. Klargjøring
 - 1) Etter at katetret er tatt ut av pakningen med aseptisk teknikk, fjern beskyttelsesmateriellet.
 - 2) Erstatt luften i ballongen og ballongoppblåsningslumenet med inflassjonsvæske i henhold til følgende prosedyre.
 - a) Fest inflassjonsutstyret (ikke inkludert i dette settet) fylt med inflassjonsvæske på ballongporten.

- b) Etter at det er lagt på negativt trykk i omtrent 10 sekunder på inflassjonsutstyret, rett kateterspissen nedover og slipp ut det negative trykket langsomt for å la væske fylle ballongen og ballonginflassjonslumen og slippe ut luften.
- c) Dersom det finnes luft i ballongen og ballonginflassjonslumenet, gjenta prosedyre b) til luften er sluppet ut fullstendig.
- d) Løsne inflassjonsutstyret fra ballonginflassjonsporten og fjern luft fra sylindren til inflassjonsutstyret.
- e) Fest inflassjonsutstyret til ballonginflassjonsporten igjen og oppretthold negativt trykk. Verifiser at det ikke lenger kommer luft tilbake inn i sprøyten.
- 3) Skyll guidewirlumenet med heparinisert saltløsning og fyll lumenet med heparinisert saltløsning.
- 4) Legg hele Metacross OTW PTA ballongdilatationskateter helt ned i saltløsning.
3. Innføring og oppblåsing av ballongkatetret.
Før bruk må det kontrolleres at dette katetret er kompatibelt med guidekatetret (ikke inkludert i dette settet), innføringshylsen (ikke inkludert i dette settet) og guidewiren (ikke inkludert i dette settet) som angitt i følgende tabell.

Katalognummer	Ballongdiameter (mm)	Kompatibel hylse (Fr/mm)	Maksimal diameter for guidewiren (tommer/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (eks. ballonglengde 200 mm), 7 mm (ballonglengde 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0,035 tommer (0,89 mm)
	6 mm (kun ballonglengde 200 mm), 7mm (eks. ballonglengde 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm :	7 Fr / 2,33 mm	

Når dette katetret brukes i innføringshylsen eller guidekatetret

- 1) Når dette katetret brukes i guidekatetret, skal hemostaseventilen løses samtidig som den holdes tett nok til å hindre blodlekkasje.
- 2) Før katetret gradvis inn, med ballongen helt tømt, i innføringshylsen eller guidekatetret over guidewiren og før det frem til lesjonens distale periferi. Før katetret langsomt frem under fluoroskopi til den røntgentette markøren i ballongen når målstedet.
- 3) Verifiser posisjonen til den røntgentette markøren i ballongen under fluoroskopi og fastslå dilatationsstedet.
- 4) Fest dilatasjonsenheten godt til ballonginflassjonsporten.
- 5) Fyll ballongen gradvis til ønsket diameter og verifiser samtidig oppblåsningsstrykket og utvider den stenotiske lesjonen (for diameterer på oppblåst ballong, se ballong-samsvarsdiagrammet i tabell 1 på slutten av denne bruksanvisningen).
4. Fjerning av kateter
 - 1) Etter påføring av negativt trykk for å tømme ballongen fullstendig, fjern katetret.
5. Gjeninnsetting av kateteret
 - 1) Hvis det er nødvendig å sette inn igjen det uthentede kateteret med tømt ballong, må det sikres at ballongen er helt tømt og foldet sammen før den føres inn i pasientens blodkar igjen. Ved gjeninnføring skal kateteret brukes i henhold til avsnittet "Innføring og oppblåsing av ballongkateteret".
 - 2) Dersom det oppleves motstand under gjeninnføringen av kateteret, skal innføringen stoppes og kateteret skal forsiktig tas ut av pasientens blodkar. Vær forberedt på å bruke en ny Metacross OTW i samsvar med prosedyrene i dette avsnittet av bruksanvisningen.

[Komplikasjoner]

Feil på enheten:

- Ballongruptur
- Utilstrekkelig fylling/tømming av ballongen
- Skade på ballongen og/eller kateterskafet
- Problemer med å fjerne enheten
- Lekkasje av inflassjonsvæske

Negative følger:

- Lokal infeksjon eller systemisk infeksjon
- Lokal indre blødning eller hematom
- Ruptur av intima
- Vaskulær disseksjon
- Vaskulær perforasjon
- Vaskulær ruptur
- Aneurisme
- Arytmi
- Akutt vaskulær okklusjon
- Venøs blodpropp
- Vasospasme
- Dannelse av pseudoaneurisme
- Arteriovenøs fistel
- Blødning som krever blodoverføring
- Allergisk reaksjon på kontrastmiddel/nyresvikt
- Verking eller trykkende smerte
- Død
- Emboli
- Endokarditt
- Feber
- Hypertensjon/hypotensjon
- Inflammasjon
- Myokardinfarkt
- Sepsis
- Sjokk
- Slag
- Transitorisk iskemisk attack

[Lagring og utløpsdato]

1. Oppbevares på et kjølig, tørt og mørkt sted. Unngå eksponering for vann og direkte sollys.
2. Utløpsdatoen er angitt på boksen. Må ikke brukes etter utløpsdatoen.

[Forpakning]

1 sett/boks

[Navn og adresse på produsent eller representant]



Produsent: KANEKA CORPORATION

Adresse: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tlf.nr.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Faksnr.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autorisert representant i EU: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresse: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tlf.nr.: (+32)-(0) 14-256-297
Faksnr.: (+32)-(0) 14-256-298

Distributør i EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresse: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgia
Tlf.nr.: (+32)-(0) 16 381 211
Faksnr.: (+32)-(0) 16 400 249

Alle merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
TERUMO CORPORATION og deres respektive eiere.

Tabell 1. Metacross OTW ballong-samsvarsdiagram


Trykk (atm)	Ballongdiameter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96*	6.98*	8.00*	8.98*	9.90*	11.98*
10	3.01*	3.98*	5.06*	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35**	10.42**	12.61**
14	3.14	4.13	5.27	6.39**	7.48**	8.58**	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50**						
20	3.36**	4.38**	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

* Nominelt trykk

**Antatt sprekktrykk

[TUOTTEEN KUVAUS]

Metacross OTW on perkutaanisen transluminaalisen angioplastian (PTA) pallolaajennuskatetri perifeeriseen käyttöön. Metacross OTW on over-the-wire (OTW) -tyyppiä, ja sen kanssa käytettävän ohjainvaijerin enimmäishalkaisija on 0,035 tuumaa (0,89 mm). Katetrin distaaliosa koostuu pallosta ja kaksoislumenvarsiesta (sama-akseliset). Ulompaa lumenia käytetään pallon täyttööseen suolaliuoksella laimennetulla varjoaineella sekä pallon tyhjennykseen. Sisemmän lumenin (ohjainvaijerin lumen, distaalikärjestä ohjainvaijerin porttiin) kautta asetetaan yhteensopiva ohjainvaijeri, joka avustaa katetrin viemistä stenootiseen leesioon tai laajennettavan stentin läpi. Proksimaalisiosassa on kaksi lumenivartta ja kaksi luer-porttihaaraa: yksi pallon täyttööseen/tyhjentämiseen ja toinen ohjainvaijerin lumenia varten. Pallon sisälle on asetettu kaksi röntgenpositiivista merkintää, jotka ilmoittavat pallon työskentelypituuden ja joita lääkäri voi käyttää apunaan pallon asettamisessa kohdeleesioon läpivalaisuun aikana. Metacross OTW -katetreja on saatavilla useina eli pallokokoina läpimitan ja pituuden suhteen suositelluilla täyttöpaineilla (nimellispainee). Pallon täytön aikana pallon läpimitta vaihtelee täyttöpaineen mukaisesti. Metacross OTW -katetrin pallon yhteensopivuustaulukko on esitetty tämän käyttöohjeen lopussa Taulukossa 1. Steriilissä pakkauksessa oleva laite on suojattu suojamateriaaleilla, pallon suojaputkella ja mandriinilla, jotka on poistettava ennen käyttöä. Pallon suojaputki on asetettu pallon päälle taitettuna ohueksi ja mandriini on asetettu ohjainvaijerin lumeniin estämään katetrin varren romahtaminen. Katetrin distaalikärki on teipattu, mikä auttaa katetrin viemistä stenootiseen leesioon tai stenttiin.
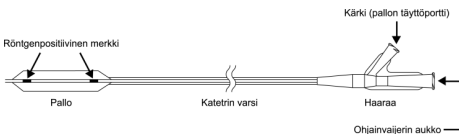
<OSIEN NIMET>

Toimitetaan steriilinä ja pyrogeenittomana ehjässä ja avaamattomassa kuplapussissa. Tämä laite on steriloitu eteeniksidillä.

Suosittelut ohjainvaijerin halkaisija:

Enimmäishalkaisija: 0,035" (0,89 mm)

Suosittelut täyttöpaine ja enimmäistäyttöpaine

Nimellispainee:

- Pallon halkaisija: alle 6 mm:	10 atm
- Pallon halkaisija: 6 mm tai yli:	8 atm

Nimellinen puhkeamispaine:

- Pallon halkaisija: alle 5 mm:	20 atm
- Pallon halkaisija: 5 mm:	18 atm
- Pallon halkaisija: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 atm
- Pallon halkaisija: 9 mm tai yli:	12 atm

[KÄYTTÖAIHEET]

Metacross OTW PTA-pallolaajennuskatetri on tarkoitettu ahtauman laajentamiseen lonkka- ja reisivaltimoissa, lonkka- ja reisivaltimoissa, polvi- ja reisivaltimoissa, infrapopliteaalissa valtimoissa sekä munuaisvaltimoissa sekä synnynnäisten tai synteettisten valtimolaskimodiläylysten aiheuttamien obstruktiivisten leesioiden hoitamiseen. Tämä laite on lisäksi tarkoitettu stentin jälkilaajennukseen perifeerisessä verenkierrassa.

Huomautus: Stentin tarkistustesti Metacross OTW -katetrilla suoritettuna laajennuksen jälkeen tehtiin käyttämällä vaskulaarista Complete® SE -stenttijärjestelmää (Medtronic, Inc), vaskulaarista S.M.A.R.T.® CONTROL® -stenttijärjestelmää (Cordis Corporation) ja itselaajenevaa vaskulaarista Epic™-stenttijärjestelmää (Boston Scientific Corporation).

[VASTA-AIHEET]

1. Potilaat, joille on kehittynyt anastomoottinen ahtauma kuukauden kuluessa AV-shuntin rakentamisesta.
2. Potilaat, joilla on pseudoaneurysman kanssa yhteydessä olevia leesioita.
3. Raskaana olevat potilaat.
4. Potilaat, jotka eivät kestä verihuitaleiden toimintaa estävää lääkettä tai antikoagulaatiohoitoa.

[VAROITUKSET JA VAROTOIMENPITEET]**[Varoitukset]**

1. Tämä laite on kertakäyttöinen. Ei uudelleenkäyttöä. Ei saa uudelleen steriloida. Ei saa uudelleen käsitellä. Uudelleenkäsitellyt saattaa vaarantaa laitteen steriiliyden, biohygieenisuuden ja fyysisen eheyden.
2. Tuotetta ei saa käyttää, jos tuote tai pakkaus on vahingoittunut.
3. Älä laajenna palloa suuremmaksi kuin mitä verisuonen proksimaalinen ja distaalinen halkaisija on ahtaautuneen leesioon kohdalla.
4. Älä laajenna palloa paineeseen, joka on nimellistä puhkeamispainetta suurempi.
5. Älä käytä tätä katetriä sentraalisessa verisuonistossa.

[Toimenpiteeseen liittyvät varoittoimet]

1. Poista laite varovasti ja hitaasti kuljetusputkesta ja poista välineestä suojaosat. Varomaton käsittely voi vaurioittaa palloa ja/tai laitteen katetrin vartta, mikä estää pallon täyttymisen ja/tai tyhjenemisen.
2. Täytä pallo varjoaineella, joka on laimennettu keitto-suolaliuoksella suhteessa 1:1 (tästä lähtien "täytöneste"). Täyttämiseen ei saa käyttää kaasumaisia aineita, kuten ilmaa. (Pallo voi täyttyä epätasaisesti.)
3. Tyhjennä ennen käyttöä kaikki ilma pallosta ja pallon täyttölumenin ja ruiskuta tilalle täytönestettä. (Mikäli ilma ei poistu täysin, pallon täyttötaso ei näy läpivalaisuissa.)
4. Vakavien ahtauttavien leesioiden, kuten kalkkeutuneiden leesioiden, yhteydessä, verisuonta ei voi laajentaa kokonaan. Älä käytä tällaisissa tapauksissa painetta, joka on nimellistä puhkeamispainetta suurempi. (Pallo voi repeytyä ja kehon sisään voi jäädä epäpuhtauksia.)
5. Jos haluat käyttää lääketieteellisiä laitteita tämän katetrin kanssa, noudata kyseisten laitteiden käyttöohjeita. (Kun pallokatetriä käytetään stentin jälkilaajentamiseen perifeerisen stentin laitton yhteydessä, noudata valmistajan antamia käyttöohjeita.)
6. Asetettaessa katetriä stentin läpi, vedettäessä sitä stentistä tai laajennettaessa palloa stentissä on toimittava varovasti ja käytettävä läpivalaisu. (Ilman läpivalaisu toimiminen voi vahingoittaa katetriä tai verisuonta.)
7. Älä yritä työntää Metacross OTW PTA-pallolaajennuskatetriä etiketissä ilmoitettua pienemmän sisäänvientiholkin läpi. Katso tuotemerkinnät.

[Käytön aikaiset varoittoimet]

1. Käytä laitetta heti, kun steriili pakkaus on avattu.
2. Koko toimenpide on suoritettava aseptisesti.
3. Tätä katetriä saavat käyttää vain lääkärit, jotka hallitsevat perkutaanisen verisuonihoidon.
4. Valitse katetri, jonka pallon koko on sopiva (pallon halkaisija ja pallon pituus) seuraavien (toimenpiteiden) kriteerien mukaan.
 - 1) Täytetyn pallon halkaisija ei saa olla suurempi kuin verisuonen sisähalkaisija leesion proksimaali- ja distaalipuolella.
 - 2) Täytetty pallo ei saa olla pidempi kuin hoidettava leesio. (Vääränlaisen katetrin valitseminen voi aiheuttaa akuutin verisuonen tukkeutumisen.)
5. Käytä tätä katetriä vain, kun hätäleikkauks mahdollisuus on saatavilla.
6. Toimenpiteestä vastuussa olevan lääkärin tulee määrittää pallon täyttökertojen kesto ja määrä kokemuksensa perusteella.

- Heparinisoitua suolaliuosta on suositeltava käyttää hyötyymisenestolääkityksenä, kun tätä pallokategoria viedään sisään verisuoneen.
- Älä koskaan täytä palloa tai työnää ohjainvaijeria eteenpäin, jos katetri on taipunut tai mutkalla.
- Käsittele katetria varovasti verisuonessa ja varmista sen kärjen sijainti ja liike läpivalaisulla tai digitaalisella subtraktioangiografialla (DSA).
- Täytä pallo aina seuraamalla samalla sen täyttymistä läpivalaisulla. Täytä pallo varovasti paikallistamalla se samalla röntgenpositiivisten merkkien avulla. Jos havaitset mitään poikkeavaa, kuten vähän vastusta, katetrin olevan liikkumaton käsittelyn aikana tai ohjainvaijerin distaalisen kärjen taipuvan, toimenpide on keskeytettävä välittömästi ja katetri on poistettava hitaasti yhdessä ohjainvaijerin kanssa.
- Älä vie katetria sisään tai poista sitä nopeasti. (Nopeasti toimiminen voi vahingoittaa katetria tai vahingoittaa verisuonen sisäkalvoa.)
- Älä liikuta katetria, kun pallo on täytetty. (Katetrin liikuttaminen, kun pallo on täytetty, voi aiheuttaa pallon puhkeamisen tai katetrin varren katkeamisen.)
- Älä täytä tai tyhjennä pallo nopeasti verisuonessa. (Nopea täyttö tai tyhjennys voi vahingoittaa verisuonta tai saada pallon puhkeamaan, jolloin kehon sisään voi jäädä epäpuhtauksia.)
- Älä käytä injektoria (automaattista injektointilaitetta) pallon täyttämiseen.
- Varo vahingoittamasta katetria leikkauksella tai sakilla.
- Jos havaitset mitään poikkeavaa, kuten vaimakasta vastusta, katetrin käsittelyn aikana, toimenpide on keskeytettävä välittömästi. Poikkeavuuden syy on varmistettava ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. (Äärimmäisellä voimalla jatkaminen voi vaurioittaa katetria tai verisuonen seinämiä.)
- Seuraa aina potilaan tilaa ja valvo kehon lämpötilaa, pulssia ja hengitystä. Jos huomaat jotain poikkeavaa, keskeytä katetrin käyttö välittömästi tai ryhdy asianmukaisiin toimiin potilaan tilan ja lääkärin harkinnan mukaisesti.
- Hävitä katetri käytön jälkeen lääketieteellisenä jätteenä sairaalan käytöntöjen mukaisesti.
- Älä käytä orgaanisia liuottimia sisältäviä aineita tai öljyisiä varjoaineita. Kosketus näihin aineisiin voi aiheuttaa katetrin vaurioitumisen.
- Kun käsittelet katetria, älä taivuta tai kierrä sitä.
- Kun viet tätä laitetta sisään verisuoneen tai poista sitä verisuonesta, varmista, että pallo on täysin tyhjä. (Laitte, jossa on suurempi ja pidempi pallo, edellyttää pidempää tyhjennysaikaa.)
- Jos tunnet vastusta poistaessasi laitetta toimenpiteen jälkeen, on suositeltavaa vetää koko järjestelmä yhdessä sisäänviejän/ohjainholkin kanssa ulos.
- Käytä katetria aina niin, että ohjainvaijeri on työnnetty ohjainvaijerin luumeniin.

[Käyttöohjeet]

Metacross OTW PTA-pallolaajennuskatetrin kanssa tehtävään

PTA:han yleensä tarvittavat materiaalit:

- halkaisijaltaan ja pituudeltaan oikean kokoisia ohjainvaijereita
- asianmukainen sisäänviejä/ohjainholkki ja laajennin
- varjoainepulpo
- keittosuolaliuospulpo
- painemittarilla varustettu täyttölaitte
- Luer-lock-ruisku
- kolmitiehana

[Toimintamenetelmä tai käyttöohjeet]

- Katetrin valitseminen
Varmista ennen käyttöä verisuonen sisähalkaisija läpivalaisussa ahtaauttavan leesio prosimaaliselta ja distaalista puolelta ja valitse katetri, jonka pallo on sopiva. Jos tarkistettuun halkaisijaan sopii kaksi kokoa, valitse pienempi.
- Valmistelu
 - Kun olet poistanut tämän katetrin aseptisesti pakkaussäiliöstä, irrota katetrin suojamateriaalit.

- Korvaa pallossa ja pallon täyttölumenissa oleva ilma täytönesteellä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 - Kiinnitä täytönesteellä täytetty laajennuslaite (ei sisälly tähän pakkaukseen) pallon täyttöporttiin.
 - Kun olet kohdistanut täyttölaitteeseen alpainetta noin 10 sekuntia, ohjaa katetrin varren kärki alaspäin ja vapauta alpaineta hitaasti, jotta neste täyttää pallon ja pallon täyttölumenin ja jotta ilma poistuu.
 - Kun pallossa ja pallon täyttölumenissa on ilmaa, toista toimenpidettä b), kunnes ilma on tyhjentynyt kokonaan.
 - Irrota täyttölaitte pallon täyttöportista ja tyhjennä ilma täyttölaitteen säiliöstä.
 - Kiinnitä täyttölaitte uudelleen pallon täyttöporttiin ja ylläpidä alpainetta. Varmista, että ilma ei enää palaa ruiskuun.
- Huuhtele ohjainvaijerin luumen heparinisoitulla keittosuolaliuoksella ja täytä luumen heparinisoitulla keittosuolaliuoksella.
- Upota koko Metacross OTW PTA-pallolaajennuskatetri keittosuolaliuokseen.
- Pallokatetrin sisäänvienti ja täyttö
Tarkista ennen tämän katetrin käyttämistä, että se on yhteensopiva ohjainvaijerin (ei sisälly tähän pakkaukseen), sisäänviejäholkin (ei sisälly tähän pakkaukseen) ja ohjainvaijerin (ei sisällyt tähän pakkaukseen) kanssa seuraavan taulukon mukaisesti.

Tuotekoodi	Pallon halkaisija (mm)	Yhteensopiva suojus (F/mm)	Ohjainvaijerin enimmäishalkaisija (tuumaa/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L7020CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (pois lukien 200 mm:n pallopituus), 7 mm (20 mm:n, 40 mm:n pallopituus)	5 Fr / 1,66 mm	0,035 tuumaa (0,89 mm)
	6 mm (vain 200 mm:n pallopituus), 7 mm (pois lukien 20 mm:n, 40 mm:n pallopituus), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Käytettäessä katetria työnnettyä sisäänviejäholkkiin tai ohjainkatetrin

- Kun käytät katetria ohjainkatetrissa, löysää hemostaasiventtiiliä ja pidä se samalla riittävän tiukalla verenvuodon estämistä varten.
- Työnää katetri vähitellen pallon ollessa täysin tyhjä sisäänviejäholkkiin tai ohjainkatetriin, ohjainkatetrin läpi ja leesio distaaliseen reunaan. Vie katetria läpivalaisussa hitaasti eteenpäin niin, että sen röntgenpositiivinen merkki saavuttaa kohdealueen.
- Varmista läpivalaisussa röntgenpositiivisen merkin sijainti pallossa ja määritä laajennuskohta.
- Kiinnitä täyttölaitte tiukasti pallon täyttöporttiin.
- Täytä pallo vähitellen tavoitehalkaisijaan, varmista täyttöpaine ja laajenna ahtauttava leesio (tarkista täytetyn pallon läpimitat tämän käyttöohjeen lopussa esitetystä pallon yhteensopivuustaulukosta Taulukko 1).
- Katetrin poistaminen
 - Kun olet tyhjentänyt pallon kokonaan kohdistamalla siihen alpainetta, poista katetri.
- Katetrin vieminen sisään uudelleen
 - Jos poistetun katetrin asettaminen sisään uudelleen pallon ollessa tyhjennetty on tarpeen, varmista, että pallo on täysin tyhjentynyt ja taittunut ennen kuin asetat katetrin uudelleen potilaan verisuoneen. Vie katetri sisään uudelleen Pallokatetrin sisäänvientiä ja täyttäminen -kohdan ohjeiden mukaisesti.
 - Jos tunnet vastusta viedessäsi katetria uudelleen sisään, lopeta vienti ja poista katetri varovasti potilaan verisuonesta. Valmistele uusi Metacross OTW -katetri käyttöön tässä käyttöohjeessa yllä olevassa kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

[Komplikaatiot]

Laitteen toimintahäiriöt:

- Pallon repeäminen
- Pallon riittämätön täyttö/tyhjennys

- Pallon ja/tai katetrin varren rikkoutuminen
- Vaikeudet laitteen poistamisessa
- Täytönesteeseen vuoto

Haittatapahtumat:

- Paikalliset tai systeemiset infektiot
- Paikallinen sisäinen verenvuoto tai hematooma
- Verisuonikalvon repeämä
- Verisuonen dissektio
- Verisuonen perforaatio
- Verisuonen repeämä
- Aneurysma
- Rytmihäiriö
- Akuutti verisuonitukos
- Laskimon tromboembolia
- Verisuonikouristus
- Pseudoaneurysman muodostus
- Valtimo-laskimofisteli
- Verensiirtoa edellyttävä verenvuoto
- Varjoaineallergia / munuaisten vajaatoiminta
- Särky tai painekipu
- Kuolema
- Embolia
- Endokardiitti
- Kuume
- Hypertensio/hypotensio
- Tulehdus
- Sydänlihaseinfarkti
- Sepsis
- Sokki
- Aivohalvaus
- Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö

[Säilytys ja viimeinen käyttöpäivä]

1. Säilytä viileässä, kuivassa ja hämärässä paikassa.
Vältä altistamista vedelle ja suoralle auringonvalolle.
2. Viimeinen käyttöpäivä on mainittu pakkauksessa.
Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

[Pakkaus]

1 setti/laatikko

[Valmistajan tai edustajan nimi ja osoite]



Valmistaja: KANEKA CORPORATION

Osoite: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA 530-8288 JAPAN
Puh: (+81)-(0) 6-6226-5256
Faksi: (+81)-(0) 6-6226-5143

EC	REP
----	-----

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Osoite: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Puh: (+32)-(0) 14-256-297
Faksi: (+32)-(0) 14-256-298

Jakelija EU:n alueella: TERUMO EUROPE N.V.

Osoite: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgium
Puh: (+32)-(0) 16 381 211
Faksi: (+32)-(0) 16 400 249

Kaikki mainitut yritysten nimet ja muut nimet ovat TERUMO CORPORATION ja kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Taulukko 1 Metacross OTW -pallon yhteensopivuustaulukko

Paine (atm)	Pallon halkaisija (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35''	10.42''	12.61''
14	3.14	4.13	5.27	6.39''	7.48''	8.58''	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50''						
20	3.36''	4.38''	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

* Nimellispaine

** Nimellinen puhkeamispaine

[ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ]

Ο Metacross OTW είναι ένας Καθετήρας Διαστολής Διαδερμικής Ενδοαυλικής Αγγειοπλαστικής (PTA) με Μπαλόνι για περιφερικές ενδείξεις. Ο Καθετήρας Διαστολής Metacross OTW είναι τύπου πάνω από το σύρμα (OTW) και η μέγιστος διάμετρος του συμβατού οδηγού σύρματος είναι 0.035 ίντσες (0,89 mm). Το άνω τμήμα αυτού του καθετήρα αποτελείται από ένα μπαλόνι και δύο στέλεχη αυλών (ομοσπονδία). Ο εξωτερικός αυλός χρησιμοποιείται για διαστολή και συστολή του μπαλονιού με σκιαγραφικό μέσο αραιωμένο με φυσιολογικό ορό. Ο εσωτερικός αυλός (ο αυλός του οδηγού σύρματος, από το άνω άκρο έως τη θύρα του οδηγού σύρματος) προορίζεται για την εισαγωγή ενός συμβατού οδηγού σύρματος ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση του καθετήρα διαμέσου της στενωτικής βλάβης ή της προς διαστολή ενδοπρόθεσης. Το εγγύς τμήμα είναι ένα στέλεχος δύο αυλών με πολλαπλή δύο θυρών luer, η μία για διαστολή/συστολή του μπαλονιού, η άλλη για πρόσβαση στον αυλό του οδηγού σύρματος. Στο εσωτερικό του μπαλονιού, έχουν τοποθετηθεί δύο ακτινοσκιογράφοι δείκτες, που υποδεικνύουν το μήκος εργασίας του μπαλονιού, για να καθοδηγούν τον ιατρό στη σωστή τοποθέτηση του μπαλονιού στη στοχευόμενη βλάβη υπό ακτινοσκόπηση. Ο Metacross OTW διατίθεται σε διάφορα μεγέθη μπαλονιού ως προς τη διάμετρο και το μήκος του σε συνιστώμενες πιέσεις διαστολής (Ονομαστική πίεση). Με τη διαστολή, η διάμετρος του μπαλονιού ποικίλει σύμφωνα με την πίεση διαστολής. Ο πίνακας συμμόρφωσης μπαλονιού του Metacross OTW διατίθεται στον Πίνακα 1 στο τέλος αυτών των Οδηγιών Χρήσης. Μέσα στη συσκευασία αποστείρωσης, η συσκευή εφοδιάζεται με τα προστατευτικά υλικά, ένα προστατευτικό σωλήνα μπαλονιού και ένα στυλέο, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν πριν από τη χρήση. Ο προστατευτικός σωλήνας μπαλονιού τοποθετείται πάνω από το μπαλόνι που είναι διπλωμένο με μικρό προφίλ και ο στυλέος εισάγεται στον αυλό του οδηγού σύρματος για να αποτρέψει την θραύση του στελέχους του καθετήρα. Το άνω άκρο του καθετήρα είναι κωνικό για να διευκολύνει την προώθηση του καθετήρα μέσα στη στενωτική βλάβη ή στην ενδοπρόθεση.

<ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ>

Αποστειρωμένο και μη πυρετογόνο σε άθικτη και κλειστή συσκευασία μπάλλερ. Η συσκευή αυτή έχει αποστειρωθεί με οξείδιο του αιθυλενίου.

Συνιστώμενη διάμετρος οδηγού σύρματος:

Μέγιστη διάμετρος: 0.035" (0,89 mm)

Συνιστώμενη πίεση διαστολής και μέγιστη πίεση διαστολής**Ονομαστική πίεση:**

- Διάμετρος μπαλονιού: μικρότερη από 6 mm: 10 atm
- Διάμετρος μπαλονιού: 6 mm και μεγαλύτερη: 8 atm

Ονομαστική πίεση ρήξης:

- Διάμετρος μπαλονιού: μικρότερη από 5 mm: 20 atm
- Διάμετρος μπαλονιού: 5 mm: 18 atm
- Διάμετρος μπαλονιού: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14atm
- Διάμετρος μπαλονιού: 9 mm και μεγαλύτερη: 12 atm

[ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ]

Ο καθετήρας διαστολής PTA με μπαλόνι Metacross OTW προορίζεται για τη διαστολή στένωσης στις λαγόνιες, μηριαίες, λαγονομηριαίες, ιγνακικές, ιγνακικές κάτω του γονάτου και νεφρικές αρτηρίες καθώς και για τη θεραπεία αποφρακτικών βλαβών αυτογενών ή συνθετικών αρτηριοφλεβικών συρρίγγων αιμοκάθαρσης. Αυτή η συσκευή ενδείκνυται επίσης για μετα-διαστολή ενδοπρόθεσης στα περιφερικά αγγεία.

Σημείωση: Η δοκιμή επάλθευσης του Metacross OTW για την μετα-διαστολή ενδοπρόθεσης διενεργήθηκε με χρήση του συστήματος αγγειακής ενδοπρόθεσης Complete® SE Vascular Stent System (Medtronic, Inc), του συστήματος αγγειακής ενδοπρόθεσης S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) και του συστήματος αυτοεκπυκνωσόμενης αγγειακής ενδοπρόθεσης Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation).

[ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ]

1. Ασθενείς που έχουν αναπτύξει αναστομωτική στένωση εντός ενός μηνός από την κατασκευή αρτηριοφλεβικής (AV) επικοινωνίας.
2. Ασθενείς με βλάβες που επικοινωνούν με ψευδοανεύρυσμα.
3. Ασθενείς σε εγκυμοσύνη
4. Ασθενείς που δεν επιδέχονται αντιαθρομβωτική ή αντιπηκτική θεραπεία.

[ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ]**[Προειδοποιήσεις]**

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται για μία μόνο χρήση. Να μην επαναχρησιμοποιηθεί. Να μην επαναποστειρωθεί. Να μην επανεισπείραστεί. Η επανεισπείραξη ενδέχεται να διακυβεύσει τη αποτελεσματικότητα, τη βιοσυμβατότητα και την υλική ακεραιότητα της συσκευής.
2. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το προϊόν ή η συσκευασία της μονάδας είναι κατεστραμμένη.
3. Μην διαστέλλετε το μπαλόνι υπερβαίνοντας τη διάμετρο του αιμοφόρου αγγείου εγγύς και πέραν της στενωτικής βλάβης.
4. Μην διαστέλλετε το μπαλόνι σε πίεση που υπερβαίνει την ονομαστική πίεση ρήξης.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον καθετήρα στο κεντρικό κυκλοφορικό σύστημα.

[Προφυλάξεις που σχετίζονται με διαδικασίες]

1. Αφαιρέστε αργά και με προσοχή τη συσκευή από το σωλήνα-θήκη και απομακρύνετε τα προστατευτικά τμήματα από τη συσκευή. Η μεταχείριση χωρίς τη δέουσα προσοχή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο μπαλόνι και/ή στο στέλεχος του καθετήρα της συσκευής, επηρεάζοντας τη διαστολή και/ή τη συστολή του μπαλονιού.
2. Διαστείλατε το μπαλόνι με τη σκιαγραφική ουσία αραιωμένη σε φυσιολογικό ορό σε αναλογία 1:1 (εφεξής, "υγρό διαστολής"). Για τη διαστολή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αέριο μέσο, όπως αέρας. (Το μπαλόνι ενδέχεται να διασταλεί ανομοιομορφα.)
3. Πριν τη χρήση, αφαιρέστε όλο τον αέρα από το μπαλόνι και από τον αυλό διαστολής του μπαλονιού και αντικαταστήστε τον με το υγρό διαστολής. (Σε περίπτωση ατελούς αφαίρεσης του αέρα, δεν είναι εφικτή η παρακολούθηση της κατάστασης διαστολής του μπαλονιού υπό ακτινοσκόπηση.)
4. Σε περίπτωση σοβαρών στενωτικών βλαβών όπως οι επασβεστωμένες αλλοιώσεις, το αιμοφόρο αγγείο δεν μπορεί να διασταλεί πλήρως. Σε τέτοια περίπτωση μην εφαρμόζετε πίεση που υπερβαίνει την ονομαστική πίεση ρήξης. (Το μπαλόνι μπορεί να διαρραγεί και ενδέχεται να κατέλοιπα να παραμείνουν εντός του σώματος.)
5. Όταν αφορά τις ιστρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτόν τον καθετήρα, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης αυτών των συσκευών. (Όταν ο καθετήρας με μπαλόνι χρησιμοποιείται για τη μετα-διαστολή ενδοπρόθεσης κατά τη διάρκεια διαδικασίας περιφερικής τοποθέτησης ενδοπρόθεσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.)
6. Για την εισαγωγή του μπαλονιού σε μία ενδοπρόθεση, την αφαίρεση του από μία ενδοπρόθεση ή τη διαστολή του μπαλονιού μέσα σε μία ενδοπρόθεση, προχωρήστε με προσοχή υπό ακτινοσκόπηση. (Εάν προβείτε σε αυτές τις ενέργειες χωρίς ακτινοσκόπηση ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτόν τον καθετήρα ή τραυματισμός του αιμοφόρου αγγείου.)
7. Μην επιχειρήσετε να περάσετε τον καθετήρα διαστολής PTA με μπαλόνι Metacross OTW μέσα από θηλάκι εισαγωγής μικρότερου μεγέθους από αυτό που υποδεικνύεται στην ετικέτα. Ανατρέξτε στη δήλωση του προϊόντος.

[Προφυλάξεις κατά τη χρήση]

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αμέσως μετά το άνοιγμα της αποστειρωμένης συσκευασίας.
- Η διαδικασία στο σύνολό της πρέπει να διεξαχθεί υπό άσηπτες συνθήκες.
- Αυτός ο καθετήρας πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο από ιατρούς καταρτισμένους στη διαδερμική αγγειακή θεραπεία.
- Επιλέξτε τον καθετήρα με το κατάλληλο μέγεθος μπαλονιού (διάμετρος μπαλονιού, μήκος μπαλονιού) σύμφωνα με τα ακόλουθα (διαδικασίες) κριτήρια.
 - Η διάμετρος του διασταλμένου μπαλονιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την εσωτερική διάμετρο του αγγείου εγγύς και πέραν της βλάβης.
 - Το μήκος του διασταλμένου μπαλονιού δεν θα υπερβαίνει το μήκος της υπό θεραπεία βλάβης.
(Η επιλογή ακατάλληλου καθετήρα ενδέχεται να οδηγήσει σε οξεία αγγειακή απόφραξη.)
- Χρησιμοποιήστε αυτόν τον καθετήρα μόνο όταν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης επείγουσας χειρουργικής επέμβασης ανά πάσα στιγμή.
- Ο επικεφαλής ιατρός της διαδικασίας πρέπει να προσδιορίσει τη διάρκεια και τον αριθμό των διαστολών του μπαλονιού βάσει της εμπειρίας του.
- Κατά την εισαγωγή αυτού του καθετήρα με μπαλόνι στο αιμοφόρο αγγείο, πρέπει να εγχέεται ηπαρινισμένος φυσιολογικός ορός για αντιπηκτικό.
- Ποτέ μην διαστέλλετε το μπαλόνι ή προωθείτε το οδηγό σύρμα με τον καθετήρα κυρτωμένο ή στρεβλωμένο.
- Χειριστείτε τον καθετήρα με προσοχή μέσα στο αιμοφόρο αγγείο επαληθεύοντας τη θέση και την κίνηση του άκρου του υπό ακτινοσκόπηση ή παρακολούθηση DSA (Digital Subtraction Angiography - Ψηφιακή Αφαρετική Αγγειογραφία).
- Διαστέλλετε πάντα το μπαλόνι ενώ παρακολουθείτε την κατάσταση διαστολής του υπό ακτινοσκόπηση. Διαστέλλετε το μπαλόνι προσηκτικά ενώ επαληθεύετε την κίνηση του με τους ακτινοσκοπικούς δείκτες. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ανωμαλία όπως λίγη αντίσταση, αμετακίνητο καθετήρα κατά το χειρισμό ή στρεβλωμένο το άνω άκρο του οδηγού σύρματος, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη διαδικασία και να αφαιρέσετε αυτόν τον καθετήρα αργά μαζί με το οδηγό σύρμα.
- Μην εισάγετε και μην αφαιρείτε γρήγορα αυτόν τον καθετήρα. (Ο ταχύς χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα ή να τραυματίσει τον έσω χιτώνα του αγγείου.)
- Μην μετακινείτε τον καθετήρα με το μπαλόνι διασταλμένο. (Η μετακίνηση του καθετήρα με το μπαλόνι διασταλμένο ενδέχεται να οδηγήσει σε ρήξη του μπαλονιού ή σε θραύση του στελέχους του καθετήρα.)
- Μην διαστέλλετε και μην συστέλλετε το μπαλόνι γρήγορα εντός του αιμοφόρου αγγείου. (Η ταχεία διαστολή ή συστολή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο αιμοφόρο αγγείο ή να προκαλέσει τη ρήξη του μπαλονιού, γεγονός που θα οδηγήσει στην παραμονή καταλοίπων μέσα στο σώμα.)
- Μην χρησιμοποιείτε εγχυτήρα (συσκευή αυτόματης έγχυσης) για τη διαστολή του μπαλονιού.
- Θα πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στον καθετήρα από χειρουργικό νυστέρι ή ψαλίδι.
- Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ανωμαλία όπως έντονη αντίσταση ενώ χειρίζεστε τον καθετήρα, θα πρέπει να διακόψετε τη διαδικασία αμέσως. Θα πρέπει να επαληθεύσετε την πίεση και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. (Εάν συνεχίσετε τη λειτουργία με υπερβολική δύναμη μπορεί να προκληθεί ζημιά στον καθετήρα ή τραυματισμός του αγγειακού τοιχώματος.)
- Να δίνετε πάντα προσοχή στην κατάσταση του ασθενούς και να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία σώματος, τους παλμούς και την αναπνοή. Όταν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, σταματήστε αμέσως τη χρήση του καθετήρα ή λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την κατάσταση του ασθενούς κατά την ιατρική σας κρίση.
- Μετά τη χρήση απορρίψτε τον καθετήρα ως ιατρικό απόβλητο σύμφωνα με τις διαδικασίες του νοσοκομείου.

- Μην χρησιμοποιείτε παράγοντες που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή ελαίουχες σκιαγραφικές ουσίες. Η επαφή με αυτούς τους παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα.
- Κατά τη διάρκεια του χειρισμού του, μην συστέρετε και μην περιστρέφετε τον καθετήρα.
- Κατά την εισαγωγή αυτής της συσκευής στο αιμοφόρο αγγείο ή κατά την απομάκρυνση της από το αιμοφόρο αγγείο, βεβαιωθείτε ότι το μπαλόνι βρίσκεται σε πλήρη συστολή. (Μία συσκευή με μεγαλύτερο και μακρύτερο μπαλόνι απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο συστολής.)
- Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά την αφαίρεση αυτής της συσκευής μετά την απομάκρυνση, συνιστάται να αφαιρέσετε ολόκληρο το σύστημα μαζί με τον εισαγωγέα / οδηγό θηκάρι.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα τον καθετήρα μαζί με ένα οδηγό σύρμα που έχει εισαχθεί στον αυλό του οδηγού σύρματος.

[Οδηγίες Λειτουργίας]

Τα υλικά που τυπικά απαιτούνται για PTA με τον καθετήρα διαστολής PTA με μπαλόνι Metacross OTW περιλαμβάνουν:

- Οδηγό(α) σύρμα(τα) καταλλήλου διαμέτρου και μήκους
- Κατάλληλο εισαγωγέα/οδηγό θηκάρι και σετ διαστολέα
- Φιαλίδιο σκιαγραφικού μέσου
- Φιαλίδιο φυσιολογικού ορού
- Συσκευή διαστολής με μανόμετρο
- Σύριγγα Luer-lock
- Τριόδη στρόφιγγα

[Μέθοδος λειτουργίας ή οδηγίες χρήσης]

- Επιλογή του καθετήρα
Πριν τη χρήση, επαληθεύστε υπό ακτινοσκόπηση την εσωτερική διάμετρο του αιμοφόρου αγγείου εγγύς και μακράν της στενωτικής βλάβης και επιλέξτε τον καθετήρα με το κατάλληλο μέγεθος μπαλονιού. Εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μεγέθη για τη διάμετρο που επαληθεύτηκε, επιλέξτε το μικρότερο μέγεθος.
- Προετοιμασίες
 - Μετά την αφαίρεση του καθετήρα από την θήκη της συσκευασίας υπό συνθήκες ασηψίας, αφαιρέστε τα προστατευτικά υλικά από τον καθετήρα.
 - Αντικαταστήστε τον αέρα μέσα στο μπαλόνι και τον αυλό διαστολής του μπαλονιού με υγρό διαστολής σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες.
 - Συνδέστε τη συσκευή διαστολής (δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το kit) γεμάτη με το υγρό διαστολής πάνω στη θύρα διαστολής του μπαλονιού.
 - Μετά την εφαρμογή αρνητικής πίεσης για περίπου 10 δευτερόλεπτα στη συσκευή διαστολής, κατευθύνετε το άκρο του στελέχους του καθετήρα προς τα κάτω και απελευθερώστε αργά την αρνητική πίεση επιτρέποντας στο υγρό να γεμίσει το μπαλόνι και τον αυλό διαστολής του μπαλονιού και να εκδιώξει τον αέρα.
 - Εάν διαπιστώσετε την ύπαρξη αέρα μέσα στο μπαλόνι και τον αυλό διαστολής του μπαλονιού, επαναλάβετε τη διαδικασία β) μέχρι να εκδιωχθεί πλήρως ο αέρας.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή διαστολής από τη θύρα διαστολής του μπαλονιού και αφαιρέστε τον αέρα από τον κύλινδρο της συσκευής διαστολής.
 - Επανα συνδέστε τη συσκευή διαστολής στη θύρα διαστολής του μπαλονιού και διατηρήστε την αρνητική πίεση. Επαληθεύστε ότι δεν επιστρέφει πλέον αέρας μέσα στη σύριγγα.
 - Εκπλύνετε τον αυλό του οδηγού σύρματος με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό και γεμίστε τον αυλό με τον ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό.
 - Βυθίστε ολόκληρο τον καθετήρα διαστολής PTA με μπαλόνι Metacross OTW μέσα σε φυσιολογικό ορό.
- Εισαγωγή και διαστολή του καθετήρα με μπαλόνι
Πριν τη χρήση, ελέγξτε εάν αυτός ο καθετήρας είναι συμβατός με τον οδηγό καθετήρα (δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το kit), το θηκάρι εισαγωγέα (δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το kit) και το οδηγό σύρμα (δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το kit) με βάση τον παρακάτω πίνακα.

Κωδικός προϊόντος	Διάμετρος μπαλονιού (mm)	Συμβατό Θηκάρι (Fr/mm)	Μέγιστη διάμετρος για το οδηγό σύρμα (ίντσες/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (εκτός του Μήκους Μπαλονιού των 200 mm), 7 mm (Μήκος Μπαλονιού 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0.035 ίντσες (0.89 mm)
	6 mm (μόνο το Μήκος Μπαλονιού των 200 mm), 7 mm (εκτός του Μήκους Μπαλονιού των 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Όταν χρησιμοποιείτε τον καθετήρα εισηγμένο στο θηκάρι εισαγωγέα ή τον οδηγό καθετήρα

- Όταν χρησιμοποιείτε τον καθετήρα μέσα στον οδηγό καθετήρα, χαλαρώστε την αιμοστατική βαλβίδα ενώ την κρατάτε αρκετά σφιχτή ώστε να αποφευχθεί η διαρροή αίματος.
- Εισάγετε σταδιακά τον καθετήρα, με το μπαλόνι σε πλήρη συστολή, στο θηκάρι εισαγωγέα ή τον οδηγό καθετήρα πάνω από το οδηγό σύρμα και προωθήστε προς την άνω περιφέρεια της βλάβης. Υπό ακτινοσκόπηση, προωθήστε τον καθετήρα αργά μέχρι ο ακτινοσκοπικός του δείκτης μέσα στο μπαλόνι να φτάσει στο σημείο-στόχο.
- Υπό ακτινοσκόπηση, επαληθεύστε τη θέση του ακτινοσκοπικού δείκτη μέσα στο μπαλόνι και καθορίστε το σημείο διαστολής.
- Συνδέστε με ασφάλεια τη συσκευή διαστολής στη θύρα διαστολής του μπαλονιού.
- Διαστείλατε το μπαλόνι σταδιακά στη διάμετρο-στόχο επαληθεύοντας την πίεση διαστολής και διαστείλατε τη στενωπική βλάβη (για τις διαμέτρους του διεσταλμένου μπαλονιού συμβουλευθείτε τον πίνακα συμμόρφωσης μπαλονιού που παρέχεται στον Πίνακα 1 στο τέλος αυτών των Οδηγιών Χρήσης).
- Απομάκρυνση του καθετήρα
 - Αφού εφαρμόσετε αρνητική πίεση για την πλήρη συστολή του μπαλονιού, απομακρύνετε τον καθετήρα.
- Επανεισαγωγή του καθετήρα
 - Εάν απαιτείται επανεισαγωγή του αφαιρεμένου καθετήρα με το μπαλόνι σε συστολή, βεβαιωθείτε ότι το μπαλόνι έχει συσταλεί πλήρως και έχει διπλωθεί πριν το επανεισάγετε στο αιμοφόρο αγγείο του ασθενούς. Κατά την επανεισαγωγή χρησιμοποιήστε τον καθετήρα σύμφωνα με την ενότητα "Εισαγωγή και διαστολή του καθετήρα με μπαλόνι".
 - Εάν συναντήσετε τυχόν αντίσταση ενώ επανεισάγετε τον καθετήρα, σταματήστε την προώθησή του και προσεκτικά αφαιρέστε τον από το αιμοφόρο αγγείο του ασθενούς. Προετοιμαστείτε για τη χρήση ενός νέου Metacross OTW σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρέχονται παραπάνω σε αυτή την ενότητα αυτών των Οδηγιών Χρήσης.

[Επιπλοκές]

Αστοχίες Συσκευής:

- Ρήξη μπαλονιού
- Ανεπαρκής συστολή / διαστολή του μπαλονιού
- Θραύση του μπαλονιού και / ή του στελέχους καθετήρα
- Δυσκολία στην απομάκρυνση της συσκευής
- Διαρροή υγρού διαστολής

Ανεπιθύμητα Συμβάντα:

- Τοπικές ή συστηματικές λοιμώξεις
- Τοπική εσωτερική αιμορραγία ή αιμάτωμα
- Ρήξη του έσω χιτώνα
- Αγγειακός διαχωρισμός
- Αγγειακή διάτρηση
- Αγγειακή ρήξη
- Ανεύρυσμα
- Αρρυθμία
- Οξεία αγγειακή απόφραξη
- Φλεβικός θρομβοεμβολισμός
- Αγγειοσπασμός

- Σχηματισμός ψευδοανευρύσματος
- Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο
- Αιμορραγία που απαιτεί μετάγγιση
- Αλλεργική αντίδραση στα σκιαγραφικά μέσα / νεφρική ανεπάρκεια
- Άλλος ή πιεστικός πόνος
- Θάνατος
- Εμβολισμός
- Ενδοκαρδιπίδα
- Πυρετός
- Υπέρταση / Υπόταση
- Φλεγμονή
- Έμφραγμα του μυοκαρδίου
- Σήψη
- Καταπληξία
- Αποπληξία
- Παροδική Ισχυμική Προσβολή

[Αποθήκευση και ημερομηνία λήξης]

- Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό, σκοτεινό μέρος. Αποφύγετε την έκθεση σε νερό, άμεσο ηλιακό φως.
- Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο κουτί. Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

[Συσκευασία]

1 σετ/κουτί

[Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου]



Κατασκευαστής: KANEKA CORPORATION

Διεύθυνση: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city, OSAKA, 530-8288 JAPAN

Αρ. τηλ.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Αρ. fax: (+81)-(0) 6-6226-5143



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Διεύθυνση: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Αρ. τηλ.: (+32)-(0) 14-256-297

Αρ. fax: (+32)-(0) 14-256-298

Διανομέας στην ΕΕ: TERUMO EUROPE N.V.

Διεύθυνση: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgium

Αρ. τηλ.: (+32)-(0) 16 381 211

Αρ. fax: (+32)-(0) 16 400 249

Όλες οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν εμπορικά σήματα της TERUMO CORPORATION και των αντιστοίχων ιδιοκτητών τους

Πίνακας 1. Πίνακας Συμμόρφωσης Μπαλονιού του Metacross OTW

Πίεση (atm)	Διάμετρος Μπαλονιού (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										


* Ονομαστική πίεση

** Ονομαστική Πίεση Ρήξης

[ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ]

Metacross OTW – это баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) периферических сосудов. Metacross OTW – это система доставки стента по проводнику (OTW), а максимальный диаметр совместимого проводника составляет 0,035 дюймов (0,89 мм). Дистальный участок данного катетера состоит из баллона и двухпросветных shaft'ов (коаксиальных). Внешний просвет предназначен для раздувания и сдувания баллона с использованием контрастного вещества, растворенного в физиологическом растворе. Внутренний просвет (просвет проводника; от дистального кончика до порта проводника) предназначен для введения совместимого проводника, чтобы облегчить продвижение катетера через участок стеноза или расширяемый стент. Проксимальный участок представляет собой двухпросветный стержень с двойным портом Люэра Manifold; один для надувания / сдувания баллона, другой для доступа к просвету проводника. Внутри баллона расположены две рентгеноконтрастные метки, которые показывают рабочую длину баллона и помогают врачу правильно расположить баллон в очаге поражения под контролем рентгеноскопии. Катетеры Metacross OTW имеют разные размеры баллона в зависимости от диаметра и длины при рекомендованном давлении раздувания (Номинальное давление). После раздувания диаметр баллона варьируется в соответствии с давлением раздувания. Шкала растяжимости баллонов Metacross OTW представлена в Таблице 1 в конце данной Инструкции по применению. В стерильной упаковке устройство защищено специальными приспособлениями – защитной трубкой для баллона и стилетом, которые следует удалить перед применением. Защитная трубка баллона размещается поверх максимально свернутого баллона, а стилет вставлен в просвет проводника с целью предотвращения поломки shaft'а катетера. Дистальный кончик катетера суживается к концу, чтобы облегчить продвижение катетера в участок стеноза или в стент.

<НАИМЕНОВАНИЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ>

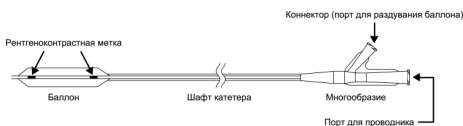

Стерильно и апиrogenно в неповрежденной и нераскрытой блистерной упаковке. Данное изделие стерилизовано оксидом этилена.

Рекомендуемый диаметр проводника:

Максимальный диаметр: 0,035" (0,89 мм)

Рекомендуемое давление раздувания и максимальное давление раздувания

Номинальное давление:

- Диаметр баллона: менее 6 мм: 10 атм
- Диаметр баллона: 6 мм и более: 8 атм

Расчетное давление разрыва:

- Диаметр баллона: менее 5 мм: 20 атм
- Диаметр баллона: 5 мм: 18 атм
- Диаметр баллона: 6 мм, 7 мм, 8 мм: 14 атм
- Диаметр баллона: 9 мм и более: 12 атм

[ПОКАЗАНИЯ]

Периферический баллонный катетер для ЧТА Metacross OTW предназначен для расширения стенозированных участков в подвздошной, бедренной, подвздошно-бедренной, подколенной, нижних подколennых и ренальной артериях, а также для лечения обструктивных участков стеноза в сформированной

«естественной» или искусственной артериовенозной фистуле для диализа. Данное устройство также предназначено для расширения сосуда после установки стента в периферическом сосудистом русле.

Примечание. Проверочные испытания стента после раздувания катетера Metacross OTW проводились с использованием Системы стентирования сосудов Complete® SE (Medtronic, Inc), Системы стентирования сосудов S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) и Самораскрывающейся системы стентирования сосудов Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ]

1. Пациенты с развившимся анастомозным стенозом в течение одного месяца после операции артериовенозного шунтирования.
2. Пациенты с патологическими изменениями, связанными с псевдоаневризмой.
3. Беременные пациентки.
4. Пациенты с непереносимостью антитромбоцитарной или антикоагулянтной терапии.

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]

[Предупреждения]

1. Данное изделие предназначено для одноразового использования. Не использовать повторно. Не стерилизовать. Не подвергать повторной обработке. Повторная обработка может нарушить стерильность, биологическую совместимость и функциональную целостность изделия.
2. Не использовать, если изделие или его упаковка были повреждены.
3. Не раздувайте баллон больше диаметра здорового кровеносного сосуда проксимальнее и дистальнее стеноза.
4. Не накачивайте баллон до давления, превышающего расчетное давление разрыва.
5. Не используйте этот катетер для операций на коронарных сосудах.

[Меры предосторожности во время процедуры]

1. Медленно и осторожно извлеките устройство из держателя и удалите защитные части изделия. Неосторожное обращение может повредить баллон и/или shaft' катетера, препятствуя раздуванию и/или сдуванию баллона.
2. Раздуйте баллон при помощи контрастного вещества, разведенного в физиологическом растворе в соотношении 1:1 (далее по тексту «жидкость раздувания»). Для раздувания не следует использовать газообразные вещества, такие как воздух. (Баллон в этом случае может раздуться неравномерно.)
3. Перед использованием удалите весь воздух из баллона и просвета для раздувания баллона и заполните его жидкостью раздувания. (В случае неполного удаления воздуха раздувание баллона невозможно будет контролировать во время рентгеноскопии.)
4. При наличии серьезных участков стеноза, таких как кальцифицированные очаги, кровеносный сосуд невозможно будет раздуть полностью. В этом случае запрещается применять давление, превышающее расчетное давление разрыва. (Баллон может разорваться и в теле пациента могут остаться его части.)
5. При использовании совместно с катетером других устройств, соблюдайте инструкции по использованию данных устройств. (При использовании баллонного катетера для расширения стента при проведении процедуры установки периферического стента смотрите инструкцию по применению изготовителя стента.)
6. Для введения в стент, извлечения из стента или раздувания баллона внутри стента действуйте с осторожностью под контролем рентгеноскопии. (Проведение процедуры без

рентгеноскопического контроля может привести к повреждению катетера или травме внутренней оболочки сосуда.)

7. Не пытайтесь провести периферический баллонный катетер для ЧТА Metacross OTW через интродьюсер меньшего размера, чем указано на маркировке. См. маркировку продукта.

[Меры предосторожности во время использования]

1. Используйте устройство сразу же после вскрытия упаковки.
2. Вся процедура должна проводиться с соблюдением правил асептики.
3. Данный катетер должен использоваться только врачами, обладающими навыками чрескожной сосудистой хирургии.
4. Выберите катетер с соответствующим размером баллона (диаметр баллона, длина баллона) в соответствии со следующими критериями.
 - 1) Диаметр баллона в раздутом состоянии не должен превышать внутренний диаметр сосуда проксимальнее и дистальнее пораженного места.
 - 2) Длина баллона в раздутом состоянии не должна превышать длину целевого участка, на котором будет проводиться процедура.
(Неверный выбор катетера может привести к острой сосудистой окклюзии.)
5. Используйте данный катетер только в том случае, если неотложная операция может быть выполнена в любое время.
6. Врач, отвечающий за проведение процедуры, должен определить длительность и число раздуваний баллона в соответствии с имеющимся у него опытом.
7. Во время нахождения баллона в кровеносном сосуде необходимо вливать гепаринизированный физиологический раствор для антикоагуляции.
8. Никогда не раздувайте баллон и не продвигайте проводник по перегнутому или перекрученному катетеру.
9. Выполняйте все манипуляции с катетером с осторожностью, проверяя положение и перемещение кончика катетера под рентгеновским контролем или с использованием цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА).
10. Всегда раздувайте баллон под контролем рентгена. Осторожно раздувайте баллон, проверяя его движение при помощи рентгеноконтрастных меток. В случае возникновения каких-либо отклонений, например, небольшого сопротивления, неподвижности катетера во время манипуляций или перекручивания дистального кончика проводника, следует незамедлительно прервать процедуру и медленно извлечь катетер вместе с проводником.
11. Нельзя быстро вводить или извлекать этот катетер. (Быстрые действия могут привести к повреждению катетера или травме внутренней оболочки сосуда.)
12. Не перемещайте катетер с раздутым баллоном. (Перемещение катетера с раздутым баллоном может привести к разрыву баллона или поломке шфта катетера).
13. Нельзя быстро раздувать или сдувать баллон в кровеносном сосуде. (Быстрое раздувание или сдувание может привести к повреждению сосуда или разрыву баллона, остатки которого могут остаться внутри тела.)
14. Не используйте инжектор (устройство автоматической инъекции) для раздувания баллона.
15. Необходимо принять меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждение катетера скальпелем или ножницами.
16. Если при манипуляциях с катетером возникает какая-либо аномальная ситуация, такая как, например, сильное сопротивление, процедуру необходимо немедленно прекратить. Необходимо установить причину данной ситуации и предпринять соответствующие меры. (Продолжение работы с применением чрезмерной силы может привести к повреждению катетера или травмированию стенки сосуда.)
17. Всегда обращайтесь внимание на состояние пациента и отслеживайте температуру тела, пульс и дыхание. В случае каких-либо отклонений немедленно прекратите

использование катетера или примите соответствующие меры, адекватные, по мнению врача, состоянию пациента.

18. Всегда утилизируйте катетер как медицинские отходы в соответствии с процедурами медицинского учреждения.
19. Не используйте вещества, содержащие органические растворители и контрастные вещества на масляной основе. При контакте с данными веществами может произойти повреждение катетера.
20. При манипуляциях с катетером не скручивайте его и не вращайте.
21. При вводе данного изделия в кровеносный сосуд или извлечении его из сосуда убедитесь, что баллон полностью сдут. (Изделие с более крупным и длинным баллоном потребует большего времени для сдувания.)
22. Если после проведения операции при извлечении устройства чувствуется сопротивление, рекомендуется извлечь всю систему вместе с интродьюсером / проводником.
23. Всегда используйте катетер по проводнику, установленному в просвете для проводника.

[Инструкция по эксплуатации]

Стандартные материалы, необходимые для ЧТА с использованием периферического баллонного катетера Metacross OTW:

- Проводник (-и) соответствующего диаметра и длины
- Соответствующий комплект интродьюсер / проводник и дилататор
- Флакон контрастного вещества
- Флакон стерильного физиологического раствора
- Индефлятор с манометром
- Шприц с лuer-ловками наконечником
- Трехходовой кран

[Методика выполнения или инструкция по применению]

1. Выбор катетера
Перед использованием проверьте под рентгеновским контролем внутренний диаметр кровеносного сосуда проксимально и дистально стенозному повреждению и выберите катетер с соответствующим размером баллона. Если для полученного диаметра могут быть применены два размера, выберите меньший размер.
2. Подготовка
 - 1) После асептического извлечения этого катетера из упаковочного контейнера удалите защитные материалы.
 - 2) Удалите воздух в баллоне и просвете раздувания баллона с помощью жидкости раздувания в соответствии со следующими процедурами.
 - a) Подсоедините устройство раздувания (не входит в данный комплект), заполненное жидкостью раздувания к порту раздувания баллона.
 - b) После создания отрицательного давления в течение 10 секунд на устройстве раздувания, направьте кончик стержня катетера вниз и медленно сбросьте негативное давление для того, чтобы жидкость заполнила баллон и просвет раздувания баллона и вытолкнула весь воздух.
 - c) При обнаружении воздуха в баллоне и хабе после раздувания баллона жидкостью раздувания, повторите процедуру b) до полного удаления воздуха.
 - d) Отсоедините устройство раздувания от порта раздувания баллона и удалите воздух из цилиндра устройства раздувания.
 - e) Снова подсоедините устройство раздувания к порту раздувания баллона и поддерживайте отрицательное давление. Убедитесь, что воздух больше не возвращается в шприц.
 - 3) Промойте просвет проводника гепаринизированным физиологическим раствором и заполните просвет гепаринизированным физиологическим раствором.
 - 4) Погрузите весь периферический баллонный катетер ЧТА Metacross OTW в физиологический раствор.

3. Введение и раздувание баллонного катетера

Перед использованием катетера проверьте, совместим ли данный катетер с направляющим катетером (не входит в данный набор), интродьюсером (не входит в данный набор) и проводником (не входит в данный набор) с использованием следующей таблицы.

Каталожный номер	Диаметр баллона (мм)	Совместимый шaft (Fr/мм)	Максимальный диаметр проводника (двоймы/мм)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм (исключая баллон длиной 200 мм), 7 мм (длина баллона 20 мм, 40 мм)	5 Fr / 1,66 мм	0.035 двоймы (0.89 мм)
	6 мм (только для баллона длиной 200 мм), 7 мм (исключая длину баллона 20 мм, 40 мм), 8 мм	6 Fr / 2,00 мм	
	9 мм, 10 мм, 12 мм	7 Fr / 2,33 мм	

Когда данный катетер, введен в интродьюсер или направляющий катетер

- 1) При использовании данного катетера в направляющем катетере ослабьте гемостатический клапан, сохраняя его достаточно плотно закрытым, чтобы предотвратить протекание крови.
- 2) Постепенно вводите катетер с полностью сдутым баллоном в интродьюсер или направляющий катетер по проводнику и продвигайте его дистальнее к периферии участка поражения. Под рентгеновским контролем медленно продвигайте катетер до тех пор, пока рентгеноконтрастная метка баллона не достигнет целевого участка.
- 3) С помощью рентгена проверьте положение рентгеноконтрастной метки в баллоне и определите участок для расширения.
- 4) Жестко закрепите устройство раздувания / сдувания баллона на порте раздувания баллона доставляющего катетера.
- 5) Постепенно раздуйте баллон до необходимого диаметра, контролируя давление раздувания и расширьте участок стеноза (информацию о диаметрах раздувания баллонов см в шкале растяжимости баллонов, приведенной в Таблице 1 в конце данной Инструкции по применению).
4. Извлечение катетера
 - 1) После полного сдувания баллона извлеките катетер.
 5. Повторный ввод катетера
 - 1) Если потребуется повторно ввести извлеченный катетер со сдутым баллоном, убедитесь в том, что баллон полностью сдут и сложен перед повторным вводом его в кровеносный сосуд пациента. При повторном введении используйте катетер в соответствии с разделом «Ввод и раздувание баллонного катетера» данного документа.
 - 2) Если при повторном вводе катетера ощущается сопротивление, прекратите продвижение катетера и осторожно извлеките его из кровеносного сосуда пациента. Подготовьте к использованию новый катетер Metacross OTW в соответствии с приведенными ранее в данном разделе процедурами данной Инструкции по применению.

[Осложнения]

Неисправности устройства:

- Разрыв баллона
- Недостаточное раздувание / сдувание баллона
- Поломка баллона и / или шфта катетера
- Сложности при извлечении устройства
- Утечка жидкости раздувания

Нежелательные явления:

- Локальная или системная инфекция
- Локальное внутреннее кровотечение или гематома
- Разрыв внутренней оболочки сосуда
- Диссекция сосуда

- Перфорация сосуда
- Разрыв сосуда
- Аневризма
- Аритмия
- Острая сосудистая окклюзия
- Венозная тромбоэмболия
- Сосудистый спазм
- Образование псевдоаневризмы
- Артериовенозная фистула
- Кровотечение, требующее переливания крови
- Аллергическая реакция на контрастное вещество
- Болезненные ощущения или давящая боль
- Летальный исход,
- Эмболизм
- Эндокардит
- Лихорадка
- Гипертензия / Гипотензия
- Воспаление
- Инфаркт миокарда
- Сепсис
- Шок
- Инсульт
- Транзиторная ишемическая атака

[Условия и срок хранения]

1. Храните в сухом, прохладном и темном месте. Избегайте попадания воды и прямых солнечных лучей.
2. Дата окончания срока годности указана на коробке. Не использовать после истечения срока годности.

[Упаковка]

1 комплект/коробка

[Название и адрес изготовителя или представителя]



Изготовитель: KANEKA CORPORATION

Адрес: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city, OSAKA, 530-8288, JAPAN

№ тел.: (+81)-(0) 6-6226-5256

№ факса: (+81)-(0) 6-6226-5143



Авторизованный представитель в Европейском сообществе:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Адрес: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

№ тел.: (+32)-(0) 14-256-297

№ факса: (+32)-(0) 14-256-298

Дистрибьютор на территории EC: TERUMO EUROPE N.V.

Адрес: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Бельгия

№ тел.: (+32)-(0) 16 381 211

№ факса: (+32)-(0) 16 400 249

Все фирменные наименования являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками TERUMO CORPORATION и соответствующих владельцев.

Таблица 1. Шкала растяжимости баллонов Metacross OTW

Давление (атм)	Диаметр баллона (мм)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										


* Номинальное давление

** Расчетное давление разрыва

[OPIS PRODUKTU]

Metacross OTW jest balonowym cewnikiem dylatacyjnym do przezskórnej angioplastyki (Percutaneous Transluminal Angioplasty, PTA) przeznaczonym do naczyń obwodowych. Metacross OTW to cewnik typu Over-the-Wire (OTW); maksymalna średnica kompatybilnego przewodnika to 0,035 cala (0,89 mm). Część dystalna cewnika składa się z balonu i korpusu (trzonu) o podwójnym świetle (współosiowo). Światło zewnętrzne jest stosowane do napełniania i opróżniania balonu środkiem kontrastowym rozpuszczonym w roztworze soli fizjologicznej. Wewnętrzne światło (światło przewodnika; od końcówki dystalnej do portu przewodnika) jest używane do umieszczania zgodnego przewodnika w celu ułatwienia wprowadzania cewnika przez zmianę stenotyczną lub stent, które mają zostać poszerzone. Część proksymalna to trzon z podwójnym światłem, z rozgałęźnikiem z podwójnym portem typu luer; jeden do napełniania/oprózniczenia balonu, drugi zapewniający dostęp do światła przewodnika. We wnętrzu balonu umieszczone są dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieniowania rentgenowskiego, które wskazują długość roboczą balonu, i służą lekarzowi do prawidłowego umieszczenia balonu w docelowej zmianie stenotycznej pod kontrolą badania fluoroskopowego. Cewnik Metacross OTW jest dostępny z różnymi rozmiarami balonu (średnica i długość) przy zalecanych ciśnieniach napełniania (ciśnienie nominalne). Po napełnieniu średnica balonu zmienia się w zależności od ciśnienia napełnienia. Dane zgodności cewnika Metacross OTW zamieszczone w Tabeli 1 na końcu niniejszej instrukcji stosowania. W ramach sterylnego pakietu urządzenie jest wyposażone w materiały ochronne, pojemnik ochronny balonu i mandryn, które należy usunąć przed użyciem. Pojemnik ochronny balonu jest umieszczany na balonie złożonym do niewielkich rozmiarów, a mandryn jest wsuwany do światła przewodnika, by zapobiec zapadnięciu trzonu cewnika. Końcówka dystalna cewnika jest zwężona, co ułatwia wsuwanie cewnika do zmiany stenotycznej lub stentu.

<NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI>



Sterylny i jałowy w nieuszkodzonym i nieotwartym blistrze. Ten wyrób jest sterylizowany tlenkiem etylenu.

Zalecana średnica przewodnika:

Maksymalna średnica: 0,89 mm (0,035")

Zalecane ciśnienie napełniania i maksymalne ciśnienie napełniania

Ciśnienie nominalne:

- Średnica balonu: mniejsza niż 6 mm: 10 atm
- Średnica balonu: 6 mm i większa: 8 atm

Ciśnienie rozrywające:

- Średnica balonu: mniejsza niż 5 mm: 20 atm
- Średnica balonu: 5 mm: 18 atm
- Średnica balonu: 6 mm ± 8 mm: 14 atm
- Średnica balonu: 9 mm i większa: 12 atm

[WSKAZANIA]

Balonowy cewnik dylatacyjny do PTA Metacross OTW jest przeznaczony do poszerzania zmiany stenotycznej w tętnicy biodrowej, udowej, biodrowo-udowej, podkolanowej, tętnic położonych dystalnie od tętnicy podkolanowej oraz nerkowych oraz w zabiegach wewnątrznaczyniowego udrażniania naturalnej lub syntetycznej przetoki żyłno-tętnicznej. Stosowanie urządzenia jest także wskazane przy postdylatacji w naczyniach obwodowych.

Uwaga: Test weryfikacji stentu po rozszerzeniu dla cewnika Metacross OTW został przeprowadzony z użyciem systemu stentu

naczyniowego Complete® SE (Medtronic, Inc), systemu stentu naczyniowego S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) i samorozszerzającego się systemu stentu naczyniowego Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[PRZECIWWSKAZANIA]

1. Pacjenci, u których stwierdzono zwężenie zespoleniowe w ciągu jednego miesiąca od wytworzenia przetoki żyłno-tętnicznej.
2. Pacjenci, u których stwierdza się zmiany, które łączą się z pseudotętniakiem.
3. Pacjenci w ciąży.
4. Pacjenci, którzy nie tolerują leczenia antypłytkowego lub przeciwzakrzepowego.

[OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]

[Ostrzeżenia]

1. Wyrób przeznaczony do użytku jednorazowego. Nie używać powtórnie. Nie sterylizować ponownie. Nie przetwarzać. Przetwarzanie może doprowadzić do utraty sterility, biologicznej zgodności oraz spójności funkcjonalnej wyrobu.
2. Nie stosować, jeżeli wyrób lub opakowanie jednostkowe zostały uszkodzone.
3. Nie napełniać balonu z przekroczeniem średnicy naczynia krwionośnego proksymalnie i dystalnie względem zmiany stenotycznej.
4. Nie napełniać balonu do ciśnienia przekraczającego ciśnienie rozrywające.
5. Nie stosować tego cewnika w ośrodkowym układzie krążenia.

[Środki ostrożności związane z procedurami]

1. Powoli i ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć z urządzenia elementy zabezpieczające. Nieostrożne posługiwanie się urządzeniem może być przyczyną uszkodzenia balonu i/lub trzonu cewnika, pogarszając właściwości balonu związane z napełnianiem i/lub opróżnianiem.
2. Napełnić balon środkiem kontrastowym rozcieńczonym solą fizjologiczną w stosunku 1:1 (dalej zwanym „płynem do napełniania”). Do napełniania balonu nie wolno stosować żadnych substancji gazowych, jak powietrze. (Balon może napełniać się w sposób nieregularny).
3. Przed zastosowaniem usunąć powietrze z balonu oraz światła przewodu do napełniania balonu i zastąpić je płynem do napełniania. (W przypadku niepełnej eliminacji powietrza nie można obserwować stanu napełnienia balonu pod kontrolą badania fluoroskopowego).
4. W przypadku poważnych zmian stenotycznych, jak zmiany zwężniające, naczynie krwionośne może zostać nieposzerzone całkowicie. W takim przypadku nie należy stosować ciśnienia przekraczającego ciśnienie rozrywające. (Balon może pęknąć, a jego fragmenty mogą pozostać w ciele pacjenta).
5. W instrukcjach danych wyrobów medycznych przedstawiono, czy mogą być stosowane z niniejszym cewnikiem. (Jeśli cewnik balonowy jest stosowany do postdylatacji podczas procedury umieszczania stentu w naczyniach obwodowych, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta).
6. Umieszczanie w stencie, usuwanie ze stentu lub poszerzanie balonu w stencie należy przeprowadzać ostrożnie pod kontrolą badania fluoroskopowego. (Wykonywanie tych czynności bez kontroli badania fluoroskopowego może spowodować uszkodzenie cewnika lub naczynia).
7. Nie wolno podejmować prób przesuwania balonowego cewnika dylatacyjnego do PTA Metacross OTW przez koszulkę naczyniową o rozmiarze mniejszym od wskazanego na etykiecie. Należy zapoznać się z treścią etykiety umieszczonej na wyrobie.

[Środki ostrożności w czasie stosowania]

1. Użyć wyrobu zaraz po otwarciu sterylnego opakowania.
2. Cały zabieg powinien być przeprowadzony w warunkach aseptycznych.

3. Niniejszy cewnik powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy z doświadczeniem w procedurach przezskórnej angioplastyki naczyń.
4. Wybrać cewnik o odpowiedniej wielkości balonu (średnica balonu, długość balonu) zgodnie z następującymi kryteriami (procedurami).
 - 1) Średnica napelnionego balonu nie może przekraczać wewnętrznej średnicy naczynia proksymalnie i dystalnie do zmiany.
 - 2) Długość napelnionego balonu nie może przekroczyć długości zmiany poddanej leczeniu.
5. Ten cewnik należy stosować wyłącznie w sytuacjach, gdy zawsze można przeprowadzić operację ratunkową.
6. Lekarz kierujący procedurą powinien określić czas trwania napelniania oraz liczbę napelnień balonu w oparciu o swoje przeszłe doświadczenie.
7. Roztwór soli fizjologicznej z heparyną należy podać w ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej w trakcie wprowadzania tego cewnika balonowego do naczynia krwionośnego.
8. Nigdy nie napelniać balonu ani nie przesuwając przewodnika, jeżeli cewnik jest zagięty lub złamany.
9. Ostrożnie manipulować cewnikiem w naczyniu kontrolując położenie i ruch jego końcówki pod kontrolą badania fluoroskopowego lub na monitorze DSA (Digital Subtraction Angiography).
10. Zawsze napelniać balon, obserwując jego stopień napelnienia pod kontrolą badania fluoroskopowego. Ostrożnie napelniać balon, sprawdzając jego położenie na podstawie znaczników nieprzepuszczalnych dla promieni rentgenowskich. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, np. niewielkiego oporu lub zgiętej dystalnej końcówki przewodnika procedurę należy niezwłocznie przerwać, a cewnik powoli usunąć razem z przewodnikiem.
11. Nie należy szybko wprowadzać ani wyjmować cewnika. (Szybkie działanie może uszkodzić cewnik lub błonę wewnętrzną naczynia).
12. Nie przesuwać cewnika, jeśli balon jest napelniony. (Przesuwanie cewnika razem z napelnionym balonem może spowodować rozerwanie balonu lub pęknięcie trzonu cewnika).
13. Nie wolno szybko napelniać ani usuwać płynu z balonu w naczyniu krwionośnym. (Szybkie napelnienie lub usunięcie zawartości może uszkodzić naczynie krwionośne lub spowodować pęknięcie balonu, czego wynikiem będzie pozostanie jego fragmentów w ciele pacjenta).
14. Nie stosować iniektora (automatycznego urządzenia do iniekcji) w celu napelnienia balonu
15. Należy zachować ostrożność, by nie uszkodzić cewnika skalpelem ani nożyczkami chirurgicznymi.
16. Jeśli podczas manipulowania cewnikiem wystąpią takie nieprawidłowości, jak silny opór, należy natychmiast przerwać procedurę. Należy zweryfikować przypadek i podjąć odpowiednie kroki. (Kontynuowanie operacji z użyciem nadmiernej siły może być przyczyną uszkodzenia cewnika lub zranienia ściany naczynia).
17. Należy zawsze obserwować stan pacjenta i monitorować jego temperaturę ciała, tętno i oddech. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości niezwłocznie przerwać stosowanie cewnika lub podjąć odpowiednie środki zależnie od stanu pacjenta i zgodnie z opinią lekarza.
18. Po użyciu cewnik usunąć razem z odpadami medycznymi zgodnie z procedurami szpitala.
19. Nie używać substancji zawierających rozpuszczalniki organiczne ani oleistych środków kontrastowych. Kontakt z tymi substancjami może być przyczyną uszkodzenia cewnika.
20. Podczas manipulowania cewnikiem nie wolno go skręcać ani obracać.
21. Podczas umieszczania wyrobu w naczyniu krwionośnym lub usuwania urządzenia z naczynia krwionośnego należy się upewnić, że balon jest całkowicie opróżniony. (Wyrób z większym lub dłuższym balonem wymaga dłuższego czasu opróżniania).
22. Jeśli podczas następującego po zabiegu wycofywania wyrobu daje się wyczuć opór, zaleca się wycofanie całego systemu wraz z koszulką naczyniową/prowadzącą.
23. Należy zawsze przemieszczać cewnik na przewodniku, umieszczonym w świetle przewodnika.

[Instrukcje operacyjne]

Wśród elementów typowo używanych z balonowym cewnikiem dylatacyjnym do PTA Metacross OTW można wymienić co następuje:

- Przewodnik (przewodniki) o odpowiedniej średnicy i długości
- Odpowiednia koszulka naczyniowa/prowadząca i zestaw poszerzający
- Fiolka ze środkiem kontrastowym
- Fiolka ze sterylnym roztworem soli fizjologicznej
- Urządzenie napelniające z manometrem
- Strzykawka z łącznikiem typu luer lock
- Trójdrożny zawór odcinający

[Metoda operacji lub instrukcja użycia]

1. Wybór cewnika

Przed użyciem sprawdzić wewnętrzną średnicę naczynia krwionośnego proksymalnie i dystalnie względem zmiany stenotycznej pod kontrolą badania fluoroskopowego i wybrać cewnik o odpowiedniej wielkości balonu. Jeżeli do danej średnicy naczynia pasują dwa rozmiary, wybrać mniejszy rozmiar.
2. Przygotowanie
 - 1) Po wyjściu cewnika z opakowania w warunkach aseptycznych należy zdjąć osłonę.
 - 2) Zastąpić powietrze w balonie i przewoździe do napelniania balonu płynem do napelniania zgodnie z następującymi procedurami.
 - a) Podłączyć urządzenie do napelniania (niedołączone do zestawu) napelnić płynem napelniającym do portu napelniania balonu.
 - b) Po zastosowaniu ciśnienia ujemnego przez około 10 sekund w urządzeniu do napelniania skierować końcówkę trzonu cewnika w dół i powoli upełnić ciśnienie ujemne tak, aby płyn napelniał balon i przewód do napelniania balonu, a powietrze było eliminowane.
 - c) Gdy wewnątrz balonu i w świetle przewodu do napelniania balonu znajdzie się powietrze, należy powtórzyć procedurę b) do czasu pełnej eliminacji powietrza.
 - d) Odłączyć urządzenie do napelniania od portu do napelniania balonu i usunąć powietrze z cylindra urządzenia do napelniania.
 - e) Podłączyć ponownie urządzenie do napelniania do portu napelniania balonu i utrzymywać ciśnienie ujemne. Sprawdzić, czy powietrze już nie powraca do strzykawki.
 - 3) Przepłukać światło przewodnika heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej i napelnić światło heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.
 - 4) Zanurzyć cały balonowy cewnik dylatacyjny do PTA Metacross OTW w roztworze soli fizjologicznej.
3. Wkładanie i napelnianie cewnika balonowego

Przed użyciem sprawdzić, czy niniejszy cewnik jest zgodny z cewnikiem prowadzącym (niedostarczonym w zestawie), koszulką naczyniową (niedostarczaną w zestawie) i przewodnikiem (niedostarczonym w zestawie) korzystając z poniższej tabeli.

Numer katalogowy	Średnica balonu (mm)	Kompatybilna koszulka (Fr/mm)	Maksymalna średnica przewodnika (cale/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (z wyłączeniem długości balonu 200 mm), 7 mm (długość balonu 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0.035 cala (0,89 mm)
	6 mm (tylko dla długości balonu 200 mm), 7 mm (z wyłączeniem długości balonu 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

W przypadku stosowania tego cewnika razem z koszulką naczyniową lub cewnikiem wprowadzającym:

- 1) W przypadku stosowania tego cewnika w cewniku prowadzącym należy poluzować lekko zastawkę hemostatyczną tak, aby nie dopuścić do przecieku krwi.
- 2) Stopniowo wsuwać cewnik, z balonem całkowicie opróżnionym, do koszulki naczyniowej lub cewnika prowadzącego po przewodniku i wsunąć go dystalnie na pograniczu zmiany. Pod kontrolą badania fluoroskopowego wsunąć cewnik powoli, by znacznik nieprzepuszczalny dla promieniowania rentgenowskiego dotarł do zmiany docelowej.
- 3) Pod kontrolą badania fluoroskopowego sprawdzić położenie znacznika nieprzepuszczalnego dla promieniowania rentgenowskiego na balonie i określić miejsce poszerzania.
- 4) Przyłączyć stabilnie urządzenie do napełniania do portu napełniania balonu.
- 5) Stopniowo napełniać balon do osiągnięcia średnicy docelowej, sprawdzając ciśnienie napełniania i rozszerzając zmianę stenotyczną (średnice napełnionego balonu znajdują się w danych zgodności balonu w Tabeli zgodności balonu na końcu niniejszej instrukcji stosowania).
4. Usunięcie cewnika
 - 1) Po zastosowaniu ciśnienia ujemnego w celu całkowitego opróżnienia balonu wyjąć cewnik.
5. Ponowne umieszczenie cewnika
 - 1) Jeśli konieczne jest ponowne umieszczenie cewnika ze złożonym balonem, przed ponownym umieszczeniem cewnika w naczyniu krwionośnym pacjenta należy sprawdzić, czy z balonu całkowicie usunięto powietrze. Podczas ponownego umieszczania stosować cewnik zgodnie z zamieszczoną w niniejszym dokumencie sekcją „Umieszczanie i napełnianie cewnika balonowego”.
 - 2) Jeśli podczas ponownego umieszczania cewnika daje się wyczuć jakikolwiek opór, przerwać umieszczanie i ostrożnie usunąć cewnik z naczynia krwionośnego pacjenta. Przygotować się do użycia nowego cewnika Metacross OTW zgodnie z procedurami zamieszczonymi w niniejszej sekcji instrukcji stosowania.

[Powikłania]

Awarie wyrobu

- Pęknięcie balonu
- Niewystarczające napełnienie/opróżnienie balonu
- Pęknięcie balonu i/lub trzonu cewnika
- Trudności z usunięciem wyrobu
- Wyciek płynu do napełniania

Zdarzenia niepożądane:

- Infekcje miejscowe i ogólne
- Miejscowe krwawienie wewnętrzne lub krwiak
- Przerwanie błony wewnętrznej naczynia
- Rozwarstwienie naczynia
- Perforacja naczynia
- Przerwanie naczynia
- Tętniak
- Zaburzenia rytmu
- Ostre zamknięcie naczynia
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
- Skurcz naczynia
- Wytworzenie pseudotętniaka
- Przetoka tętniczko-żylna
- Krwotok, konieczność transfuzji
- Reakcja alergiczna na środek kontrastowy
- Ból lub ból po ucisku
- Zgon
- Zator
- Zapalenie wsierdzia
- Gorączka
- Nadciśnienie/niedociśnienie
- Stan zapalny
- Zawał mięśnia sercowego
- Posocznica

- Wstrząs
- Udar
- Przemijający atak niedokrwienny

[Przechowywanie i data ważności]

1. Przechowywać w chłodnym, suchym, ciemnym miejscu. Unikać narażenia na działanie wody i bezpośrednie działanie światła słonecznego.
2. Datę przydatności do użytku podano na opakowaniu. Nie używać po dacie przydatności do użytku.

[Opakowanie]

1 zestaw/pudełko

[Nazwa i adres producenta lub przedstawiciela]



Producent: KANEKA CORPORATION

Adres: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

Nr tel. (+81)-(0) 6-6226-5256

Nr faksu: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adres: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Nr tel. (+32)-(0) 14-256-297

Nr faksu: (+32)-(0) 14-256-298

Dystrybutor w UE: TERUMO EUROPE N.V.

Adres: INTERLEUENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgia

Nr tel. (+32)-(0) 16 381 211

Nr faksu: (+32)-(0) 16 400 249

Wszystkie nazwy marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi TERUMO CORPORATION i ich prawnych właścicieli.

Tabela 1. Dane zgodności balonu cewnika Metacross OTW

Ciśnienie (atm)	Średnica balonu (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35''	10.42''	12.61''
14	3.14	4.13	5.27	6.39''	7.48''	8.58''	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50''						
20	3.36''	4.38''	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

* Ciśnienie nominalne:


** Ciśnienie rozrywające:

[TERMÉKLEÍRÁS]

A Metacross OTW egy perkután transzlumináris angioplasztikai (PTA) tágitó ballonkatéter periferiás indikációk kezelésére. A Metacross OTW egy vezetődróton alkalmazható eszköz, mely maximum 0,89 mm-es (0,035") vezetődróttal kompatibilis.

A katéter disztális része egy ballont és egy kétlumenes (koaxiális) szárat tartalmaz. A külső lumen a ballon sóoldattal hígított kontrasztanyaggal történő feltöltésére és leengedésére, míg a belső lumen a vezetődrót lumen a disztális hegytől a vezetődrót csatlakozóig) kompatibilis vezetődrót bevezetésére, a katéternek a tágitandó sztenotikus lézió, vagy sztenten történő áthaladás elősegítésére szolgál. Az eszköz proximális része egy kétlumenű szár, mely dupla Luer-csatlakozó elosztóval rendelkezik: egyik a ballon feltöltésére és leeresztésére, a másik a vezetődrót számára. A ballonnal belül két sugárárnyékot adó marker helyezkedik el, melyek a ballon munkahosszát jelzik és segítik a ballon megfelelő képerősítés pozícionálását a céllezión keresztül. A Metacross OTW megvásárolható az ajánlott feltöltési nyomás (névleges nyomás) mellett többféle ballonméretben (átmérő és hossz). A feltöltés után a ballon átmérője a feltöltési nyomástól függ. A Metacross OTW táglasi táblázata a használati utasítás végén, az 1. táblázatban található. A sterilizáló csomagban az eszköz a védőeszközökkel (ballonvédőcső és szonda) van felszerelve, melyek használat előtt eltávolítandók. A ballonvédőcső a ballonnal összehajtvá található, míg a szonda a katéterszár összeesését megelőzendő a vezetődrót lumenébe van vezetve. A katéter disztális vége elkeskenyedik, hogy segítse a katéter előretűtését a sztenotikus lézió, vagy sztenten keresztül.

<AZ ALKOTÓRÉSZEK MEGNEVEZÉSE>

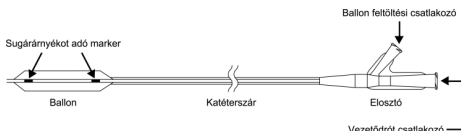

Steril és nem pirogén, ha a bliszter sértetlen és bontatlan. A termék etilén-oxidál sterilizálva.

A vezetődrót ajánlott átmérője:

Maximális átmérő: 0,89 mm (0,035")

Ajánlott feltöltőnyomás és maximális feltöltőnyomás

Névleges nyomás:

- Ballonátmérő 6 mm alatt :	10 atm
- Ballonátmérő 6 mm és előfölt :	8 atm

Becsült szakítónyomás:

- Ballonátmérő 5 mm alatt :	20 atm
- Ballonátmérő 5 mm:	18 atm
- Ballonátmérő 6, 7, 8 mm	14 atm
- Ballonátmérő 9 mm és előfölt:	12 atm

[INDIKÁCIÓ]

A Metacross OTW egy PTA tágitó ballonkatéter az a. iliaca, femoralis, ilio-femoralis, poplitea, infrapoplitea és renalis stenózisainak tágitására, valamint a natív vagy mesterséges dialízis AV-fisztulák obstrukciójának kezelésére. Az eszköz emellett a periferiás erek sztent-utótágítására is alkalmas.

Megjegyzés: A Metacross OTW sztent poszt-dilatációs ellenőrző tesztje került elvégzésre a Complete® SE Vascular Stent System (Medtronic, Inc), a S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) illetve az Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation) segítségével.

[ELLENJAVALLATOK]

- Azoknál a betegeknél, akiknél az AV-shunt megtörténte után egy hónapon belül anasztomotikus szűkület alakult ki.
- Azoknál a betegeknél, akiknél a lézió pszeudoaneurizmával áll kapcsolatban.
- Terhesség során.
- Azoknál a betegeknél, akik nem alkalmasak a vérelemezke-elleni vagy antikoaguláns kezelésre.

[FIGYELMEZTETÉSEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK]

[Figyelmeztetések]

- Az eszköz egyszer használatos, ismételt használata, sterilizációja nem megengedett! Ismételt felhasználásra való előkészítése nem megengedett, mivel ez veszélyeztetheti a termék sterilizálását, biokompatibilitását és funkcionális integritását.
- Ne használja, ha termék vagy az egység csomagolása megrongálódott.
- A ballont ne töltse fel nagyobbra, mint a véredénynek a sztenotikus elváltozás proximális és disztális végénél mért átmérője!
- Ne lépje túl a ballon tágitásakor a becsült szakítónyomást!
- Ne használja a katétert a központi keringési rendszerben!

[A beavatkozást illető óvintézkedések]

- Az eszközt óvatosan és lassan távolítsa el a szállítócsőből és távolítsa el ki a védőrézsegeket. A figyelmen kezelés károsíthatja a ballont, vagy a katéterszárat, ami gátolhatja a ballon feltöltését vagy leeresztését.
- Töltse fel a ballont kontrasztanyag és sóoldat 1:1 arányú keverékével (továbbiakban feltöltési folyadék). Ne használjon a ballon feltöltésére gázt (pl. levegőt). (A ballon szabálytalanul töltődhet fel.)
- Használat előtt távolítsa el a levegőt a ballonnal és a ballon infúziós csatornájából, és helyettesítse azt a feltöltő folyadékkal. (Ha a levegőt nem távolítja el teljes mértékben, a ballon feltöltésének állapotát nem lehet röntgenátvilágítással ellenőrizni.)
- Súlyos (pl. meszes) sztenotikus léziók esetén az ér nem tágitható ki teljesen. Ilyen esetben ne fejtson ki a becsült szakítónyomásnál nagyobb nyomást. (A ballon elszakadhat és darabjai a testben maradhatnak.)
- A katéterrel együtt használt orvosi eszközökkel kapcsolatban kövesse az adott eszközökre vonatkozó utasításokat! (Amennyiben a ballonkatétert periferiás sztentbeültetés során a sztent utótágítására használja, kövesse a gyártó használati utasításait.)
- A sztentbe való bevezetést, az abból történő kihúzást, illetve a ballon sztentben történő feltöltését óvatosan, röntgenátvilágítás mellett végezze. (A röntgenátvilágítás nélküli manipuláció károsíthatja a katétert vagy sérülést okozhat a véredény intimáján.)
- Ne próbálja átolni a Metacross OTW PTA tágitó ballonkatétert a címkén jelzett méretűnél kisebb bevezető hüvelyen. Nézze meg az eszköz címkéjét.

[Használat alatti óvintézkedések]

- A készüléket közvetlenül a steril csomagolás felbontása után használja fel.
- A teljes beavatkozást aszeptikusan kell végezni.
- A katétert kizárólag a perkután vaszkuláris beavatkozásokban jártas szakorvosok használhatják.
- Válassza ki a megfelelő ballon mérettel rendelkező (ballonátmérő, ballonhossz) katétert a következő (beavatkozási) kritériumoknak megfelelően.
 - A felfújt ballon átmérője ne haladja meg a véredénynek az elváltozástól proximálisan és disztálisan mért belső átmérőjét.
 - A felfújt ballon hossza ne haladja meg a kezelendő elváltozás hosszát.
 - (A nem megfelelő katéterméret az ér akut elzáródását okozhatja.)
- Csak olyan esetben használja a katétert, ha bármikor végrehajtható sürgősségi műtéti beavatkozás.

6. Az eljárástért felelős szakorvosnak saját korábbi tapasztalatai alapján kell megállapítania a ballonfeltöltések időtartamát és számát.
7. A ballonkatéternek a véredénybe való bevezetése alatt heparinos sóoldatot kell bejuttatni a vérárvadás gátlására.
8. Soha ne töltse fel a ballont vagy vezesse be a vezetődrtöt, ha a katéter elhajlott vagy megtört.
9. Óvatosan manipuláljon a katéterrel az érben és közben figyelje a katéter végének helyét és mozgását röntgenátvilágítás vagy digitális szubsztrakciós angiográfiás vizsgálat (DSA) segítségével.
10. Minden töltés fel a ballont, miközben feltöltött állapotában vizsgálja röntgenátvilágítással. Óvatosan töltse fel a ballont mialatt a röntgenárnyékot adó markerekkel ellenőrzi a ballon mozgását. Bármilyen rendellenesség esetén, legyen az egy kis ellenállás, a manipuláció során nem mozdítható katéter vagy a vezetődrt efferdült disztális vége, az eljárást azonnal meg kell szakítani, és ezt a katétert a vezetődrtól együtt lassan el kell távolítani.
11. Ne vezesse be, és ne távolítsa el a katétert gyorsan. (A gyors művelet károsíthatja a katétert vagy sérülést okozhat a véredény intimáján.)
12. Ne mozdítsa el a tágitó katétert amíg a ballonn nincs teljesen leeresztve. (A katéter feltöltött ballonnal történő mozgatása a ballon repedéséhez vagy a katéterszár töréséhez vezethet.)
13. Ne töltse fel, vagy eressze le a ballont gyorsan a véredényben. (A gyors feltöltés során meg lehet károsíthatja a véredényt, vagy megrepesztheti a ballont, melynek következtében a ballon darabjai a testben maradhatnak.)
14. Ne használjon befecskendező készüléket (automatikus befecskendező eszközt) a ballon feltöltésére.
15. Járjon el óvatosan, ne sértse meg a katétert szikével vagy sebészti ollóval.
16. Amennyiben a katéterrel történő manipulálás során bármilyen rendellenességet, pl. erős ellenállást tapasztal, azonnal fűgessze fel az eljárást. Keresse meg a jelenség okát és tegye meg a szükséges lépéseket. (A beavatkozás folytatása nagy erő kifejtésével a katéter vagy az ér sérülését okozhatja.)
17. Folyamatosan figyelje a beteg állapotát, monitorozza a testhőmérsékletét, pulzusát és légzését. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal szakítsa meg a katéter használatát, vagy tegye meg a megfelelő intézkedést a beteg állapota érdekében a szakorvos véleménye alapján.
18. A katétert használata után egészségügyi hulladékként kell kezelni a kórházi gyakorlatnak megfelelően.
19. Ne használjon szerves oldószert tartalmazó anyagokat vagy olajos kontrasztanyagokat. Ezen anyagokkal történő érintkezés a katéter sérülését okozhatja.
20. A manipulálás során ne tekerje vagy forgassa el a katétert.
21. Az eszköznek az érbe történő bevezetése vagy onnan történő eltávolítása során ügyeljen arra, hogy a ballon teljesen le legyen engedve. (A nagyobb vagy hosszabb ballonnal rendelkező eszközök esetében több idő kell a leeresztéshez.)
22. Ha az eljárás végén az eszköz eltávolítása közben ellenállás tapasztalható, ajánlott a teljes rendszert egyben, a bevezető/vezető hüvellyel együtt eltávolítani.
23. A katétert mindig a vezetődrt lumenbe helyezett vezetődrtóron használnia.

[Használati utasítások]

PTA beavatkozás esetén a Metacross OTW PTA tágitó ballonkatéter használatához általában az alábbi eszközök szükségesek:

- Megfelelő hosszúságú és átmérőjű vezetődrt(ok)
- Megfelelő bevezető/vezető hüvely és tágitók
- Kontrasztanyag
- Steril sóoldat
- Feltöltő eszköz nyomásmérővel
- Luer-lock fecskendő
- 3-utas csap

[Műteti módszer vagy használati útmutatás]

1. A katéter kiválasztása
A beavatkozás előtt röntgenátvilágítással határozza meg a véredény belső átmérőjét a sztenotikus elváltozástól proximálisan

és disztálisan, és válassza ki a megfelelő méretű ballonkatétert. Ha két méret is megfelel a mért átmérőnek, akkor válassza a kisebbet!

2. Előkészületek

- 1) Miután aszeptikusan kivette a katétert a csomagolásából, távolítsa el a védőborítást!
- 2) Távolítsa el a ballontól és a ballon inflációs csatornájából a levegőt feltöltő folyadék segítségével az alábbi eljárásnak megfelelően.
 - a) Csatlakoztassa a feltöltő folyadékkal teli feltöltő készüléket (ez a készlet nem tartalmazza) a ballon inflációs nyílásához.
 - b) A feltöltő készülékre gyakorolt körülbelül 10 másodperces negatív nyomás alkalmazása után irányítsa a katéter nyelét lefelé, és lassan engedjen a negatív nyomáson, hogy a folyadék feltöltse a ballon belső üregét és az inflációs csatornát, valamint hogy kiszorítsa a levegőt.
 - c) Ha maradt valamennyi levegő a ballonan, miután a ballont feltöltötték a feltöltő folyadék, ismételje meg a b) lépést amíg a levegő teljesen ki nem szorul.
 - d) Vegye le a feltöltő készüléket a ballon inflációs nyílásáról, és távolítsa el a levegőt a feltöltő készülék cilinderéből!
 - e) Csatlakoztassa vissza a feltöltő készüléket a ballon inflációs nyílásához és tartsa fent a negatív nyomást. Ügyeljen arra, hogy ne jusson levegő a fecskendőbe.
- 3) Öblítse át, majd töltse fel a vezetődrt lument heparinos sóoldattal.
- 4) Mérítse az egész Metacross OTW PTA tágitó ballonkatétert sóoldatba.
3. A ballonkatéter bevezetése és feltöltése
Használat előtt, kérjük, az alábbi táblázat segítségével ellenőrizze, hogy a katéter kompatibilis a vezetőkátéterrel, a bevezető hüvellyel és a vezetődrtórral (a készlet ezeket nem tartalmazza).

Katalógusszám	Ballonátmérő (mm)	Kompatibilis hüvely (Ch/mm)	Vezetődrt maximális átmérője (mm")
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (kivéve 200 mm ballonhossz), 7 mm (20 mm, 40 mm ballonhossz)	Ch 5 / 1,66 mm	0,89 mm (0.035")
	6 mm (csak 200 mm ballonhossz), 7 mm (kivéve 20 mm, 40 mm ballonhossz), 8 mm	Ch 6 / 2 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	Ch 7 / 2,33 mm	

A katéter használata a bevezető hüvelybe, vagy vezetőkátéterbe vezetve

- 1) Amikor a vezetőkátéterben használja a katétert, lazítsa meg a hemosztatikus szelepet, ugyanakkor tartsa elég szorosan a vérszivárgás megakadályozása érdekében.
- 2) A katétert teljesen leeresztett ballonnal fokozatosan vezesse be a bevezető hüvelybe, vagy vezetőkátéterbe a vezetődrtóron és tolja a lézió disztális végéhez. Röntgenátvilágítás mellett tolja előre lassan a katétert, hogy a ballonan lévő sugárárnyékot adó marker elérje a beavatkozás helyét.
- 3) Röntgenátvilágítás segítségével ellenőrizze a ballonan lévő sugárárnyékot adó marker pozícióját és határozza meg a tágitás helyét.
- 4) Csatlakoztassa a feltöltő eszközt a katéter ballonjának feltöltési csatlakozójára,
- 5) Töltse fel fokozatosan a ballont a megadott átmérőig a nyomás ellenőrzése mellett, és tágitssa ki a sztenotikus elváltozást a feltöltött ballon jellemzőit lásd a használati utasítás végén, az 1. táblázatban található tágulási táblázatban).
4. A katéter eltávolítása
 - 1) Alkalmazzon negatív nyomást a ballon tökéletes leeresztéséhez, majd távolítsa el a katétert.
5. A katéter újbóli bevezetése
 - 1) Ha az eltávolított katéter leeresztett ballonnal történő újbóli bevezetése szükséges, a betegbe történő bevezetés előtt ellenőrizze, hogy a ballon teljesen le van eresztve és össze van

hajtva. Az újbóli bevezetést az „A ballonkatéter bevezetése és feltöltése” fejezetnek megfelelően végezze el.

- 2) Ha a katéter újbóli bevezetése során ellenállást tapasztal, álljon meg és óvatosan távolítsa el a katétert a beteg véreéből. Készítsen elő egy új Metacross OTW katétert ezen Használati utasítás ezen fejezetében található fenti utasításoknak megfelelően.

EU-forgalmazó : TERUMO EUROPE N.V.

Cím: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgium

Tel.: (+32)-(0) 16 381 211

Fax: (+32)-(0) 16 400 249

Minden márkanév a TERUMO CORPORATION és tulajdonosainak védjegye vagy bejegyzett védjegye.

[Szövődmények]

Eszközhibák:

- A ballon kiszakadása
- A ballon elégtelen feltöltése vagy leeresztése
- A ballon, illetve a katéterszár törése
- Az eszköz eltávolításának nehézsége
- A feltöltő folyadék szivárgása

Nem kívánatos események:

- Helyi vagy szisztémás gyulladás
- Lokális belső vérzés vagy hematoma
- Intimásérülés
- Érfal disszekció
- Érperforáció
- Véredény ruptura
- Aneurizma
- Arrhythmia
- Akut érelzáródás
- Vénás thromboembolizmus
- Vazospaszmus
- Pszeudoaneurizma kialakulása
- Arteriovenózus fistula
- Vérzés, transzfúziót igénylő
- A kontrasztanyagra való allergiás reakció
- Fájdalom vagy szorító fájdalom
- Halál
- Embólia
- Endokarditisz
- Láz
- Magas vagy alacsony vérnyomás
- Gyulladás
- Szivinfarktus
- Sepszis
- Sokk
- Stroke
- TIA

[Tárolás és a lejárati időpontja]

1. Hűvös, száraz, sötét helyen tárolandó. Kerülje a vízzel vagy a közvetlen napfénnel való érintkezést
2. A lejárati idő a dobozon található. A lejárati idő után ne használja.

[Csomagolás]

1 készlet/doboz

[A gyártó vagy a képviselő neve és címe]



Gyártó: KANEKA CORPORATION

Cím: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,

OSAKA, 530-8288 JAPAN

Tel.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Fax: (+81)-(0) 6-6226-5143



Felhatalmazott képviselő az EU-ban:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Cím: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Tel.: (+32)-(0) 14-256-297

Fax: (+32)-(0) 14-256-298

1. táblázat Metacross OTW Ballon táglási táblázat

Nyomás (atm)	Ballonátmérő (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96*	6.98*	8.00*	8.98*	9.90*	11.98*
10	3.01*	3.98*	5.06*	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35**	10.42**	12.61**
14	3.14	4.13	5.27	6.39**	7.48**	8.58**	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50**						
20	3.36**	4.38**	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							


* Névleges nyomás

** Becsült szakítónyomás

[POPIS VÝROBKU]

Metacross OTW je balónkový dilatační katétr pro perkutánní transluminální anastomoplastiku (PTA), určený k použití v periferních cévách. Metacross OTW je typ „přes drát“ (OTW) a maximální průměr kompatibilního vodičového drátu je 0,035 palce (0,89 mm). Distální část tohoto katétru se skládá z balónku a z dvoulumenového (koaxiálního) těla. Vnější lumen se používá k inflaci a deflaci balónku kontrastní látkou ředěnou fyziologickým roztokem. Vnitřní lumen (lumen pro vodič drát, od distálního hrotu po port vodičového drátu) je určen k zavádění kompatibilního vodičového drátu k usnadnění posouvání katétru přes stenotickou lézi nebo stent, které se mají dilatovat. Proximální část je dvoulumenové tělo s rozdělovacím ústím se dvěma porty, z nichž jeden slouží k inflaci/deflaci balónku a druhý pro přístup do lumen pro vodič drát. Uvnitř balónku jsou umístěny dvě rentgenkontrastní značky, které označují pracovní délku balónku; ty slouží jako pomůcka pro lékaře při správném polohování balónku v cílové lézi pod skioskopickou kontrolou. Metacross OTW je dostupný v různých velikostech balónku určenými jeho průměrem a délkou při doporučeném inflačním tlaku (jmenovitým tlaku). Po inflaci se průměr balónku mění podle inflačního tlaku. Tabulka 1 na konci tohoto návodu k použití je tabulka kompatibility balónku pro Metacross OTW. Ve sterilním balení je prostředek opatřen ochranným materiálem, ochrannou trubicí pro balónek a styletem, které se musí před použitím odstranit. Ochranná trubice balónku je umístěna na balónek, který je složen do úzkého profilu, a do lumen vodičového drátu je vložen stylet zabránující zhroucení těla katétru. Distální hrot katétru je zúžený, aby se usnadnilo posouvání katétru do stenotické léze nebo stentu.

<NÁZEV JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROSTŘEDKU>

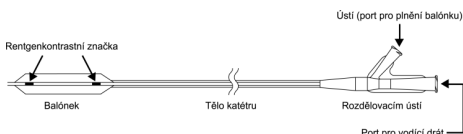

Sterilní a nepyrogenní v nepoškozeném a neotevřeném blistrovém obalu. Tento prostředek je sterilizován ethylenoxidem.

Doporučený průměr vodičového drátu:

Maximální průměr: 0,035" (0,89 mm)

Doporučený inflační tlak a maximální inflační tlak

Jmenovitý tlak:

- průměr balónku: menší než 6 mm: 10 atm
- průměr balónku: 6 mm a větší: 8 atm

Stanovený mezní tlak prasknutí:

- průměr balónku: menší než 5 mm: 20 atm
- průměr balónku: 5 mm: 18 atm
- průměr balónku: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- průměr balónku: 9 mm a větší: 12 atm

[INDIKACE]

Balónkový dilatační katétr pro PTA Metacross OTW je určen k dilataci stenóz v iliakálních, femorálních, iliofemorálních, popliteálních, infrapopliteálních a renálních artériích a k léčbě obstrukčních lézí nativních nebo syntetických arteriovenózních pěstířů pro dialýzu. Tento prostředek je také indikován k postdilataci periferních cév po implantaci stentu.

Poznámka: Byl proveden verifikační test postdilatace stentu pomocí prostředku Metacross OTW za použití systému cévního stentu Complete® SE (Medtronic, Inc.) systému cévního stentu S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) a systému samoexpandujícího cévního stentu Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[KONTRAINDIKACE]

1. Pacienti, u kterých do jednoho měsíce po vytvoření AV fistule rozvinula anastomotická stenóza.
2. Pacienti s lézemi, které komunikují s pseudoaneuryzmaty.
3. Těhotné pacientky.
4. Pacienti, kteří nesnášejí protidestičkovou nebo antikoagulační léčbu.

[VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ]

[Varování]

1. Tento prostředek je určen pouze pro jednorázové použití. Nelze použít opakovaně. Opakovaně nesterilizujte. Nikak neupravujte. Opakované použití může ohrozit sterilitu, biokompatibilitu a funkčnost celistvost prostředku.
2. Pokud je poškozen výrobek nebo obal, výrobek nepoužívejte.
3. Balónek nenapínejte na větší velikost než je průměr krevní cévy proximálně a distálně od stenotické léze.
4. Balónek nenapínejte více než na stanovený mezní tlak prasknutí.
5. Tento katétr nepoužívejte v centrálním oběhovém systému.

[Upozornění týkající se výkonů]

1. Opatrně a pomalu vyjměte prostředek z transportní trubice a odstraňte ochranné prvky z prostředku. Při neopatrném zacházení se může poškodit balónek a/nebo tělo katétru, což může způsobit potíže s plněním a vyprazdňováním balónku.
2. Napíňte balónek kontrastní látkou zředěnou fyziologickým roztokem v poměru 1:1 (dále „inflační kapalina“). K inflaci se nesmí použít plynné médium, například vzduch. (Balónek by se nenaplnil stejným měřítkem.)
3. Před plněním vytlačte z balónku a plicního lumenu balónku veškerý vzduch a nahraďte jej inflační kapalinou. (V případě nedostatečného odstranění vzduchu nelze naplněný balónek sledovat skioskopicky.)
4. V případě výskytu závažných stenotických lézí, jako jsou například kalkifikované léze, nelze krevní cévu zcela dilatovat. V takovém případě neaplikujte tlak vyšší, než je jmenovitý mezní tlak prasknutí. (Balónek může prasknout a jeho zbytky mohou zůstat v těle pacienta.)
5. Co se týče zdravotnických prostředků používaných společně s tímto katétre, postupujte podle návodu k použití těchto prostředků. (Pokud se balónkový katétr používá k postdilataci stentu během postupu umístění periferního stentu, řídte se návodem k použití, daným výrobcem.)
6. Při zavádění do stentu, vytahování ze stentu nebo při dilataci balónku uvnitř stentu postupujte opatrně a pod skioskopickou kontrolou. (Pokud se nepoužije skioskopie, může se poškodit katétr nebo může dojít k poranění krevní cévy.)
7. Nepokoušejte se zasunout balónkový dilatační katétr pro PTA Metacross OTW přes zaváděcí sheath/pouzdro menší velikosti, než jaká je uvedena na označení. Viz označení výrobku.

[Upozornění během použití]

1. Prostředek použijte ihned po otevření sterilního obalu.
2. Celý výkon se musí provádět asepticky.
3. Tento katétr smí používat výhradně lékaři s příslušnou kvalifikací pro provádění perkutánní vaskulární terapie.
4. Vyberte katétr s balónkem vhodné velikosti (průměr balónku, délka balónku), a to podle následujících kritérií (postupů):
 - 1) Průměr naplněného balónku nesmí přesáhnout vnitřní průměr cévy proximálně a distálně od léze.
 - 2) Délka naplněného balónku nesmí přesáhnout délku léčené léze. (Výběr nevhodného katétru může vést k akutní okluzi cévy.)
5. Tento katétr používejte pouze v případě, že lze kdykoli provést nouzovou chirurgický výkon.
6. Lékař zodpovědný za provedení výkonu musí stanovit trvání a počet plnění balónku, a to na základě svých předchozích zkušeností.
7. Když se balónkový katétr zavádí do cévy, musí se provést infuze heparinovaného fyziologického roztoku za účelem antikoagulace.

8. Nikdy nepiňte katétr ani neposouvejte vodičí drát v případě, že je katétr ohnutý nebo zasmyčkován.
9. S katétretem manipulujte opatrně a přitom kontrolujte umístění a pohyb hrotu katétru pod skiaskopickým naváděním nebo na monitoru DSA (digitální subtrakční angiografie).
10. Při plnění balónku vždy skiaskopicky sledujte stav naplnění. Balónek piňte opatrně a současně kontrolujte jeho pohyb pomocí rentgenkontrastních značek. Pokud zjistíte jakoukoli anomálii (např. pocítujete-li mírný odpor, nelze-li katétretem během manipulace pohnout nebo když se zasmyčkuje distální hrot vodičového drátu), musíte ihned zastavit provádění výkonu a pomalu vyjmout katétr společně s vodičím drátem.
11. Katétr nezavádějte ani nevyjímejte rychle. (Při rychlém pohybu se může poškodit katétr nebo může dojít k poranění intimy.)
12. Je-li balónek naplněný, katétretem nepohybujte. (Při pohybování katétretem s naplněným balónkem může dojít k prasknutí balónku nebo ke zlomení těla katétru.)
13. Balónek v krevní cévě nenaplníte ani nevyprazdňujete rychle. (Při rychlém naplnění nebo vyprázdnění se může poškodit krevní céva nebo může dojít k prasknutí balónku a jeho zbytky mohou zůstat v těle pacienta.)
14. K plnění balónku nepoužívejte žádný injektor (automatické injekční zařízení).
15. Musíte dávat pozor, abyste katétr nijak nepoškodili skalpelem nebo nůžkami.
16. Pokud při manipulaci s katétretem narazíte na jakoukoli anomálii, například na silný odpor, okamžitě výkon přerušte. Je nutno zjistit příčinu této anomálie a provést vhodná opatření. (Budete-li ve výkonu pokračovat s nadměrnou silou, může to vést k poškození katétru nebo k poranění cévní stěny.)
17. Neustále věnujte pozornost stavu pacienta a sledujte tělesnou teplotu, pulz a dýchání. Pokud zjistíte anomálii, přestaňte katétr ihned používat nebo podle rozhodnutí lékaře proveďte opatření odpovídající stavu pacienta.
18. Po použití katétru zlikvidujte se zdravotnickým odpadem podle směrnice zdravotnického zařízení.
19. Nepoužívejte prostředky s obsahem organických rozpouštědel nebo olejových kontrastních médií. Kontakt s těmito látkami může vést k poškození katétru.
20. Katétretem při manipulaci nekruťte ani neotáčejte.
21. Při zavádění tohoto prostředku do krevní cévy a při jeho vytahování z krevní cévy zkontrolujte, zda je balónek zcela vyprázdněný. (Prostředek s větším a delším balónkem vyžaduje delší dobu pro vyprázdnění.)
22. Pokud při vytahování tohoto prostředku pro provedení výkonu narazíte na odpor, doporučuje se vytáhnout celý systém vcelku spolu se zaváděčem / vodičím sheathem.
23. Katétr vždy používejte spolu s vodičím drátem, zasunutý do lumen vodičového drátu.

[Návod k použití]

Materiál obvykle potřebný pro provedení PTA pomocí balónkového dilatčního katétru pro PTA Metacross OTW zahrnuje:

- vodičí drát(y) vhodného průměru a délky;
- vhodný set zaváděče / vodičového sheathu a dilatátoru;
- lahvičku s kontrastní látkou;
- lahvičku se sterilním fyziologickým roztokem;
- inflační zařízení s tlakoměrem;
- stříkačku Luer Lock;
- trojcestný uzavírací kohout.

[Metodika výkonu či návod k použití]

1. Výběr katétru
Před použitím skiaskopicky zkontrolujte vnitřní průměr krevní cévy proximálně a distálně ke stenotické lézi a vyberte katétr s odpovídající velikostí balónku. Pokud lze pro ověření průměr použít dvě velikosti, vyberte tu menší.
2. Příprava
 - 1) Poté, co katétr asepticky vyjmete z obalové nádoby, odstraňte z něj ochranný materiál.
 - 2) Následujícím postupem nahraďte vzduch v balónku a v inflačním lumenu balónku inflační kapalinou.

- a) K inflačnímu portu balónku připojte inflační zařízení (není součástí této sady), naplněné inflační kapalinou.
- b) Do inflačního zařízení aplikujte podtlak po dobu přibližně 10 sekund a poté nasměrujte hrot těla katétru dolů a pomalu podtlak uvolněte, aby mohla kapalina naplnit balónek a inflační lumen balónku a aby se vytlačil vzduch.
- c) Pokud se v balónku a v inflačním lumenu balónku nachází vzduch, opakujte krok b), dokud se úplně neodstraní veškerý vzduch.
- d) Odpojte inflační zařízení od inflačního portu balónku a odstraňte vzduch obsažený v lahvi inflačního zařízení.
- e) Znovu připojte inflační zařízení k inflačnímu portu balónku a udržujte podtlak. Ověřte, zda se již do stříkačky nevrací vzduch.
- 3) Propláchněte lumen vodičového drátu heparinizovaným fyziologickým roztokem a naplňte lumen heparinizovaným fyziologickým roztokem.
- 4) Celý balónkový dilatční katétr pro PTA Metacross OTW ponořte do fyziologického roztoku.
3. Zavedení a naplnění balónkového katétru
Před použitím zkontrolujte kompatibilitu tohoto katétru s vodičím katétretem (není součástí této soupravy), se zaváděcím sheathem (není součástí této soupravy) a s vodičím drátem (není součástí této soupravy) podle následující tabulky.

Kód výrobku	Průměr balónku (mm)	Kompatibilní sheath (Fr/mm)	Maximální průměr vodičového drátu (palec/mm)
BD-L30020SW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (kromě balónku o délce 200 mm), 7 mm (délka balónku 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0,035 palec ± 0,89 mm
~	6 mm (pouze délka balónku 200 mm), 7 mm (kromě délky balónku 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
BD-L70200CW	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Při použití katétru zasunutého v zaváděcím sheathu nebo vodičím katétre

- 1) Použijte-li tento katétr ve vodičím katétre, uvolněte hemostatický ventil; současně jej však nechejte utažený tak, aby nedocházelo k prosakování krve.
- 2) Celý katétr s vyprázdněným balónkem postupně zaveďte do zaváděcího sheathu nebo vodičového katétru, a to po vodičím drátu zasunutém do distálního okraje léze. Pod skiaskopickým naváděním katétr pomalu posouvajte, až rentgenkontrastní značka na balónku dosáhne cílového místa.
- 3) Pod skiaskopickým naváděním ověřte polohu rentgenkontrastní značky na balónku a určete místo dilatace.
- 4) Inflační zařízení bezpečně připojte na inflační port balónku.
- 5) Balónek postupně naplňte na cílový průměr a přitom kontrolujte inflační tlak a dilatujte stenotickou lézi (údaje o průměru naplněného balónku najdete v tabulce kompatibility balónku v Tabulce 1 na konci tohoto návodu k použití).
4. Vyjmutí katétru
 - 1) Aplikujte podtlak a úplně vyprázdněte balónek; poté vyjmete katétr.
5. Opětovné zavedení katétru
 - 1) Pokud je nutno opětovně zavést vyjmutý katétr s vyprázdněným balónkem, před opětovným zavedením do cévy pacienta zkontrolujte balónek, zda je úplně prázdný a složený. Postup použití katétru viz „Zavedení a naplnění balónkového katétru“ v tomto dokumentu.
 - 2) Pokud při vytahování tohoto prostředku při opětovném zavádění katétru narazíte na odpor, zastavte jeho posouvání a opatrně jej vytáhněte z cévy pacienta. Připravte k použití nový prostředek Metacross OTW podle postupů uvedených výše v tomto odstavci v tomto návodu k použití.

[Komplikace]

Selhání zařízení:

- prasknutí balónku;
- nedostatečná inflace/deflace balónku;
- prasknutí balónku a/nebo těla katétru;
- potíže při vyjímání prostředku;
- prosakování inflační kapaliny;

Nežádoucí příhody:

- lokální nebo celková infekce;
- lokální vnitřní krvácení nebo hematom;
- ruptura intimy;
- disekce cévy;
- perforace cévy;
- ruptura cévy;
- aneuryzma;
- arytmie;
- akutní uzávěr cévy;
- žilní tromboembolie;
- vazospasmus;
- vznik pseudoaneuryzmatu;
- arteriovenózní píštěl;
- krvácení vyžadující transfúzi;
- alergická reakce na kontrastní látku / selhání ledvin;
- bolest nebo tlak;
- smrt;
- embolie;
- endokarditida;
- horečka;
- hypertenze nebo hypotenze;
- zánět;
- infarkt myokardu;
- sepsa;
- šok;
- mrtvice;
- transienční ischemická ataka.

Veškeré názvy značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti TERUMO CORPORATION a jejich příslušných vlastníků.

[Skladování a datum expirace]

1. Skladujte v chladu, suchu a temnu. Chraňte před vodou a přímým slunečním světlem.
2. Datum expirace je vyznačeno na obalu. Nepoužívejte po datu použitelnosti.

[Balení]

1 set v krabici

[Název a adresa výrobce nebo zástupce]**Výrobce: KANEKA CORPORATION**

Adresa: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. č.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Fax. č.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Oprávněný zástupce pro Evropské společenství:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresa: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel. č.: (+32)-(0) 14-256-297
Fax. č.: (+32)-(0) 14-256-298

Distributor v EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresa: INTERLEUVENLAAN 40, 40.3001 LEUVEN, Belgie
Tel. č.: (+32)-(0) 16 381 211
Fax. č.: (+32)-(0) 16 400 249

Tabulka 1. Tabulka kompatibility balónku Metacross OTW


Tlak (atm)	Průměr balónku (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96'	6.98'	8.00"	8.98'	9.90'	11.98'
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50"						
20	3.36"	4.38"	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

* Jmenovitý tlak:

** Stanovený mezní tlak prasknutí

[POPIS PRODUKTU]

Metacross OTW je balónikový dilatačný katéter na perkutánnu transluminálnu angioplastiku (PTA) pre periférne indikácie. Metacross OTW je typu „over the wire“ (OTW, t.j. po drôte) a maximálny priemer kompatibilného vodiaceho drôtu je 0.035 palca (0,89 mm). Distálna časť tohto katétra sa skladá z balónika a (koaxiálneho) telesa s dvomi lúmenmi. Vonkajší lúmen sa používa na nafukovanie a vyfukovanie balónika kontrastným médiom rozriedeným fyziologickým roztokom. Vnútny lúmen (lúmen vodiaceho drôtu; od distálnej špičky k vstupu pre vodiaci drôt) je určený na zavedenie kompatibilného vodiaceho drôtu s cieľom uľahčiť zasúvanie katétra cez stenotickú léziu alebo stent, ktoré sa majú dilatovať. Proximálnu časť predstavuje dvojlúmenové telo s vetvením s dvomi portmi typu Luer, pričom jeden slúži na naplnenie/vypúšťanie balónika a druhý na prístup do lúmenu pre vodiaci drôt. Vnútri balónika sa nachádzajú dve röntgenkontrastné značky, ktoré indikujú pracovnú dĺžku balónika, a pri skioskopickom zobrazení lekára vedú pri správnom umiestňovaní balónika v cieľovej lézii. Metacross OTW je k dispozícii v rôznych veľkostiach balónika podľa priemeru a dĺžky pri odporúčaných tlakoch nafúknutia (nominálny tlak). Pri nafukovaní sa priemer balónika mení podľa tlaku nafúknutia. Na konci týchto pokynov na používanie je v Tabuľke 1 k dispozícii prehľad kompatibilitability balónika pre balónikové katétre Metacross OTW. V sterilnom balení je zariadenie vybavené ochrannými materiálmi, ochrannou trubičkou balónika a mandrénom, ktorý sa má pred použitím vytiahnuť. Ochranná trubička balónika sa nachádza na balóniku, ktorý je poskladaný do nízkeho profilu a do lúmenu vodiaceho drôtu je vložený mandrén, ktorý má vystužovať teleso katétra. Distálna špička katétra je kužeľová, aby sa uľahčilo zasúvanie katétra do stenotickej lézie alebo stentu.
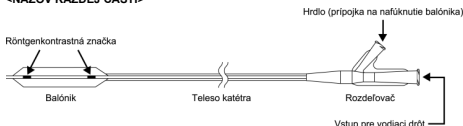
<NÁZOV KAŽDEJ ČASŤI>

Výrobok je sterilný a nehorľavý v nepoškodenom a neotvorenom blistrovom vrecku. Táto pomôcka bola sterilizovaná etylénoxidom.

Odporúčaný priemer vodiaceho drôtu:

Maximálny priemer: 0,89 mm (0,035")

Odporúčaný nafukovací tlak a maximálny nafukovací tlak

Nominálny tlak:

- Priemer balónika: menej než 6 mm:	10 atm
- Priemer balónika: 6 mm a viac:	8 atm

Menovitý tlak prasknutia:

- Priemer balónika: menej než 5 mm:	20 atm
- Priemer balónika: 5 mm:	18 atm
- Priemer balónika: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 atm
- Priemer balónika: 9 mm a viac:	12 atm

[INDIKÁCIE]

PTA balónikový dilatačný katéter Metacross OTW je určený na dilataciu stenóz v iliakálnych, femorálnych, iliofemorálnych, popliteálnych, infrapopliteálnych a renálnych artériách a na liečbu obštruktívnych lézií natívnych alebo syntetických artériovenózných dialyzačných fistúl. Táto pomôcka je indikovaná aj na postdilataciu stentov v periférnej vaskulatúre.

Poznámka: Vykonal sa verifikačný test pre postdilataciu stentu Metacross OTW pomocou systému vaskulárneho stentu Complete® SE (Medtronic, Inc), systému vaskulárneho stentu S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) a systému samoexpandovateľného stentu Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[KONTRAINDIKÁCIE]

1. Pacienti, u ktorých sa rozvinula anastomotická stenóza do jedného mesiaca po vytvorení konštrukcie AV shuntu.
2. Pacienti s léziami v spojení s pseudoaneurizmom.
3. Tehotné pacientky.
4. Pacienti, ktorí netolerujú antiagregačnú alebo ani antikoagulačnú liečbu.

[UPOZORNENIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA]**[UPOZORNENIA]**

1. Táto pomôcka je určená len na jednorazové použitie. Nepoužívať opakovane. Neresterilizovať. Neaplikujte opakovane. Repasovanie môže narušiť sterilitu, biokompatibilitu a fyzikálnu integritu pomôcky.
2. Nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu produktu alebo jednotkového balenia.
3. Balónik nenafukujte na viac než je priemer cievy, ktorá je proximálne a distálne k stenotickej lézii.
4. Balónik nenafukujte na tlak vyšší, než je menovitý tlak prasknutia.
5. Nepoužívajte tento katéter v centrálnom obehovom systéme.

[Preventívne opatrenia súvisiace s vykonávanými zákrokmi]

1. Opatrne a pomaly vybrať toto zariadenie z nosnej trubičky a odstrániť ochranné časti z tohto zariadenia. Pri nedbanlivom zaobchádzaní sa môže poškodiť balónik a/alebo driek katétra, čím sa znemožní nafúknutie a/alebo vyfúknutie balónika.
2. Balónik nafúknite kontrastným médiom rozpusteným vo fyziologickom roztoku v pomere 1:1 (ďalej len „nafukovacia kvapalina“). Pri nafukovaní sa nesmie použiť žiadne plyné médium. (Balónik sa môže nafukovať nepravidłene. a nafukovacieho lúmenu balónika a nahradte ho nafukovacou kvapalinou. (V prípade neúplného vypúšťania vzduchu nemožno stav nafúknutia balónika skioskopicky pozorovať.)
3. Pred použitím vytlačte všetok vzduch z balónika a nafukovacieho lúmenu balónika a nahradte ho nafukovacou kvapalinou. (V prípade neúplného vypúšťania vzduchu nemožno stav nafúknutia balónika skioskopicky pozorovať.)
4. V prípade závažných stenotických lézií ako kalcifikované lézie, nie je možné cievu plne dilatovať. V takomto prípade neaplikujte tlak, ktorý prekračuje menovitý tlak prasknutia. (Balónik môže prasknúť a jeho zvyšky môžu zostať v tele).
5. V prípade medicínskych pomôcok používaných spolu s týmto katétrom dodržiavajte pokyny na používanie týchto pomôcok. (Keď sa balónikový katéter používa na postdilataciu stentu počas zákroku vloženia periférneho stentu, pozrite si pokyny na použitie od daného výrobcu.)
6. Pri zavádzaní balónika do stentu, vyťahovaní zo stentu alebo dilatacií vnútri stentu postupujte opatrne pri súčasnom skioskopickom zobrazení. (Bez použitia skioskopického zobrazenia sa tento katéter môže poškodiť alebo môže poraniť cievu.)
7. Tento PTA balónikový dilatačný katéter Metacross OTW nezavádzajte nepresúvajte cez puzdro zavádzača s menšou veľkosťou, ako je uvedené na etikete. Pozrite si označenie produktu.

[Preventívne opatrenia počas používania]

1. Pomôcku použite okamžite po otvorení sterilného balenia.
2. Celú procedúru treba urobiť asepticky.
3. Tento katéter majú používať iba lekári so zručnosťami perkutánnej vaskulárnej terapie.
4. Vyberte katéter s náležitou veľkosťou balónika (priemer balónika, dĺžka balónika) podľa nasledujúcich kritérií (zákroku).
 - 1) Priemer nafúknutého balónika nesmie neprekročiť vnútorný priemer cievy, ktorá je proximálne a distálne k lézii.
 - 2) Dĺžka nafúknutého balónika nesmie prekročiť dĺžku ošetrovanej lézie. (Nevhodný výber katétra môže viesť k akútnej vaskulárnej oklúzii.)
5. Tento katéter používajte iba v prípade, ak je možné kedykoľvek vykonať núdzový chirurgický zákrok.

- Lekár vykonávajúci zákrok musí určiť trvanie a počet nafúknutí balónika na základe svojich doterajších skúseností.
- Počas zavedenia balónikového katétra v cieve treba infúzie podáky heparinizovaný fyziologický roztok na zabránenie koagulácii.
- Nikdy nenafukujte balónik ani neposúvajte vodiaci drôt s ohnutým alebo zauzleným katétrom.
- S katétrom v cieve manipulujte opatrne, umiestnenie a pohyb jeho špičky overujte skioskopicky alebo monitorovaním cez DSA (digitálnu subtrakčnú angiografiu).
- Balónik vždy nafukujte za stáleho sledovania jeho stavu nafúknutia pomocou skioskopie. Balónik opatrne nafukujte a súčasne overujte jeho pohyb pomocou röntgenkontraštných značiek. V prípade zistenia akejkoľvek anomálie, ako napríklad mierneho odporu, nepohyblivého katétra počas manipulácie alebo zauzlenej distálnej špičky vodiaceho drôtu, treba zákrok okamžite ukončiť a tento katéter treba pomaly vytiahnuť spolu s vodiacim drôtom.
- Katéter nezavádzajte ani nevytahujte rýchlo. (Rýchle postupovanie môže poškodiť tento katéter alebo poškodiť intímú cievy.)
- Katétrom nehybte, keď je balónik nafúknutý. (Pohyb katétra s nafúknutým balónikom môže spôsobiť prasknutie balónika alebo zlomenie drieku katétra.)
- Balónik v cieve nenafukujte ani nevytahujte rýchlo. (Rýchle nafúknutie alebo vyfúknutie balónika môže poškodiť cievu alebo spôsobiť prasknutie balónika, pričom jeho zvyšky zostanú v tele.)
- Na nafukovanie balónika nepoužívajte injektor (automatické injekčné zariadenie).
- Na zabránenie akéhokoľvek poškodenia katétra chirurgickým nožom alebo nožnicami treba vykonať preventívne opatrenia.
- Ak počas manipulácie s katétrom pocítite akúkoľvek anomáliu, ako napríklad silný odpor, zákrok okamžite ukončíte. Skontrolujte príčinu a vykonajte príslušné opatrenia. (Pokračovanie v operácii nadmernou silou môže spôsobiť poškodenie katétra alebo poškodenie steny cievy.)
- Vždy venujte pozornosť stavu pacienta a monitorujte teplotu tela, pulz a dychanie. Ak sa zaznamená akákoľvek anomália, okamžite ukončíte používanie tohto katétra alebo vykonajte príslušné opatrenia podľa stavu pacienta na základe uváženia lekára.
- Po použití katétra zlikvidujte ako medicínsky odpad podľa nemocničných postupov.
- Nepoužívajte látky obsahujúce organické rozpúšťadlá ani olejnaté kontrastné médiá. Kontakt s týmito látkami môže viesť k poškodeniu katétra.
- Počas manipulácie s týmto katétrom katéter nestáčajte ani ním netočte.
- Počas zavádzania tejto pomôcky do cievy alebo počas vyberania pomôcky z cievy zabezpečte, aby bol balónik úplne vyfúknutý. (Pomôcka s väčším alebo dlhším balónikom si vyžaduje dlhší čas na vyfúknutie).
- Ak počas vytahovania tejto pomôcky po vykonaní zákroku pocítite odpor, odporúča sa vytiahnuť celý systém spolu so zavádzacom / vodiacim puzdrom.
- Vždy používajte katéter spolu s vodiacim drôtom zavedeným v lúmene pre vodiaci drôt. Katéter zasúvajte po vodiacom drôte zavedenom do lúmenu vodiaceho drôtu.

[Operačné pokyny]

Medzi materiál potrebný pre vykonanie PTA s PTA balónikovým dilatáčným katétrom Metacross OTW patria:

- vodiaci drôt(-y) s náležitým priemerom a dĺžkou,
- vhodná súprava zavádzача/vodiaceho puzdra a dilatátora,
- ampulka s kontrastným médiom,
- ampulka so sterilným fyziologickým roztokom,
- nafukovacie zariadenie s manometrom,
- striekačka s konektorom luer-lock,
- trojcestný uzatvárací kohút.

[Spôsob operácie alebo pokyny na použitie]

- Výber katétra
Pred použitím overte pomocou skioskopie vnútorný priemer cievy proximálne a distálne k stenotickému lézii a vyberte katéter s príslušnou veľkosťou balónika. Ak sú vhodné pre overený priemer dve rôzne veľkosti, vyberte menšiu veľkosť.
- Príprava
 - Po aseptickom vybratí katétra z obalu snímte z katétra ochranné materiály.
 - Nahradte vzduch v balóniku a nafukovacom lúmene balónika za nafukovaciu kvapalinu podľa nasledujúcich postupov.
 - Nasajte nafukovacie zariadenie (nezahrnuté v tejto súprave) naplnené nafukovacou kvapalinou na prípojku na nafúknutie balónika.
 - Po aplikovaní podtlaku približne 10 sekúnd na nafukovacom zariadení nasmerujte špičku drieku katétra smerom nadol a pomaly uvoľňujte podtlak, aby mohla kvapalina naplniť balónik a nafukovací lúmen balónika a vytlačiť vzduch.
 - Ak sa v balóniku a nafukovacom lúmene balónika nachádza nejaký vzduch, zopakujte postup b), až kým sa vzduch úplne nevytlačí.
 - Odpojte nafukovacie zariadenie od nafukovacej prípojky balónika a odstráňte vzduch z valca nafukovacieho zariadenia.
 - Znovu pripojte nafukovacie zariadenie k prípojke na nafúknutie balónika a udržiavajte podtlak. Overte, či sa do striekačky nevracia už žiadny vzduch.
 - Lúmen vodiaceho drôtu prepľachnite heparinizovaným fyziologickým roztokom a lúmen naplňte heparinizovaným fyziologickým roztokom.
 - Ponorte celý PTA balónikový dilatáčný katéter Metacross OTW do fyziologického roztoku.
- Zavedenie a nafúknutie balónikového katétra
Pred použitím skontrolujte, či je tento katéter kompatibilný s vodiacim katétrom (nie je súčasťou tejto súpravy), puzdrom zavádzача (nie je súčasťou tejto súpravy) a vodiacim drôtom (nie je súčasťou tejto súpravy) podľa nasledujúcej tabuľky.

Katalógové číslo	Priemer balónika (mm)	Kompatibilné puzdro (Fr/mm)	Maximálny priemer pre vodiaci drôt (palce/mm)
BD-L30020SW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (vynímajúc dĺžku balónika 200 mm), 7 mm (dĺžka balónika 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0.035 palca (0.89 mm)
~	6 mm (iba dĺžka balónika 200 mm), 7 mm (vynímajúc dĺžku balónika 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
BD-L70200CW	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Pri použití katétra vloženého v puzdre zavádzача alebo vodiacom katétri

- Pri použití tohto katétra vo vodiacom katétri uvoľnite hemostatický ventil, avšak nechajte ho dostatočne tesný, aby sa zabránilo úniku krvi.
- Postupne po vodiacom drôte zavádzajte katéter s úplne vyfúknutým balónikom do puzdra zavádzача alebo vodiaceho katétra a posúvajte ho k distálnej periférii lézie. Pri skioskopickom zobrazení katétra pomaly posúvajte, aby sa röntgenkontrastná značka v balóniku dostala na cieľové miesto.
- Pri skioskopickom zobrazení overte polohu röntgenkontrastnej značky v balóniku a určite miesto dilatácie.
- Pripojte nafukovacie zariadenie riadne k prípojke na nafukovanie balónika.
- Postupne nafukujte balónik na cieľový priemer, pričom overujte tlak nafukovania, a dilatujte stenotickú léziu (pri priemeroch nafúknutého balónika si pozrite prehľad kompatibilitvy v Tabuľke 1 na konci týchto pokynov na používanie).

4. Vybratie katétra

- 1) Po úplnom vypustení balónika aplikovaním podtlaku odstráňte katéter.

5. Opätovné zavedenie katétra

- 1) Ak sa vyžaduje opätovné zavedenie vybratého katétra s vyfúknutým balónikom, zabezpečte, aby bol balónik úplne vyfúknutý a poskladaný skôr, než ho opätovne zavediete do cievy pacienta. Pri opätovnom zavádzaní použite katéter podľa pokynov v časti „Zavedenie a nafúknutie balónikového katétra“ tohto dokumentu.
- 2) Ak pri opätovnom zasúvaní katétra pocítite odpor, prestaňte so zasúvaním a opatrne katéter vyberte von z cievy pacienta. Pripravte si na použitie nový katéter Metacross OTW podľa postupov uvedených vyššie v tejto časti pokynov na používanie.

[Komplikácie]

Zlyhanie pomôcky:

- prasknutie balónika,
- nedostatočné nafúknutie, vyfúknutie balónika,
- zlomenie balónika a/alebo drieku katétra,
- ťažkosti pri vyberaní pomôcky,
- únik nafukovacej kvapaliny.

Nežiaduce udalosti:

- lokálne alebo systémové infekcie,
- lokálne vnútorné krvácanie alebo hematóm,
- prasknutie intímy cievy,
- vaskulárna disekcia,
- vaskulárna perforácia,
- vaskulárna ruptúra,
- aneuryzma,
- arytmia,
- akútna vaskulárna oklúzia,
- venózný tromboembolizmus,
- vazospazmus,
- vytvorenie pseudoaneurizmu,
- arteriovenózna fistula,
- krvácanie s nutnosťou transfúzie,
- alergická reakcia na kontrastné médium / zlyhanie obličiek,
- bolesť alebo úpenlivá bolesť,
- smrť,
- embólia,
- endokarditída,
- horúčka,
- hypertenzia / hypotenzia,
- zápal,
- infarkt myokardu,
- sepsa,
- šok,
- náhla mozgová príhoda iktus,
- tranzitórny ischemický atak.

[Skladovanie a dátum expirácie]

1. Uchovávať na chladom, suchom a tmavom mieste. Vyhybajte sa vystaveniu vode, priamemu slnečnému žiareniu.
2. Dátum expirácie je uvedený na škatuli. Nepoužívajte po dátume expirácie.

[Balenie]

1 súprava/krabica

[Meno a adresa výrobcu alebo obchodného zástupcu]



Výrobca: KANEKA CORPORATION

Adresa: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. č.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Fax: (+81)-(0) 6-6226-5143



Spínomocnený zástupca v Európskom spoločenstve:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresa: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Tel. č.: (+32)-(0) 14-256-297

Fax: (+32)-(0) 14-256-298

Distribútor v EÚ: TERUMO EUROPE N.V.

Adresa: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgicko

Tel. č.: (+32)-(0) 16 381 211

Fax: (+32)-(0) 16 400 249

Všetky názvy značiek sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti TERUMO CORPORATION a ich príslušných vlastníkov.

Tabuľka 1. Balónik Metacross OTW Prehľad kompatibility

Tlak (atm)	Priemer balónika (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00"	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06"	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										


* Nominálny tlak

** Menovitý tlak prasknutia

[ÜRÜN TANIMI]

Metacross OTW, periferik endikasyonlar için bir Perkütan Translüminal Anjiyoplasti (PTA) Balon Dilatasyon Kateteridir. Metacross OTW tel üstü (OTW) tipindedir ve uyumlu kılavuz telin maksimum çapı 0.035 inç (0,89 mm) şeklindedir.

Bu kateterin distal kısmı bir balon ve iki lümenli shaftlardan (koaksiyal) oluşur. Dış lümen balonun salın solüsyonla seyreltilmiş kontrast maddeyle şişirilmesi ve indirilmesi için kullanılır. İç lümen (kılavuz tel lümeni; distal uçtan kılavuz tel portuna) kateteri dilate edilecek stenotik lezyon veya stent içinden ilerletmeyi kolaylaştırmak üzere uyumlu bir kılavuz tel yerleştirmek içindir. Proksimal kısım çift luer port manifoldlu bir çift lümenli shafttır, bunların biri balonu şişirmek/indirmek için ve diğeri kılavuz tel lümeni erişimi içindir. Balon içinde balonun çalışma uzunluğuna işaret eden iki radyopak işaret doktorun floroskopi altında balonu hedeflenen lezyon içinde uygun şekilde konumlandırmasına rehberlik yapmak üzere yerleştirilmiştir. Metacross OTW önerilen şişirme basınçlarında (Nominal basınç) çap ve uzunluğa göre çeşitli balon büyüklüklerinde sağlanmaktadır. Şişirme sonrasında balon çapı şişirme basıncına göre değişir. Metacross OTW balon esneklik tablosu bu Kullanma Talimatı sonunda Tablo 1 içinde verilmiştir. Sterilizasyon paketine cihaz koruyucu materyal, bir balon koruma tüpü ve bir stile ile donatılmıştır ve bunların kullanım öncesinde çıkarılması gerekir. Balon koruma tüpü balonun üzerine alçak bir profile katlanmış olarak yerleştirilerek kateter shaftının çökmesini önlemek için stile kılavuz tel içine yerleştirilir. Kateterin distal ucu kateterin stenotik lezyon veya stent içine ilerlemesini kolaylaştırmak üzere koniktir.
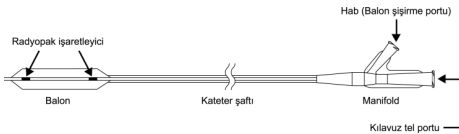
<HER BÖLÜMÜN İSMİ

Hasar görmemiş ve açılmamış blister poşette sterilidir ve pirojenik değildir. Bu ürün etilen oksitle sterilize edilmiştir.

Önerilen kılavuz tel çapı:

Maksimum çap: 0,035 inç (0,89 mm)

Önerilen şişirme basıncı ve maksimum şişirme basıncı**Nominal basınç:**

- Balon çapı: 6 mm'den az:	10 atm
- Balon çapı: 6 mm ve üstü :	8 atm

Anlık patlama basıncı:

- Balon çapı: 5 mm'den az:	20 atm
- Balon çapı: 5 mm:	18 atm
- Balon çapı: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 atm
- Balon çapı: 9 mm ve üstü:	12 atm

[ENDİKASYONLAR]

Metacross OTW PTA balon dilatasyon kateterinin iliyak, femoral, iliyofemoral, popliteal, infrapopliteal ve renal arterlerde stenoz dilatasyonunda ve doğal veya sentetik arteriyovenöz diyaliz fistüllerinin obstrüktif lezyonlarının tedavisinde kullanılması amaçlanmıştır. Bu cihaz ayrıca periferik vasküler sistemde stent post dilatasyonu için endikedir.

Not: Metacross OTW post dilatasyon doğrulama testi Complete® SE Vasküler Stent Sistemi (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vasküler Stent Sistemi (Cordis Corporation) ve Epic™ Vasküler Kendi Kendine Genişleyen Stent Sistemi (Boston Scientific Corporation) kullanılarak yapılmıştır.

[KONTRENDİKASYONLAR]

1. AV şant konstrüksiyonu sonrasında bir ay içinde anastomotik stenoz gelişmiş hastalar.
2. Bir psödoanevrizma ile iletişim halinde lezyonları bulunan hastalar.
3. Hamile hastalar.
4. Antitrombotik tedavi veya antikoagulan tedaviyi tolere edemeyen hastalar.

[UYARILAR VE ÖNLEMLER]**[Uyarılar]**

1. Bu ürün sadece tek kullanımlıktır. Tekrar kullanmayın. Tekrar sterilize etmeyin. Tekrar işleme tabi tutmayın. Tekrar işleme tabi tutmak bu ürünün sterilliğini, biyolojik uyumluluğunu ve fiziksel bütünlüğünü tehlikeye atarak bırakabilir.
2. Ürün veya ürün ambalajı hasarlıysa kullanmayın.
3. Stenotik lezyona proksimal ve distal kan damarının çapını aşacak şekilde balonu şişirmeyin.
4. Balonu anlık patlama basıncının üzerinde bir basınca şişirmeyin.
5. Bu kateteri merkezi dolaşım sisteminde kullanmayın.

[İşlemlerle ilgili önlemler]

1. Cihazı taşıyıcı tüp dışına dikkatli ve yavaş bir şekilde çıkarın ve cihazın koruyucu kısımlarını tekrar yerleştirin. Dikkatsiz muamele cihazın kateter shaftı ve/veya balonuna zarar verebilir ve balon şişmesi ve/veya inmesini bozabilir.
2. Balonu salinle 1:1 oranında seyreltilmiş kontrast maddeyle (bundan sonra, "şişirme sıvısı") şişirin. Şişirme için hava gibi herhangi bir gazlı ortam kullanılmamalıdır. (Balon düzensiz olarak şişebilir.)
3. Kullanım öncesinde balon ve balon şişirme lümeni içindeki tüm havayı dışarı atın ve yerine şişirme sıvısı koyun. (Tam olmayan hava çıkarma durumunda balon şişme durumu floroskopi altında gözlemlenemez.)
4. Kalsifik lezyonlar gibi ciddi stenotik lezyonlar durumunda kan damarı tam olarak dilate edilemez. Böyle bir durumda anlık patlama basıncını aşan bir basınç uygulamayın. (Balon patlayabilir ve kalıntılar vücut içinde kalabilir.)
5. Bu kateterle ilişkili olarak kullanılan tıbbi cihazlar için, bu cihazların kullanma talimatını izleyin. (Balon kateteri periferik stent yerleştirme işlemi sırasında stentin post dilatasyonu için kullanıldığında üreticinin kullanma talimatına başvurun.)
6. Stent içine yerleştirme, stentten geri çekme veya balonun stent içi dilatasyonu için floroskopi altında dikkatle ilerleyin. (Bu işlemi floroskopi olmadan yapmak katetere zarar verebilir veya kan damarında hasara yol açabilir.)
7. Metacross OTW PTA balon dilatasyon kateterini etikette belirtildienden daha küçük bir intradüser kılıf içinden geçirmeye kalkışmayın. Ürün etiketine başvurun.

[Kullanım sırasında önlemler]

1. Ürünü steril ambalajı açıldıktan hemen sonra kullanın.
2. Tüm işlem aseptik olarak yapılmalıdır.
3. Bu kateter sadece perkütan vasküler tedavi konusunda ehil doktorlarca kullanılmalıdır.
4. Uygun balon büyüklüğü (balon çapı, balon uzunluğu) değerine sahip kateteri şu kriterlere (prosedürlere) göre seçin.
 - 1) Şişmiş balonun çapı, lezyonun proksimal ve distalindeki iç damar çapını geçmemelidir.
 - 2) Şişirilen balonun uzunluğu, tedavi edilecek lezyonun uzunluğunu geçmemelidir. (Uygun olmayan kateter seçimi akut vasküler oklüzyona neden olabilir.)
5. Bu kateteri ancak her an acil cerrahi müdahale yapılabilecek durumlarda kullanın.
6. İşlemi yöneten doktor geçmiş deneyimleri uyarınca, balon şişirmelerin süresi ve sayısını belirlemelidir.
7. Bu balon kateter kan damarına yerleştirilmiş durumdayken antikoagülasyon için heparinize salın infüzyonu yapılmalıdır.
8. Kateter bükülü veya eğikken asla balonu şişirmeyin veya kılavuz teli ilerletmeyin.

- Kateter ucunun yeri ve hareketini floroskopi veya DSA (Dijital Subtraksiyon Anjiyografi) ile izleyerek doğrulama yoluyla kateteri kan damarı içinde dikkatle hareket ettirin.
- Balonun şişme durumunu daima floroskopi altında izleyerek şişirin. Balonun hareketini radyopak işaretlerle doğrularken dikkatle şişirin. Hafif direnç, manipülasyon sırasında kateterin hareket etmemesi veya kılavuz tel distal ucunun bükülmesi gibi herhangi bir anormallik saptanırsa işlem hemen sonlandırılmalı ve bu kateter, kılavuz tel ile birlikte yavaşça çıkarılmalıdır.
- Kateteri hızla yerleştirmeyin veya çıkarmayın. (Hızlı çalışmak bu katetere zarar verebilir veya vasküler intımıyı yaralayabilir.)
- Kateteri balon şişmiş haldeyken hareket ettirmeyin. (Kateteri balon şişmiş haldeyken hareket ettirmek balonun patlamasına veya kateter şaftının kırılmasına neden olabilir.)
- Balonu kan damarı içinde hızla şişirmeyin veya indirмейin. (Hızla şişirme veya indirme kan damarına zarar verebilir veya balonun patlayıcı yüzüt içinde kalıntılarının kalmasına neden olabilir.)
- Balonu şişirmek için bir enjektör (otomatik enjeksiyon cihazı) kullanmayın.
- Kateterin bir cerrahi bıçak veya makasla herhangi bir zarar görmesini önlemek için önlemler alınmalıdır.
- Kateter manipülasyonu sırasında kuvvetli direnç gibi herhangi bir anormallik saptanırsa işlem hemen sonlandırılmalıdır. Nedeni belirlenmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. (Operasyona aşırı güçle devam etmek kateter hasarı veya vasküler duvarın zarar görmesine yol açabilir.)
- Daima hastanın durumuna dikkat edin ve ateş, nabız ve solunumunu izleyin. Herhangi bir anormallik bulunduğu kateterin kullanımını hemen sonlandırın veya doktorun itibasına göre hastanın durumu için uygun önlemleri alın.
- Kullanımdan sonra kateteri hastane kurallarına göre tıbbi atık çöpiüne atın.
- Organik solventler veya oleajinöz kontrast madde içeren ajanlar kullanmayın. Bu ajanlarla temas etmek, kateter hasarına yol açabilir.
- Bu kateterin manipülasyonu sırasında kateteri bükmemeyin veya çevirmeyin.
- Bu kateteri kan damarına yerleştirirken veya bu kateteri kan damarından çıkarırken balonun tamamen inmiş olduğundan emin olun. (Daha büyük veya daha uzun balonlu bir cihaz, daha uzun bir indirme süresi gerektirir.)
- İşlemden sonra bu cihaz geri çekilirken direnç hissedilirse, tüm sistemi introduser / kılavuz kılıfı birlikte geri çekmek önerilir.
- Kateteri daima kılavuz tel lümenine yerleştirilmiş bir kılavuz telle kullanın.

[Kullanım talimatı]

Metacross OTW PTA balon dilatasyon kateteri ile PTA için tipik olarak gereken materyaller şunlardır:

- Uygun çap ve uzunlukta kılavuz tel(ler)
- Uygun introduser/kılavuz kılıf ve dilatör seti
- Kontrast madde şişesi
- Steril salin şişesi
- Manometreli şişirme cihazı
- Luer-lock şırınga
- Üç yollu musluk

[Kullanım yöntemi veya kullanma talimatı]

- Kateterin seçilmesi
Kullanım öncesinde stenotik lezyonun proksimal ve distal kan damarı iç çapını floroskopi altında doğrulayın ve uygun balon büyüklüğüne sahip kateteri seçin. Seçilen çap için iki büyüklük geçerliyse daha küçük olan boyu seçin.
- Hazırlıklar
 - Kateteri ambalajından aseptik olarak çıkardıktan sonra katetere koruyucu materyalleri çıkarın.
 - Balon ve balon şişirme lümeni içindeki hava yerine aşağıdaki işlemlere göre şişirme sıvısını koyun.
 - Şişirme sıvısıyla dolu şişirme cihazını (bu sette bulunmamaktadır) balon şişirme portuna takın.
 - Şişirme cihazına yaklaşık 10 saniye negatif basınç uyguladıktan sonra kateter şaftı ucunu aşağı doğru yerleştirin.

- ve sıvının balon ve balon şişirme lümenine girip havayı dışarı atmasını sağlamak için negatif basıncı yavaşça serbest bırakın.
- Balon ve balon şişirme lümeninde herhangi bir hava bulunduğu b) işlemini hava tamamen dışarı atılınca kadar tekrarlayın.
- d) Şişirme cihazını balon şişirme portundan ayırın ve şişirme cihazı silindirdinden havayı çıkarın.
- e) Şişirme cihazını tekrar balon şişirme portuna takın ve negatif basıncı sürdürün. Artık havanın şırıngaya döndüğünü doğrulayın.
- Kılavuz tel lümeninden heparinize salın geçirin ve lümeni heparinize salınle doldurun.
- Tüm Metacross OTW PTA balon dilatasyon kateterini haline batırın.
- Balon kateterinin yerleştirilmesi ve şişirilmesi
Kullanım öncesinde lümen kateterin kılavuz kateter (bu sette bulunmamaktadır), introduser kılıf (bu sette bulunmamaktadır) ve kılavuz telle (bu sette bulunmamaktadır) uyumlu olduğunu aşağıdaki tabloya göre kontrol edin.

Ürün kodu	Balon çapı (mm)	Uyumlu Kılıf (Fr/mm)	Kılavuz tel için maksimum çap (inç/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (200 mm Balon Uzunluğu hariç), 7 mm (20 mm, 40 mm Balon Uzunluğu)	5 Fr / 1,66 mm	0,035 inç (0,89 mm)
	6 mm (sadece 200 mm Balon Uzunluğu), 7 mm (20 mm, 40 mm Balon Uzunluğu hariç), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Kateteri introduser kılıf veya kılavuz katetere yerleştirilmesi olarak kullanırken

- Kateteri kılavuz kateter içinde kullanırken, hemostatik valfi kan sızıntısını önlemeye yetecek kadar sıkı tutarak gevşetin.
- Kateteri balon tamamen inmiş olarak introduser kılıf veya kılavuz kateter içine kılavuz tel üzerinden kademeli olarak yerleştirin ve lezyonun distal periferine kadar ilerletin. Floroskopi altında kateteri, balondaki radyopak işaretleyicisinin hedef bölgeye erişmesini sağlayacak şekilde ilerletin.
- Floroskopi altında balondaki radyopak işaretleyicisinin konumunu doğrulayın ve dilatasyon bölgesini belirleyin.
- Şişirme cihazını balon şişirme portuna sıkıca takın.
- Şişirme basıncını doğrularak balonu hedef çapa ulaştırmaya kadar kademeli olarak şişirin ve stenotik lezyonu dilate edin (şişirilmiş balon çapları için bu Kullanma Talimatı sonunda Tablo 1'de sağlanan balon esnekliği tablosuna başvurun).
- Kateterin çıkarılması
 - Balonu tamamen indirmek için negatif basınç uyguladıktan sonra kateteri çıkarın.
- Kateterin tekrar insersiyonu
 - Çıkarılmış kateterin indirilmiş balonla tekrar insersiyonu gerekiyorsa hastanın kan damarına tekrar yerleştirmeden önce balonun tamamen inmiş ve katlanmış durumda olduğundan emin olun. Tekrar insersiyon durumunda kateteri buradaki "Balon kateterinin insersiyonu ve şişirilmesi" kısmına göre kullanın.
 - Kateterin tekrar insersiyonu sırasında herhangi bir direnç karşılaşırsa ilerletmeyi durdurun ve hastanın kan damarından dikkatle çıkarın. Kullanma Talimatında bu bölüme yukarıda sağlanan işlemler uyarınca yeni bir Metacross OTW hazırlayın.

[Komplikasyonlar]

Cihaz Arızaları:

- Balon rüptürü
- Balonun yetersiz şişirilmesi/indirilmesi
- Balonun ve/veya kateter şaftının kopması
- Cihazı çıkarmakta zorluk
- Şişirme sıvısının sızması

Advers Olaylar:

- Lokal veya sistemik enfeksiyonlar

- Lokal iç kanama veya hematom
- İntima rüptürü
- Vasküler diseksiyon
- Vasküler perforasyon
- Vasküler rüptür
- Anevrizma
- Aritmi
- Akut vasküler oklüzyon
- Venöz tromboemboli
- Vazospazm
- Psödoanevrizma oluşumu
- Arteriyovenöz fistül
- Transfüzyon gerektiren kanama
- Kontrast maddeye alerjik cevap / böbrek yetmezliği
- Sızı veya basınç tarzında ağrı
- Ölüm
- Emboli
- Endokardit
- Ateş
- Hipertansiyon/Hipotansiyon
- Enflamasyon
- Miyokard enfarktüsü
- Sepsis
- Şok
- İnme
- Geçici İskemik Atak

[Saklama ve son kullanma tarihi]

1. Serin, kuru, karanlık bir yerde saklayın. Suya ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.
2. Son kullanma tarihi kutuda belirtilmiştir. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

[Paket]

1 set/kutu

[Üretici veya temsilcinin adı ve adresi]



Üretici firma: KANEKA CORPORATION

Adres: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288, JAPAN
TEL No.: (+81)-(0) 6-6226-5256
FAKS No.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Avrupa Topluluğunda Yetkili Temsilci:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adres: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
TEL No.: (+32)-(0) 14-256-297
FAKS No.: (+32)-(0) 14-256-298

AB Distribütörü: TERUMO EUROPE N.V.

Adres: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belçika
TEL No.: (+32)-(0) 16 381 211
FAKS No.: (+32)-(0) 16 400 249

Yazılı olan tüm şirket adları ve diğer adlar, TERUMO CORPORATION ve ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Tablo 1. Metacross OTW Balon Esnekliđi Tablosu

Basınç (atm)	Balon Çapı (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96*	6.98*	8.00*	8.98*	9.90*	11.98*
10	3.01*	3.98*	5.06*	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35**	10.42**	12.61**
14	3.14	4.13	5.27	6.39**	7.48**	8.58**	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50**						
20	3.36**	4.38**	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

* Nominal basınç


** Anma Patlama Basıncı

[TOOTE KIRJELDUS]

Metacross OTW on perkutaanse transluminaalse angioplastika (PTA) balloondilatatsiooni kateeter kasutamiseks perifeersetes veresoontes. Metacross OTW on juhtetraadi peal (OTW, over the wire) kasutatav kateeter, mille ühilduva juhtetraadi maksimumdiameeter on 0,035 tolli (0,89 mm).

Kateetri distaalsala koosneb balloonist ja kahekordse valendikuga (koaksiaalsest) kehaosast. Välimist valendikku kasutatakse ballooni täitmiseks soolalahusega lahjendatud kontrastainega ja selle lahuse eemaldamiseks. Sisemine valendik (juhtetraadi valendik; ulatub distaalselt kuni juhtetraadi pordini) on ette nähtud sobiva juhtetraadi sisestamiseks, et lihtsustada kateetri viimist läbi stenoosi või laiendatava stendi. Proksimaalses osas on kateetri kehaosa kahevalendikuline ning varustatud haardlukustusega (Luer-) pordi jaoturiga; üks valendik on ette nähtud ballooni täitmiseks/tühjendamiseks ja teine juhtetraadi jaoks. Ballooni sisse on paigutatud kaks ballooni tööpikkust näitavat röntgenkontrastset märgist, mis abistavad arsti ballooni õigel paigutamisel fluoroskoopia kontrolli all laiendatava stenoosi sisse. Metacross OTW on saadaval erineva diameetri ja pikkusega balloonisuurustega (soovitava täitmiserõhu ehk nominaalrõhu tingimustes). Täitmisel ballooni diameeter varieerub lähtuvalt täitmiserõhust. Metacross OTW kateetri ballooneid pausimismärgend on esitatud käesoleva kasutusjuhendi lõpus tabelis 1. Steriliseerimispakendis on seade varustatud enne kasutamist eemaldatavate kaitsematerjalidega – ballooni kaitsetoru ja stiletiga. Ballooni kaitsetoru pannakse madala profiiliga volditud ballooni peale ja stilet sisestatakse juhtetraadi valendikku kateetri kehaosa kokkuvajumise ennetamiseks. Kateetri distaalsots on koonilise ehitusega, et lihtsustada kateetri sisestamist stenoosi või stenti.

<IGA OSA NIMI>

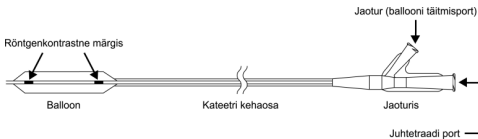

Steriilne ja mittepürogeenne kahjustamata ja avamata blistertaskus. See seade on steriliseeritud etüleenoksiidiga.

Soovitavat juhtetraadi diameeter

Maksimaalne diameeter: 0,035" (0,89 mm)

Soovitav täiterõhk ja maksimaalne täiterõhk

Nominaalrõhk:

- Ballooni diameeter: väiksem kui 6 mm: 10 atm
- Ballooni diameeter: 6 mm ja suurem: 8 atm

Nominaalne purunemiserõhk:

- Ballooni diameeter: väiksem kui 5 mm: 20 atm
- Ballooni diameeter: 5 mm: 18 atm
- Ballooni diameeter: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Ballooni diameeter: 9 mm ja suurem: 12 atm

[NÄIDUSTUSED]

Metacross OTW PTA balloondilatatsiooni kateeter on ette nähtud niudearterite, reiearterite, iliofemoraaarterite, õndlaarteri, infrapopliteaarterite ja neuruarterite stenooside laiendamiseks ja hemodialüüsi natiivsoontest või sünteetilise arteriovenoosse fistuli obstruktsivete muutuste raviks. See seade on ette nähtud ka perifeerse veresoone stendi järellaiendamiseks.

Märkus. Metacross OTW stendi järeldiaterimise verifitseerimisel kasutati Complete® SE Vascular Stent System veresoonte stentimissüsteemi (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System veresoonte stentimissüsteemi (Cordis Corporation) ja Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System veresoonte iselaienevat stentimissüsteemi (Boston Scientific Corporation).

[VASTUNÄIDUSTUSED]

1. Patsiendid, kellel on tekkinud anastomoosipiirkonna stenoos ühe kuu jooksul pärast arteriovenoosse šundi loomist.
2. Patsiendid, kellel on pseudoaneurüsmiga ühenduses olevad kahjustused.
3. Rasedad patsiendid.
4. Patsiendid, kes ei talu antiagregantravi või antikoagulantravi.

[HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD]

[Hoiatused]

1. See seade on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge kasutage korduvalt. Ärge steriliseerige. Ärge puhastage ega steriliseerige toodet uuesti. See võib riknuda seadme steriilsust, bioloogilist sobivust ja ehituslikku terviklikkust.
2. Ärge kasutage, kui toode või toote pakend on kahjustatud.
3. Ärge täitke ballooni rohkem kui stenoosist proksimaalsele ja distaalsele jääva veresoone diameeter.
4. Ärge täitke ballooni rõhuga, mis ületab nominaalse lõhkemiserõhu.
5. Ärge kasutage seda kateetrit vereringesüsteemi tsentraalses osas.

[Protseduuriga seotud ettevaatusabinõud]

1. Võtke seade ettevaatlikult ja aeglaselt transporditorust välja ja võtke seadme kaitseid. Hooletu käsitsemine võib kahjustada seadme ballooni ja/või kateetri kehaosa ning takistada ballooni täitmist ja/või tühjendamist.
2. Täitke ballooni füsioloogilise lahusega suhtes 1:1 lahjendatud kontrastainega (siin ja edaspidi „täitevedelik“). Täitmiseks ei tohi kasutada gaase, näiteks õhku. (Ballooni täitmine võib olla ebaühtlane.)
3. Enne kasutamist väljutage balloonist ja ballooni täitevalendikust kogu õhk ja asendage täitevedelikuga. (Kui õhku ei õnnestu täielikult eemaldada, ei ole fluoroskoopial võimalik ballooni täitmist jälgida.)
4. Raskete stenooside, nt kaltsifitseerunud stenooside korral ei saa veresoont täielikult laiendada. Sellistel juhtudel ärge kasutage nominaalset purunemiserõhku ületavat rõhku. (Balloon võib puruneda ja selle tükid võivad jääda organismi.)
5. Kateetriga koos kasutatavate meditsiiniseadmete puhul järgige nende seadmete kasutusjuhiseid. (Kui balloonkateetrit kasutatakse perifeerse veresoone stendi paigaldamise ajal järellaiendamiseks, lugege selle kohta tootja kasutusjuhiseid.)
6. Ballooni stenti sisestamisel, stendist eemaldamisel või stendi laiendamisel toimige ettevaatlikult fluoroskoopia kontrolli all. (Nende toimingute tegemine fluoroskoopia kontrollita võib kahjustada kateetrit või vigastada veresoont.)
7. Ärge proovige viia Metacross OTW PTA balloondilatatsiooni kateetrit läbi väiksema suurusse sisestushülssi, kui silidil näidatud. Vaadake toote etiketti.

[Kasutamisaegsed ettevaatusabinõud]

1. Kasutage seadet kohe pärast steriilse pakendi avamist.
2. Kogu protseduur tuleb teha aseptiliselt.
3. Kateetrit tohivad kasutada ainult perkutaanse vaskulaarse teraapia oskustega arstid.
4. Valige sobiva balloonisuurusega (ballooni diameetri, ballooni pikkusega) kateeter, järgides allpool toodud (protseduuri) kriteeriume.
 - 1) Täidetud ballooni diameeter ei tohi ületada kahjustusest proksimaalsele ja distaalsele jääva veresoone sisediameetrit.
 - 2) Täidetud ballooni pikkus ei tohi ületada ravitava stenoosi pikkust. (Kateetri ebaõige valik võib põhjustada ägedat veresoonesulgust.)
5. Kasutage kateetrit ainult siis, kui on olemas erakorralise operatsiooni tegemise võimalus.
6. Protseduuri eest vastutav arst otsustab oma varasema kogemuse alusel ballooni täitmise kestuse ja täitmiskordade arvu.
7. Balloonkateetri veresoonde sisestamise ajal peab antikoagulasiooniks infundeerima hepariniseeritud füsioloogilist lahust.

8. Ärge mitte kunagi täitke ballooni ega lükake juhtetraati edasi, kui kateeter on paindunud või niverdunud.
9. Liigutage kateetrit veresoones ettevaatlikult, kontrollides selle otsa asukohta ja liikumist fluoroskoopia või DSA (digitaalne subtraktsiooniangiograafia) monitoril.
10. Ballooni täitmise ajal kontrollige alati selle täitumist fluoroskoopia abil. Täitke balloon ettevaatlikult, kontrollides röntgenkontrastsete märgiste abil selle liikumist. Kui esineb kõrvalekalde normist, näiteks vähimigi resistentsus, kateetri muutumine manipuleerimise ajal liikumatuks või juhtetraadi distaalotsa niverdumine, tuleb protseduur kohe katkestada ja kateeter koos juhtetraadiga eemaldada.
11. Ärge sisestage ega eemaldage kateetrit kiiresti. (Kiire liigutamine võib kahjustada kateetrit või vigastada veresoone sisekesta.)
12. Ärge liigutage kateetrit, kui balloon on täidetud. (Kateetri eemaldamine täidetud ballooniga võib põhjustada ballooni lõhkumise või kateetri kehaosa purunemise.)
13. Ärge täitke ega tühjendage ballooni veresoones kiiresti. (Kiire täitmine või tühjendamine võib kahjustada veresoont või põhjustada ballooni purunemist, mille tagajärjel jäävad ballooni osad kehasse.)
14. Ärge kasutage ballooni täitmiseks automaatsüstalt.
15. Kateetri kahjustamise vältimiseks kirurgilise noa või käärdega tuleb olla ettevaatlik.
16. Kui tunnete kateetri käsitsemise ajal mis tahes häiret, nagu tugev takistus, tuleb protseduur kohe katkestada. Välja tuleb selgitada selle häire põhjus ja rakendada asjakohaseid abinõusid. (Protseduuri jätkamine ülemäärase jõu kasutamisega võib kahjustada kateetrit või vigastada veresoone seinu.)
17. Pöörake alati tähelepanu patsiendi seisundile ja jälgige kehatemperatuuri, pulssi ja hingamist. Kõrvalekallete esinemisel katkestage kohe kateetri kasutamine või rakendage arsti otsuse kohaselt patsiendi seisundile vastavaid abinõusid.
18. Pärast kasutamist visake kateeter meditsiiniliste jäätmete hulka, järgides haigla protseduure.
19. Ärge kasutage orgaanilisi lahuseid ega õlipõhiseid kontrastaineid. Kokkupuude nende ainetega võib kateetrit kahjustada.
20. Kateetri käsitsemise ajal ärge painutage ega pöörake kateetrit.
21. Seadme veresoone sisestamisel või veresoonest eemaldamisel veenduge, et balloon on täielikult tühjendatud. (Suurema ja pikema balloonia seadme korral on vajalik pikem tühjendamisaeg.)
22. Kui protseduuri järel on tunda seadme eemaldamise ajal takistust, soovitatakse kogu süsteem koos sisestaja/juhtühisiga välja tõmmata.
23. Kasutage kateetrit alati koos selle valendikku sisestatud juhtetraadiga.

[Kasutusjuhised]

Metacross OTW PTA balloondilatatsiooni kateetri kasutamiseks vajalike materjalide hulka kuuluvad tavaliselt:

- sobiva diameetri ja pikkusega juhtetraat
- sobiv sisestaja/juhtehüls ja dilataatorikomplekt
- kontrastaine
- steriilne füsioloogiline lahus
- manomeetriga täitmisseade
- haardlukustusega (Luer) süstal
- kolmesuunaline korkraan

[Kasutusmeetod või kasutusjuhised]

1. Kateetri valik
Enne kasutamist kontrollige fluoroskoopia abil veresoone sisediameetrit enne ja pärast stenoosilist kahjustust ja valige sobiva balloonisuurusega kateeter. Kui määratud diameetri puhul on võimalik kasutada kahte balloonisuurust, siis valige väiksem suurus.
2. Ettevalmistamine
 - 1) Pärast kateetri aseptilist eemaldamist pakendikonteinerist eemaldage kateetri kaitsematerjalid.
 - 2) Asendage balloonis ja ballooni täitevalendikus olev õhk täitevedelikuga, järgides alpool kirjeldatud protseduuri.
 - a) Kinnitage täitevedelikuga täidetud täitmisseade (ei kuulu komplekti) ballooni täitmispordi külge.

- b) Pärast negatiivse rõhu rakendamist täitmisseadmele ligikaudu 10 sekundi jooksul suunake kateetri kehaosa ots allapoole ja vabastage negatiivne rõhk aeglaselt, et lasta vedelikul voolata ballooni ja ballooni täitevalendikku ja õhk välja suruda.
- c) Kui ballooni või ballooni täitevalendikku on jäänud veel õhku, korrake protseduuri b) seni, kuni kogu õhk on süsteemist väljutatud.
- d) Eemaldage täitmisseade ballooni täitmispordi küljest ja eemaldage täitmisseadme silindris olev õhk.
- e) Ühendage täitmisseade uuesti ballooni täitmispordiga ja säilitage negatiivne rõhk. Veenduge, et süstlasse ei tule enam õhku.
- 3) Loputage juhtetraadi valendik hepariniseeritud füsioloogilise lahusega ja täitke valendik hepariniseeritud füsioloogilise lahusega.
- 4) Kastke kogu Metacross OTW PTA balloondilatatsiooni kateeter füsioloogilisse lahusesse.
3. Balloonsüsteemi sisestamine ja täitmine
Enne kasutamist kontrollige alljärgnevat tabelist, kas seda kateetrit saab kasutada koos juhtekateetriga (ei kuulu sellesse komplekti), sisestushülsiga (ei kuulu sellesse komplekti) ja juhtetraadiga (ei kuulu sellesse komplekti).

Kataloogi nr	Ballooni diameeter (mm)	Ühilduv hüls (Fr/mm)	Juhtetraadi maksimaalne diameeter (tolid/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (v.a 200 mm ballooni pikkus), 7 mm (20 mm, 40 mm ballooni pikkus)	5 Fr / 1,66 mm	0.035 tolli (0,89 mm)
	6 mm (ainult 200 mm ballooni pikkus), 7 mm (v. a 20 mm, 40 mm ballooni pikkus), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Kateetri kasutamine koos sisestushülsi või juhtekateetriga

- 1) Kateetri kasutamisel juhtekateetris keerake hemostaasiklappi rohkem lahti, hoides seda siiski küllaldasel määral suletuna, et vältida vere leket.
- 2) Sisestage täielikult tühjendatud ballooni kateeter juhtetraadi peal järk-järgult sisestushülssi või juhtekateetrisse ja lükake see aeglaselt perifeerse veresoone stenoosist distaalsemale. Lükake fluoroskoopia kontrolli all kateetrit aeglaselt edasi seni, kuni ballooni röntgenkontrastne märgis jõuab sihtkohta.
- 3) Kontrollige fluoroskoopia abil ballooni röntgenkontrastse märgise asukohta ja määrake laiendamiskohad.
- 4) Ühendage täitmisseade kindlalt ballooni täitmispordiga.
- 5) Täitke balloon täiterõhku jälgides järk-järgult sihtdiameetrit ja laiendage stenoos (täidetud ballooni diameetrid on esitatud käesoleva kasutusjuhendi lõpus paisumisandmete tabelis 1).
4. Kateetri eemaldamine
 - 1) Eemaldage kateeter pärast negatiivse rõhu rakendamist ballooni täielikuks tühjendamiseks.
5. Kateetri uuesti sisestamine
 - 1) Kui vajalik on eemaldatud kateetri uuesti sisestamine tühja ballooni, siis veenduge enne kateetri uuesti sisestamist patsiendi veresoone, et balloon on täiesti tühi ja et balloon on kokku volditud. Kateetri uuesti sisestamisel järgige käesoleva juhendi lõigus „Balloonsüsteemi sisestamine ja täitmine” antud juhiseid.
 - 2) Kui te tunnete kateetri korduval sisestamisel mis tahes takistust, siis lõpetage kateetri edasilükkamine ja eemaldage see ettevaatlikult patsiendi veresoonest. Valmistuge kasutama uut Metacross OTW kateetrit, järgides ülalkirjeldatud protseduure käesoleva kasutusjuhendi kõnealuses lõigus.

[Tüsistused]

Seadme rikked:

- ballooni purunemine
- ballooni ebapiisav täitmine/tühjendamine
- ballooni ja/või kateetri kehaosa purunemine

- raskused seadme eemaldamisel
- täitevedeliku leke

Kõrvaltoimed:

- paikne või süsteemne infektsioon
- paikne sisemine veritsus või hematoom
- veresoone sisekasta rebend
- veresoone dissektsioon
- veresoone perforatsioon
- veresoone ruptuur
- aneurüsm
- arütmia
- äge veresoonesulgus
- venoosne trombemboolia
- vasospasm
- pseudoaneurüsmi moodustumine
- arteriovenoosne fistul
- vereülekannet vajav verejooks
- allergiline reaktsioon kontrastainele / neerupuudulikkus
- valu või palpatoorne valuikkus
- surm
- emboolia
- endokardiit
- palavik
- hüpertensioon/hüpotensioon
- põletik
- müokardiinfarkt
- sepsis
- šokk
- insult
- transitoorne isheemiline atakk

[Säilitamine ja aegumiskuupäev]

1. Hoida kuivas, jahedas, pimedas kohas. Vältida kokkupuudet vee ja otsese päikesevalgusega.
2. Aegumiskuupäev on näidatud karbil. Ärge kasutage pärast aegumiskuupäeva.

[Pakend]

1 komplekt/karp

[Tootja või esindaja nimi ja aadress]



Tootja: KANEKA CORPORATION

Aadress: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN

Tel nr: (+81)-(0) 6-6226-5256

Faksi nr: (+81)-(0) 6-6226-5143



Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Aadress: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Tel nr: (+32)-(0) 14-256-297

Faksi nr: (+32)-(0) 14-256-298

Edasimüüja Euroopa Liidus: TERUMO EUROPE N.V.

Aadress: Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgia

Tel nr: (+32)-(0) 16 381 211

Faksi nr: (+32)-(0) 16 400 249

Kõik marginimetused on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele TERUMO CORPORATION ja vastavatele omanikele.

Tabel 1. Metacross OTW ballooni paisumisandmete tabel

Rõhk (atm)	Ballooni diameeter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35''	10.42''	12.61''
14	3.14	4.13	5.27	6.39''	7.48''	8.58''	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50''						
20	3.36''	4.38''	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

* Nominaalrõhk

** Nominaalne purunemisrõhk

[PRODUKTA APRAKSTS]

Metacross OTW ir zemādas transluminālais (PTA) dilatācijas balonkatetrs angioplastijas procedūru veikšanai perifēriskajos asinsvados. Metacross OTW ir balonkatetra (OTW) veids, un saderīgas vadītājstīgas maksimālais diametrs ir 0.035 collas (0,89 mm). Šī katetra distālo sekciju veido balons un divu lūmenu ass (koaksālais). Ārējo lūmenu izmanto balona infūcijai un deflācijai ar kontrastvielu, kas atšķaidīta ar fizioloģisko šķidrumu. Iekšējais lūmens (vadītājstīgas lūmens, no distālā uzgaļa līdz vadītājstīgas atverei) ir paredzēts saderīgas vadītājstīgas ievietošanai, lai atvieglotu katetra ievadīšanu caur stenotisku asinsvada bojājumu vai dilatācijai paredzētu stentu. Proksimālā sekcija ir divu lūmenu ass ar divu Luera atveru kolektoru; viena balona infūcijai /deflācijai, otra vadītājstīgas lūmena piekļuvei. Balona iekšpusē ir novietoti divi rentgenstarojumu necaurlaidīgi markieri, kas norāda balona darba garumu un palīdz ārstam pareizi novietot balonu vajadzīgajā bojātajā asinsvadā, izmantojot fluoroskopiju. Metacross OTW ir pieejams ar dažāda izmēra baloniem atkarībā no to diametra un garuma pie ieteicamā infūcijas spiediena (nominālais spiediens). Pie infūcijas balonu diametrs atšķiras atkarībā no infūcijas spiediena. Metacross OTW balonu saderības rādītāji ir sniegti 1. tabulā, kas ievietota šo lietošanas norādījumu beigās. Sterilizēšanas komplektā ierīce ir aprīkota ar aizsargmateriāliem, balona aizsargcaurulīti un stīletī, kas visi ir jānoņem pirms lietošanas. Balona aizsargcaurulīte ir novietota pār balonu un salocīta nelielā izmērā, un stīlete ir ievietota vadītājstīgas lūmenā, lai aizsargātu katetra daļu no salūšanas. Katetra distālais uzgalis ir konusveida, lai atvieglotu katetra ievadīšanu stenotiskajā asinsvada bojājumā vai stentā.

<KATRAS DAĻAS NOSAUKUMS>

Sterils un aprobežots katetrs atrodas nebojātā un neatvērtā blistera iepakojumā. Šī ierīce ir sterilizēta ar etilēna oksīdu.

Ieteicamais vadītājstīgas diametrs:

Maksimālais diametrs: 0,035"(0,89 mm)

Ieteicamais piepildīšanas spiediens un maksimālais piepildīšanas spiediens

Nominālais spiediens:

- balona diametrs: mazāks par 6 mm : 10 atm
- balona diametrs: 6 mm un lielāks : 8 atm

Aprēķinātais sprādziena spiediens:

- balona diametrs: mazāks par 5 mm : 20 atm
- balona diametrs: 5 mm : 18 atm
- balona diametrs: 6 mm, 7 mm, 8 mm : 14 atm
- balona diametrs: 9 mm un lielāks : 12 atm

[INDIKĀCIJAS]

Metacross OTW PTA dilatācijas balonkatetrs ir paredzēts, lai dilatētu stenozī iegurna, femorālajā, iliofemorālajā, popliteālajā, infrapopliteālajā un renālajā artērijā, kā arī dabīgās vai sintētiskās arteriovenozās dialīzes fistulas obstruktīvu bojājumu ārstēšanai. Šī ierīce ir arī paredzēta stenta pēcdilatācijas procedūrām perifērajās asinsvados.

Piezīme: Metacross OTW verifikācijas tests stenta pēcdilatācijai tika veikts, izmantojot Complete® SE asinsvadu stentu sistēmu (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® asinsvadu stentu sistēmu (Cordis Corporation) un Epic™ asinsvadu stentu sistēmu ar pašpaplašināšanas funkciju (Bostonas zinātniskā korporācija).

[KONTRINDIKĀCIJAS]

1. Pacientiem, kuriem ir izveidojusies anastomozes stenoze viena mēneša laikā pēc AV šunta izveidošanas.
2. Pacientiem ar patoloģijām, kas saistītas ar pseidoaneirismu.
3. Pacientēm-grūtniecēm.
4. Pacientiem, kuri nepanes antitrombotisku un antikoagulantu terapiju.

[BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI]**[Brīdinājumi]**

1. Šī ierīce paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Nelietot atkārtoti. Atkārtoti nesterilizēt Neapstrādāt atkārtoti. Atkārtota apstrāde var radīt risku ierīces sterilītai, biosavietojamībai un fiziskajam veselumam.
2. Nelietot, ja produkta vai daļas iepakojums ir bojāts.
3. Piepildiet balonu tik daudz, lai tas nepārsniegtu diametru asinsvada proksimālajā un distālajā daļā līdz stenotiskam asinsvada bojājumam.
4. Nepiepildiet balonu līdz spiedienam, kas pārsniedz aprēķināto sprādziena spiedienu.
5. Nelietojiet šo katetru centrālajā asinsvadu sistēmā.

[Piesardzības pasākumi, kas saistīti ar procedūram]

1. Uzmanīgi un lēnām izņemiet šo ierīci no pārmešanas apvalka un noņemiet aizsargdaļas no šīs ierīces. Bezrūpīga apiešanās ar ierīci var bojāt ierīces balonu un/vai katetra daļu, radot traucējumus balona piepildīšanai un/vai iztukšošanai.
2. Piepildiet balonu ar kontrastvielu, kas atšķaidīta ar fizioloģisko šķidrumu proporcijā 1:1 (šeit un turpmāk tekstā, "piepildīšanas šķidrums"). Piepildīšanai nedrīkst lietot gāzveida vielu, piemēram, gaisu. (Balonu var piepildīt neregulāri.)
3. Pirms lietošanas izlaist visu balona un balona piepildīšanas lūmenā esošo gaisu un nomainīt to ar piepildīšanas šķidrumu. (Nepilnīgas gaisa izlaišanas gadījumā balona piepildīšanas stāvokli nevar novērot fluoroskopijā.)
4. Smagu stenotisku asinsvadu bojājumu gadījumos, piemēram, apkaļķojušies asinsvadi, asinsvadu nav iespējams pilnībā paplašināt. Šajā gadījumā nepiemērojiet spiedienu, kas pārsniedz aprēķināto sprādziena spiedienu. (Balons var pārsprāgt un tā atliekas var palikt ķermenī.)
5. Attiecībā uz medicīnas ierīcēm, kas tiek lietotas kopā ar šo katetru, izmantojiet norādījumus par šādu ierīču izmantošanu. (Kad balonkatetrs tiek lietots stenta pēcdilatācijai perifērā stenta ievietošanas procedūras laikā, skatiet ražotāja lietošanas norādījumus.)
6. Balona ievietošanu stentā, izņemšanu no stenta vai dilatāciju stentā veiciet uzmanīgi, veicot novērošanu fluoroskopijā. (Neveicot novērošanu fluoroskopijā var sabojāt šo katetru vai radīt asinsvada bojājumus.)
7. Nemēģiniet ievietot Metacross OTW PTA dilatācijas balonkatetru caur mazāka izmēra ievadslūžām, nekā tas norādīts uz marķējuma. Skatiet produkta marķējumu.

[Piesardzības pasākumi lietošanas laikā]

1. Lietojiet ierīci tūlīt pēc sterilitātes iepakojuma atvēršanas.
2. Procedūra pilnībā jāveic aseptiski.
3. Šī katetra lietošana ir atļauta ārstiem, kuriem ir pieredze zemādas asinsvadu terapijā.
4. Izvēlieties katetru ar atbilstošu balona izmēru (balona diametru, balona garumu) saskaņā ar tālāk minēto (procedūru) kritērijiem.
 - 1) Piepildīt balona diametrs nedrīkst pārsniegt asinsvada iekšējo diametru proksimālajā un distālajā daļā līdz bojātam asinsvadam.
 - 2) Piepildīt balona garums nedrīkst pārsniegt ārstēšanai paredzētā bojātā asinsvada garumu. (Neatbilstoša katetra izvēlēšanās var izraisīt akūtu asinsvada oklūziju.)
5. Lietojiet šo katetru tikai tad, kad neatliekama operācija var tikt veikta jebkurā laikā.

- Par procedūru atbildīgajam ārstam ir jānosaka balona piepildīšanas ilgumu un skaitu, pamatojoties uz savu iepriekšējo pieredzi.
- Antikoagulācijai jāievada heparīnu saturošs fizioloģiskais šķīdums, kamēr balonkatetrs atrodas asinsvadā.
- Nepiepildiet balonu vai nevīziet vadītājstīgu, ja katetrs ir salocījies vai savījijs.
- Uzmanīgi manipulējiet katetru asinsvadā, pārbaudot tā uzgaļa novietojumu un kustību, izmantojot fluoroskopiju vai DSA (Digitālās subtrakcijas angiogrāfijas) monitoru.
- Vienmērīgi piepildiet balonu, novērojot tā piepildīšanas stāvokli, ar fluoroskopijas palīdzību. Uzmanīgi piepildiet balonu, uzraugot tā kustību ar rentgenstarojuma neaurlaidīgiem marķieriem. Ja tiek novērota jebkāda veida anomālija, piemēram, neliela pretestība, nekustīgs katetrs manipulācijas laikā vai savijies vadītājstīgas distālās uzgaļis, procedūru ir nekavējoties jāpārtrauc un šo katetru kopā ar vadītājstīgu ir lēnām jāizņem.
- Neievietojiet vai neizņemiet šo katetru strauji. (Ātra darbība var sabojāt katetru vai radīt asinsvada iekšējus bojājumus.)
- Neviziet šo katetru, ja balons ir piepildīts. (Virzot šo katetru, ja balons ir piepildīts, var izraisīt balona sprāgšanu vai katetra daļas salīšanu.)
- Kad balons ir asinsvadā, to strauji nepiepildiet vai neiztukšojiet. (Strauja balona piepildīšana vai iztukšošana var sabojāt asinsvadu vai izraisīt balona sprāgšanu, kā rezultātā tā atliekas var palikt ķermenī.)
- Nelietojiet inžektoru (automātisku injekcijas ierīci), lai piepildītu balonu.
- Jāievēro piesardzība, lai novērstu katetra bojājumus, ko var radīt skalpelis vai šķēres.
- Ja tiek novērota jebkāda veida anomālija, piemēram, stipra pretestība katetra manipulācijas laikā, procedūru ir nekavējoties jāpārtrauc. Jānosaka cēlonis un jāveic atbilstoši pasākumi. (Turpinot operāciju ar pārmērīgu spēku, var radīt katetra bojājumu vai asinsvada sienas savainojumu.)
- Vienmēr ņemiet vērā pacienta stāvokli un novērojiet ķermeņa temperatūru, pulsu un elpošanu. Ja tiek konstatēta jebkāda veida anomālija, nekavējoties pārtrauciet katetra izmantošanu vai veiciet atbilstošus pasākumus pacienta stāvokļa normalizēšanai ārstu uzraudzībā.
- Pēc katetra izmantošanas likvidējiet katetru kā medicīniskos atkritumus saskaņā ar slimnīcā pieņemto kārtību.
- Nelietojiet reagentus, kas satur organiskus šķīdinātājus vai eļļainas kontrastvielas. Nonaķet saskarē ar šiem reagentiem katetram var rasties bojājums.
- Veicot manipulācijas ar šo katetru, nelieciet vai negrieziet katetru.
- Ievadot šo ierīci asinsvadā vai izņemot šo ierīci no asinsvada pārliecinieties, ka balons ir pilnībā iztukšots. (Ierīcei ar lielāku un garāku balonu būs nepieciešams ilgāks laiks, lai balons iztukšotos.)
- Ja pēc procedūras veikšanas šīs ierīces izņemšanas laikā novērojama pretestība, ieteicams izņemt visu sistēmu kopā ar ievadītāju/vadītājslūžām.
- Vienmēr lietojiet katetru kopā ar vadītājstīgu, kas ievietota vadītājstīgas atverē.

[Darbības norādījumi]

Materiāli, kas parasti nepieciešami PTA ar Metacross OTW PTA dilatācijas balonkatetru, ietver:

- vadītājstīgu(-as) ar atbilstošu diametru un garumu
- atbilstošu ievadītāju/vadītājslūžas un dilatora komplektu
- kontrastvielas flakonu
- sterila fizioloģiskā šķīduma flakonu
- piepildīšanas ierīci ar manometru
- Luera slēga šļirci
- trīsvirzienu noslēgkrānu

[Darbības metode vai lietošanas norādījumi]

1. Katetra izvēle

Pirms lietošanas pārbaudiet asinsvada iekšējo diametru proksimāli un distāli līdz stenotiskam asinsvada bojājumam, izmantojot fluoroskopiju, un izvēlieties katetru ar atbilstošu balona

izmēru. Ja pārbaudītajam diametram ir izmantojami divi izmēri, tad izvēlieties mazāko.

2. Sagatavošana

- Atdaliet aizsargmateriālus pēc tam, kad katetrs ir aseptiski izņemts no iepakojuma.
- Balonā un balona piepildīšanas lūmenā esošo gaisu nomainiet ar kontrastvielā saskaņā ar tālāk minētajām procedūram.
 - Pievienojiet piepildīšanas ierīci (nav ietverta šajā komplektā), kas piepildīta ar piepildīšanas šķidrumu, pie balona piepildīšanas atveres.
 - Pēc aptuveni 10 sekunžu negatīvā spiediena piemērošanas piepildīšanas ierīci virziet katetra daļas uzgaļi uz leju un lēnām atbrīvojiet negatīvo spiedienu, lai ļautu šķidrumam piepildīt balonu un balona piepildīšanas lūmenu un izvadītu gaisu.
 - Ja pēc tam balonā un balona piepildīšanas lūmenā ir palicis gaiss, atkārtojiet procedūru b), līdz viss gaiss ir pilnībā izvadīts.
 - Atvienojiet piepildīšanas ierīci no balona piepildīšanas atveres un izvadiet gaisu no piepildīšanas ierīces cilindra.
 - Pievienojiet atkal piepildīšanas ierīci balona piepildīšanas atverei un saglabājiet negatīvu spiedienu. Pārbaudiet, vai šļircē vairāk nenonāk atpakaļ gaiss.
- Izskalojiet vadītājstīgas lūmenu ar heparīnu saturošu fizioloģisko šķidrumu un piepildiet lūmenu ar heparīnu saturošu fizioloģisko šķidrumu.
- Iegremdējiet visu Metacross OTW PTA dilatācijas balonkatetru fizioloģiskajā šķīdumā.
- Balonkatetra ievietošana un piepildīšana

Pirms lietošanas, lūdzu, pārbaudiet, vai šis katetrs ir saderīgs ar vadītājkatetru (nav ietverts šajā komplektā), ievadslūžām (nav ietvertas šajā komplektā) un vadītājstīgu (nav ietverta šajā komplektā), saskaņā ar tālāk esošo tabulu.

Kataloga Nr.	Balona diametrs (mm)	Saderīgas slūžas (Fr/mm)	Vadītājstīgas maksimālais diametrs (collas/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (izņemot 200 mm gariem baloniem), 7 mm (20 mm, 40 mm gariem baloniem)	5 Fr / 1,66 mm	0,035 collas (0,89mm)
	6 mm (īkai 200 mm gariem baloniem), 7 mm (izņemot 20 mm, 40 mm gariem baloniem), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Lietojot katetru, kas ievietots ievadslūžās vai vadītājkatetrā

- Lietojot šo katetru vadītājkatetrā, atbrīvojiet hemostatisko ārstu, vienlaicīgi turot to pietiekami cieši noslēgtu, lai novērstu asins noplūdi.
- Pakāpeniski ievadiet katetru ar pilnībā iztukšotu balonu ievadslūžās vai vadītājkatetrā pa vadītājstīgu un virziet līdz bojātā asinsvada distālai perifērijai. Lietojot fluoroskopiju, lēnām virziet katetru, lai tā rentgena kontrastējošais marķieris balonā sasniegtu vajadzīgo vietu.
- Lietojot fluoroskopiju, pārbaudiet rentgena kontrastējošā marķiera novietojumu balonā un nosakiet dilatācijas vietu
- Stingri pievienojiet piepildīšanas ierīci balona piepildīšanas atverei.
- Pakāpeniski piepildiet balona līdz vajadzīgajam diametram, pārbaudot piepildīšanas spiedienu un dilatējot stenotisko asinsvada bojājumu (informāciju par balonu inflācijas diametriem skatiet balonu saderības rādītāju tabulā, kas ievietota šo lietošanas norādījumu beigās 1. tabulā).
- Katetra izņemšana
 - Pēc negatīvā spiediena piemērošanas, lai pilnībā iztukšotu balonu, izņemiet katetru.
- Katetra atkārtota ievietošana
 - Ja nepieciešama atkārtota izņemšana katetra ar iztukšotu balonu ievadīšana, pārliecinieties, ka balons ir pilnībā iztukšots un salocīts, pirms tā atkārtotas ievadīšanas pacienta asinsvadā. Veicot atkārtotu ievadīšanu, lietojiet katetru saskaņā ar šeit esošo sadaļu "Balonkatetra ievietošana un inflācija".

- 2) Ja katetra atkārtotas ievadīšanas laikā novērota jebkāda veida pretestība, pārtrauciet tā ievadīšanu un uzmanīgi izņemiet to no pacienta asinsvada. Sagatavojieties izmantot jaunu Metacross OTW saskaņā ar procedūrām, kas sniegtas iepriekš šo lietošanas norādījumu nodaļā.

[Komplikācijas]

Ierīces atteices:

- balona plīsums
- nepietiekama balona piepildīšana/iztukšošana
- balona vai katetra daļas salūšana
- grūtības izņemt ierīci
- piepildīšanas šķidruma noplūde

Blakusparādības

- Lokālās vai sistēmiskās infekcijas
- Lokālā iekšējā asiņošana vai hematoma
- Iekšējs plīsums
- Asinsvadu disekcija
- Asinsvadu perforācijas
- Asinsvada plīsums
- Aneirisma
- Aritmija
- Akūta asinsvadu oklūzija
- Venozā trombembolija
- Vazospazmas
- Pseudoaneirismas veidošanās
- Arteriovenozā fistula
- Asiņošana, kam nepieciešama asins pārliešana
- Alerģiskā reakcija uz kontrastvielu/nieru atteice
- Sāpes vai spiedošas sāpes
- Nāve
- Embolija
- Endokardīts
- Drudzis
- Hipertensija/hipotensija
- Iekaisums
- Miokarda infarkts
- Sepsē
- Šoks
- Insults
- Pārejoša išēmiska lēkme

[Uzglabāšana un derīguma termiņš]

1. Uzglabāt vēsā, sausā, tumšā vietā. Nepakļaut ūdenim, tiešiem saules stariem.
2. Derīguma termiņš norādīts uz kārbas. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

[Iepakojums]

1 komplekts/kārba

[Ražotāja vai pārstāvja vārds, uzvārds un adrese]



Ražotājs: KANEKA CORPORATION

Adrese: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. Nr.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Faksa Nr.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autorizēts pārstāvis Eiropas Kopienā:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adrese: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel. Nr.: (+32)-(0) 14-256-297
Faksa Nr.: (+32)-(0) 14-256-298

Izplatītājs ES: TERUMO EUROPE N.V.

Adrese: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Beļģija
Tel. Nr.: (+32)-(0) 16 381 211
Faksa Nr.: (+32)-(0) 16 400 249

Visi zīmoli ir uzņēmuma TERUMO CORPORATION un attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.

1. tabula. Metacross OTW balonu saderības tabula

Spiediens (atm)	Balona diametrs (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00"	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										

* Nominālais spiediens

** Aprēķinātais sprādziena spiediens

[PRODUKTO APRAŠYMAS]

„Metacross OTW“ yra poodinės transiluminalinės vienos skersmuo (PTA) kateteris su išplečiamuoju balionėliu, skirtas periferinėms indikacijoms. „Metacross OTW“ yra ant vielos (angl. „over the wire“) įvedamo tipo, o didžiausias suderinamas kreipiamosios vielos skersmuo yra 0.035 in (0,89 mm). Šio kateterio distalinė dalis sudaryta iš balionėlio ir dvigubo spindžio stiebo (bendraašė). Išorinis spindis naudojamas balionėliui pripūsti ir išleisti su kontrastine medžiaga, atskiesta fiziologiniu tirpalu. Vidinis spindis (kreipiamosios vielos spindis; nuo distalinio galiuko iki kreipiamosios vielos angos) naudojamas suderinamos kreipiamosios vielos įkišimui, kad būtų galima pravesti kateterį per stenozuotą pažeidimą ar plėtiną stentą. Proksimalinę dalį sudaro dvigubo spindžio stiebas ir du Luerio jungties kolektoriai; vienas jų naudojamas balionėliui pripūsti / išleisti, o kitas – kreipiančiosios vielos spindžio prieigai. Balionėlio viduje yra du rentgenokontrastiniai žymekliai, nurodantys balionėlio darbinį ilgį ir padedantys gydytojui fluoroskopu tinkamai išdėstyti balionėlį reikiamoje pažeidimo vietoje. „Metacross OTW“ tiekiamas su įvairiais balionėlių dydžiais pagal skersmenį ir ilgį su rekomenduojamais pripūtimo slėgiais (vardiniu slėgiu). Pripūsto balionėlio skersmuo skiriasi atsižvelgiant į pripūtimo slėgį. „Metacross OTW“ balionėlių atitikties diagrama pateikta šių naudojimo instrukcijų pabaigoje esančioje 1 lentelėje. Sterili pakuotė, kurioje yra prietaisas, turi apsaugines medžiagas, balionėlio apsauginį vamzdelį ir stiletą, kuriuos reikia pašalinti prieš naudojimą. Balionėlio apsauginį vamzdelį reikia uždėti ant smulkiai sulankstyto balionėlio, o stiletą įkišti į kreipiamosios vielos spindį, kad nesusispaustų kateterio stiebas. Smalėjantis kateterio distalinis galiukas palengvina kateterio įvedimą į stenozuotą pažeidimą ar stentą.

<KIEKVIENOS DALIES PAVADINIMAS>

Sterilus ir nedegus nepažeistame ir neatidarytame maišelyje. Šis prietaisas sterilizuotas etileno oksidu.

Rekomenduojamas kreipiamosios vielos skersmuo:

Maksimalus skersmuo: 0,89 mm (0,035 colio)

Rekomenduojamas pripildymo slėgis ir maksimalus pripildymo slėgis

Vardinis slėgis:

- Balionėlio skersmuo: mažesnis nei 6 mm: 10 atm
- Balionėlio skersmuo: 6 mm ir didesnis: 8 atm

Vardinis srauto slėgis:

- Balionėlio skersmuo: mažesnis nei 5 mm: 20 atm
- Balionėlio skersmuo: 5 mm: 18 atm
- Balionėlio skersmuo: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Balionėlio skersmuo: 9 mm ir didesnis: 12 atm

[INDIKACIJOS]

„Metacross OTW“ PTA kateteris su išplečiamuoju balionėliu yra skirtas stenozėi išplėsti klubo, šlaunies, klubo–šlaunies, pakinklio, žemiau pakinklio esančiose ir inkstų arterijose bei natūralios arba sintetinės arterioveninės dializės fistulių obstrukciniams pažeidimams gydyti. Be to, šis įtaisas yra skirtas stentui papildomai išplėsti periferinėse kraujagyslėse.

Pastaba: „Metacross OTW“ papildomo išplėtimo patikros testas buvo atliktas naudojant „Complete™ SE kraujagyslių stento sistemą („Medtronic, Inc“), S.M.A.R.T.® CONTROL® kraujagyslių stento sistemą („Cordis Corporation“) ir „Epic™“ savaimė išsiplečiančią kraujagyslių stento sistemą („Boston Scientific Corporation“).

[KONTRAINDIKACIJOS]

1. Pacientai, kuriems išsivystė anastomotinė stenozė per viena mėnesį po AV šunto įstatymo.
2. Pacientai, kurių organizme rasta pakitimų dėl pseudoaneurizmos.
3. Neščios pacienės.
4. Pacientai, kurie negali toleruoti gydymo antitrombotiniais vaistais arba antikoagulantais.

[ISPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS]**[Ispėjimai]**

1. Šis įrenginys yra tik vienkartinio naudojimo. Nenaudoti pakartotinai. Nesterilizuoti. Pakartotinai neapdoroti. Pakartotinai apdorojus gali pablogėti įrenginio sterilumas, biologinis suderinamumas ir fizinis vientisumas.
2. Nenaudokite, jeigu produkto arba įrenginio pakuotė buvo pažeista.
3. Nepripildykite balionėlio tiek, kad jo skersmuo būtų didesnis nei kraujagyslės skersmuo prieš stenotinį pažeidimą ir už jo.
4. Nepripūskite balionėlio slėgiu, viršijančiu vardinį plyšimo slėgį.
5. Nenaudokite šio kateterio centrinei kraujagyslių apykaitos sistemai.

[Atsargumo priemonės, susijusios su procedūromis]

1. Atsargiai ir lėtai išimkite prietaisą iš transportavimo vamzdelio ir nuimkite apsaugines dalis nuo prietaiso. Neatsargiai elgiantis galima pažeisti prietaiso balionėlį ir (arba) kateterio korpusą, susilpninti balionėlio pripildymą ir (arba) išleidimą.
2. Pripildykite balionėlį kontrastine medžiaga, atskiesta fiziologiniu tirpalu santykiu 1:1 (toliau „pripildymo skystis“). Balionėliui pripildyti negalima naudoti dujinės terpės, pavyzdžiui, oro (balionėlis gali netolygiai išsiplėsti).
3. Prieš naudodami išstumkite visą orą iš balionėlio bei jo pripildymo angos ir pakeiskite jį pripildymo skystimi (nevisiškai pašalinus orą, balionėlio pripildymo būsenos nebus galima stebėti fluoroskopu).
4. Esant stipriems stenotiniams pažeidimams, pavyzdžiui, užkalkėjimams, kraujagyslė gali būti ne visiškai išplėsta. Tokiu atveju neviršykite vardinio plyšimo slėgio (balionėlis gali plyšti ir jo liekanos gali likti kraujagyslėje).
5. Kartu su šiuo kateteriu naudodami kitus medicininius įrenginius, laikykitės šių įrenginių naudojimo instrukcijų (kai naudojate balioninį kateterį stentui papildomai išplėsti periferinio stento įstatymo procedūros metu, žiūrėkite gamintojo naudojimo instrukcijas).
6. Įvesdami į stentą, ištraukdami iš stento arba pripūsdami stentą balionėlį, procedūrą atlikite atidžiai stebėdami fluoroskopu (tai atlikdami be fluoroskopo galite sugadinti šį kateterį arba pažeisti kraujagyslių sienelės).
7. Nebandykite prastumti „Metacross OTW“ PTA kateterio su išplečiamuoju balionėliu per mažesnio dydžio įvedimo movą, nei nurodyta etiketėje. Žiūrėkite gamtinio etiketę.

[Atsargumo priemonės naudojant]

1. Naudokite įrenginį iškart atidarę sterilią pakuotę.
2. Visa procedūra turi būti atliekama aseptinėmis sąlygomis.
3. Šį kateterį gali naudoti tik gydytojai, turintys patirties poodinės kraujagyslių terapijos srityje.
4. Pasirinkite kateterį su atitinkamo dydžio balionėliu (balionėlio skersmuo, balionėlio ilgis) pagal šiuos (procedūrų) kriterijus.
 - 1) Pripildyto balionėlio skersmuo neturi viršyti vidinio kraujagyslių skersmens proksimalinėje ir distalinėje pažeidimo srityje.
 - 2) Pripildyto balionėlio ilgis neturi viršyti gydymo pažeidimo ilgio (netinkamai pasirinkus kateterį galima ūmi kraujagyslių okliuzija).
5. Naudokite šį kateterį tik tada, kai yra galimybė bet kuriuo metu iškilus pavojui atlikti operaciją.
6. Už procedūrą atsakingas gydytojas turi nustatyti balionėlio pripildymo trukmę ir skaičių remdamasis ankstesne patirtimi.
7. Kai balionėlio kateteris yra įvestas į kraujagyslę, krešėjimui sumažinti turi būti įleidiama heparinizuoto fiziologinio tirpalo.
8. Niekada nepūskite balionėlio ir nestumkite kreipiamosios vielos, kai kateteris yra sulanktas arba susuktas.

9. Atsargiai manipuliukite kateteriu kraujagyslėje stebėdami jo galiuko padėtį bei judėjimą fluoroskopu arba DSA (angl. „Digital Subtraction Angiography“) monitoriumi.
10. Visada pildykite balionėlį stebėdami jo pripildymo būklę fluoroskopu. Pildykite balionėlį atsargiai, stebėdami jo judėjimą pagal rentgenokonstrastines žymes. Pastebėjus ką nors neįprasto, pvz., nedidelį pasipriešinimą, nejudantį kateterį manipuliuojant arba užsikimšusį distalinį kreipiamosios vielos antgalį, procedūrą reikia nedelsiant nutraukti, o šį kateterį lėtai ištraukti kartu su kreipiamąja viela.
11. Neįveskite arba neištraukite šio kateterio greitai (dėl staigių veiksmų gali sugesti šis kateteris arba būti pažeistos kraujagyslių sienelės).
12. Nejudinkite kateterio, kol balionėlis pripildytas (judinant kateterį su pripildytu balionėliu gali sprogti balionėlis arba sulūžti kateterio stiebas).
13. Greitai nepildykite arba neišleiskite balionėlio, jam esant kraujagyslėje (greitai pildant arba išleidžiant galima pažeisti kraujagyslę arba balionėlis gali sprogti, ir jo liekanos liks organizme).
14. Nenaudokite stūmoklio (automatinio įleidimo įrenginio), kai pripildote balionėlį.
15. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte kateterio chirurginių peiliu ar žirkklėmis.
16. Jei manipuliudami kateteriu pajutote ką nors neįprasto, pavyzdžiui, stiprų pasipriešinimą, nedelsdami nutraukite procedūrą. Reikia nustatyti priežastį ir imtis atitinkamų priemonių (tęsdami procedūrą ir naudodami per didelę jėgą, galite sugadinti kateterį arba pažeisti kraujagyslės sienelę).
17. Visada atkreipkite dėmesį į paciento būklę ir stebėkite kūno temperatūrą, pulsą bei kvėpavimą. Pastebėję ką nors neįprasto, nedelsdami nutraukite šiuo kateteriu atliekamą procedūrą arba gydytojo nuožūria imkitės atitinkamų priemonių paciento būklei pagerinti.
18. Panaudoję pašalinkite kateterį kaip medicinines atliekas pagal ligoninės procedūras.
19. Nenaudokite jokių medžiagų, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių arba aleijinės kontrastinės terpės. Dėl sąlyčio su šiomis medžiagomis gali sugesti kateteris.
20. Manipuliudami šiuo kateteriu, nesusukite ir nepasukite kateterio.
21. Įvesdami šį prietaisą į kraujagyslę arba išimdami jį iš kraujagyslės, įsitikinkite, kad balionėlis yra visiškai išleistas (prietaisui duodiesni ir ilgesniu balionėliu išleisti reikia daugiau laiko).
22. Jeigu po procedūros ištraukiant šį prietaisą jaučiamas pasipriešinimas, rekomenduojama ištraukti visą sistemą kartu su įvedimo įtaisu ir kreipiamąja mova.
23. Visada naudokite kateterį su kreipiamąja viela, įvesta į kreipiamosios vielos spindį.

[Naudojimo instrukcijos]

Priemonės, dažniausiai reikalingos PTA su „Metacross OTW“ PTA kateteriu su išplečiamuoju balionėliu, yra šios:

- Atitinkamo skersmens ir ilgio kreipiamoji viela (ar kreipiamosios vielos)
- Atitinkamas įvedimo įtaiso / kreipiamosios mova ir plėtiklio rinkinys
- Kontrastinės medžiagos buteliukas
- Sterilus fiziologinio tirpalo buteliukas
- Pildymo įtaisas su manometru
- Švirkštas su Luerio jungtimi
- Trijų atšakų čiaupas

[Naudojimo metodas arba instrukcijos]

1. Kateterio pasirinkimas

Prieš naudodami fluoroskopu patikrinkite kraujagyslės vidinį skersmenį proksimaliai ir distaliai stenotiniame pažeidime bei pasirinkite kateterį su atitinkamo dydžio balionėliu. Jeigu patikrinus skersmenį tinka du dydžiai, pasirinkite mažesnįjį.

2. Pasiruošimas

- 1) Steriliai išėmę šį kateterį iš pakuotės, nuimkite nuo jo apsaugines medžiagas.
- 2) Pakeiskite orą balionėlyje ir jo pripildymo spindyje pripildymo skysčiu, vykdydami šias procedūras.

- a) Pritvirtinkite pripildymo įrenginį (šiam rinkinyje nėra), pripildytą pripildymo tirpalo, prie balionėlio pripildymo prievado.
 - b) Pripildymo įrenginiu apytiksliai 10 sekundžių panaudoję neigiamą slėgį, nukreipkite kateterio stiebo antgalį žemyn ir lėtai leiskite neigiamą slėgį, kad skystis pripildytų balionėlį, jo pripildymo spindį ir išspausytų orą.
 - c) Jeigu balionėlyje ir pripildymo kanale bus likę orų, kartokite procedūrą, b) kol oras bus visiškai pašalintas.
 - d) Atjunkite pripildymo įrenginį nuo balionėlio pripildymo prievado ir pašalinkite orą iš pripildymo įrenginio cilindro.
 - e) Vėl prijunkite pripildymo įtaisą prie balionėlio pripildymo angos ir panaudokite neigiamą slėgį. Įsitikinkite, kad oras nebegrižta į švirkštą.
- 3) Praplaukite kreipiamosios vielos spindį heparinizuotu fiziologiniu tirpalu ir pripildykite spindį heparinizuotu fiziologiniu tirpalu.
 - 4) Įmerkite visą „Metacross OTW“ PTA kateterį su išplečiamuoju balionėliu į fiziologinį tirpalą.
 3. Balioninio kateterio įvedimas ir pripildymas

Prieš naudodami patikrinkite, ar šis kateteris yra suderinamas su kreipiamuoju kateteriu (šiam rinkinyje nėra), įvedimo mova (šiam rinkinyje nėra) ir kreipiamąja viela (šiam rinkinyje nėra) pagal toliau pateikiamą lentelę.

Katalogo Nr.	Balionėlio skersmuo (mm)	Suderinama mova (Fr/mm)	Maksimalus kreipiamosios vielos skersmuo (in/mm)
BD-L3002OSW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (išskyrus 200 mm balionėlio ilgį, 7 mm (20 mm, 40 mm balionėlio ilgį))	5 Fr / 1,66 mm	0,035 in (0,89 mm)
	6 mm (tik 200 mm balionėlio ilgį), 7 mm (išskyrus 20 mm, 40 mm balionėlio ilgį), 8 mm	6Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Naudodami šį kateterį, įstatytą į įvedimo įtaiso movą arba kreipiamąjį kateterį

- 1) Naudodami kateterį su kreipiamuoju kateteriu, atlaisvinkite hemostatinį vožtuvą, laikydami jį pakankamai prispaudę, kad netekėtų kraujas.
- 2) Tolygiai įstatykite kateterį su visiškai išleistu balionėliu, į įvedimo movą arba kreipiamąjį kateterį kreipiamąją viela ir stumkite į distalinį pažeidimo kraštą. Stebėdami fluoroskopu, lėtai stumkite kateterį, kol balionėlio rentgenokonstrastinė žymė pasieks numatytą vietą.
- 3) Stebėdami fluoroskopu patikrinkite balionėlio rentgenokonstrastinės žymės padėtį ir nustatykite išplėtimo vietą.
- 4) Tvirtai prijunkite pripildymo renginį prie balionėlio pripildymo angos.
- 5) Palaipsniui pripildykite balionėlį iki reikiamo skersmens tikrindami pripildymo slėgį ir išplėskite stenotinį pažeidimą. (Išpūstų balionėlių skersmenų ieškokite balionėlių atitikties diagramoje, pateiktoje šių naudojimo instrukcijų pabaigoje esančioje 1 lentelėje).
4. Kateterio išėmimas
- 1) Naudodami neigiamą slėgį visiškai ištuštinkite balionėlį, išimkite kateterį.
5. Pakartotinis kateterio įvedimas
- 1) Jei reikia pakartotinai įvesti ištrauktą kateterį su išleistu balionėliu, įsitikinkite, kad balionėlis visiškai išleistas ir sulankstytas prieš jį pakartotinai įvesdami į paciento kraujagyslę.
- 2) Jei kateterio pakartotinio įvedimo metu jaučiamas bet koks pasipriešinimas, nebestumkite jo ir atsargiai jį ištraukite iš paciento kraujagyslės. Paruoškite naudojimui naują „Metacross OTW“ vadovaudamiesi procedūromis, pateiktomis šiame naudojimo instrukcijų skyriuje.

[Komplikacijos]

Prietaiso gedimai:

- Balionėlio plyšimas
- Nepakankamas balionėlio pripildymas / išleidimas
- Balionėlio ir (arba) kateterio stiebo lūžimas
- Problemos išimant prietaisą
- Pripildymo skysčio ištekėjimas

Nepageidaujami reiškiniai:

- Vietinės arba sisteminės infekcijos
- Vietinis vidinis kraujavimas arba hematoma
- Intimos plyšimas
- Kraujagyslių perpjovimas
- Kraujagyslių pradūrimas
- Kraujagyslių plyšimas
- Aneurizma
- Aritmija
- Ūmi kraujagyslių okliuzija
- Venos tromboembolija
- Kraujagyslių spazmai
- Pseudoaneurizmos susiformavimas
- Arterioveninė fistulė
- Kraujavimas su būtinu kraujo perpylimu
- Alerginė reakcija į kontrastinę terpę
- Skausmas arba spaudžiantis maudimas
- Mirtis
- Embolija
- Endokarditas
- Karščiavimas
- Hipertenzija / hipotenzija
- Uždegimas
- Miokardo infarktas
- Sepsis
- Šokas
- Insultas
- Praeinantis smegenų išemijos priepuolis

[Saugojimas ir galiojimo laikas]

1. Laikykite vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje. Saugokite nuo vandens, tiesioginių saulės spindulių.
2. Galiojimo data nurodyta ant dėžutės. Nenaudokite pasibaigus galiojimo datai.

[Pakuotė]

1 komplektas / dėžutė

[Gamintojo arba atstovo vardas, pavardė ir adresas]



Gamintojas: KANEKA CORPORATION

Adresas: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. (+81)-(0) 6-6226-5256
Faks. (+81)-(0) 6-6226-5143



Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresas: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel. (+32)-(0) 14-256-297
Faks. (+32)-(0) 14-256-298

ES platintojas: TERUMO EUROPE N.V.

Adresas: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgija
Tel. (+32)-(0) 16 381 211
Faks. (+32)-(0) 16 400 249

Visi prekių ženklai yra „TERUMO CORPORATION“ ir jos atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

1 lentelė. „Metacross OTW“ balionėliųatitikties diagrama


Slėgis (atm)	Balionėlio skersmuo (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96*	6.98*	8.00*	8.98*	9.90*	11.98*
10	3.01*	3.98*	5.06*	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35**	10.42**	12.61**
14	3.14	4.13	5.27	6.39**	7.48**	8.58**	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50**						
20	3.36**	4.38**	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

* Vardinis slėgis

** Vardinis srauto slėgis:

[OPIS IZDELKA]

Metacross OTW je balonski kateter za dilatacijo za periferno uporabo pri perkutani transluminalni angioplastiki (PTA). Metacross OTW je speljan preko žice, največji premer združljive vodilne žice pa je 0,89 mm. Distalni del tega katetra sestavljajo balon in cevka z dvojno svetlino (koaksialna zasnova). Zunanja svetlina se uporablja za polnjenje in praznjenje balona s kontrastnim sredstvom, razredčenim s fiziološko raztopino. Notranja svetlina (svetlina vodilne žice; od distalne konice do odprtine vodilne žice) služi vstavljanju združljive vodilne žice za lažje potiskanje katetra skozi stenotično lezijo ali opornico, ki jo je treba dilatirati. Proksimalni del je cevka z dvojno svetlino in razdelilnikom z dvojnimi priključkom Luer; eden za polnjenje/praznjenje balona, drugi pa za dostop do svetline vodilne žice. V balonu se nahajata dva radioneprepustna označevalca, ki označujeta delovno dolžino balona, kar zdravniku olajša pravilno postavitev balona v želeni leziji pod presvetlitvijo. Balonski kateter Metacross OTW je na voljo v različnih velikostih balona po premeru in dolžini pri priporočenih tlakih polnitve (nazivni tlak). Po polnjenju se premer balona razlikuje glede na tlak polnitve. Razpredelnico skladnosti za balone katetra Metacross OTW najdete v 1. tabeli na koncu teh navodil za uporabo. V paketu za sterilizacijo je priprava opremljena z zaščitnimi materiali, zaščitnim tulcem balona in mandrenom, kar je treba pred uporabo odstraniti. Zaščitni tulec balona je nameščen prek zloženega balona, mandren pa se nahaja v svetlini vodilne žice ter preprečuje sesedanje cevke katetra. Distalna konica katetra je koničasta zaradi lažjega pomikanja katetra v stenotično lezijo ali opornico.
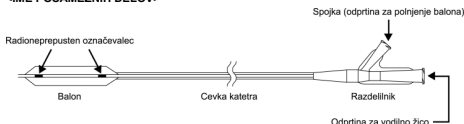
<IME POSAMEZNIH DELOV>

Sterilno in apirogeno v nepoškodovani in neodprti plastični vrečki. Ta priprava je sterilizirana z etilen oksidom.

Priporočen premer vodilne žice:

Največji premer: 0,89 mm

Priporočen tlak za polnitev in najvišji tlak za polnitev**Nazivni tlak:**

- Premer balona: manjši od 6 mm: 10 barov
- Premer balona: 6 mm in več: 8 barov

Naznačen delovni tlak:

- Premer balona: manjši od 5 mm: 20 barov
- Premer balona: 5 mm: 18 barov
- Premer balona: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 barov
- Premer balona: 9 mm in več: 12 barov

[INDIKACIJE]

Balonski kateter za dilatacijo PTA Metacross OTW je namenjen dilataciji stenoz v črevesnih, femoralnih, črevesno-femoralnih, poplitealnih, infra-poplitealnih in ledvičnih arterijah ter zdravljenje obstruktivnih lezij nativnih ali sintetičnih arteriovenskih fistul za dializo. Priprava je namenjena tudi post-dilataciji opornice v perifernem ožilju.

Opomba: preizkus preverjanja za post-dilatacijo katetra Metacross OTW je bil opravljen z uporabo vaskularnega sistema opornice Complete® SE (Medtronic, Inc), vaskularnega sistema opornice S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) in vaskularnega sistema samorazširjive opornice EpicTM (Boston Scientific Corporation).

[KONTRAINDIKACIJE]

1. Bolniki, pri katerih se je en mesec po vzpostavitvi arteriovenskega spoja pojavila anastomozna stenoza.
2. Bolniki z lezijami, ki komunicirajo s psevdanevrizmo.
3. Nosečnice.
4. Bolniki, ki ne prenesejo antiagregacijske terapije ali terapije s sredstvom proti strjevanju krvi.

[OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI]**[Opozorila]**

1. Ta priprava je namenjena le enkratni uporabi. Ni za ponovno uporabo. Ni namenjeno ponovnemu steriliziranju. Ne predelujte ponovno. Predelovanje lahko ogrozi sterilnost, biološko združljivost in funkcionalno neokrnjenost priprave.
2. Ne uporabljajte, če je izdelek ali embalaža poškodovan/a.
3. Ne polnite balona bolj, kot znaša premer krvne žile proksimalno in distalno od stenotične lezije.
4. Balona ne smete napolniti bolj, kot znaša naznačen delovni tlak.
5. Tega katetra ne uporabljajte v osrednjem cirkulacijskem sistemu.

[Varnostni ukrepi, povezani s postopki]

1. Previdno in počasi odstranite pripravo iz nosilne cevke in namestite nazaj zaščitne dele s priprave. Neprevidno rokovanje lahko poškoduje balon in/ali cevko katetra priprave, kar ovira polnjenje in/ali praznjenje balona.
2. Napolnite balon s kontrastnim sredstvom, razredčenim s fiziološko raztopino v razmerju 1:1 (v nadaljevanju tekočino za polnjenje). Za polnjenje ne smete uporabljati plinskih sredstev, kot je zrak. (Balon se lahko neenakomerno napolni.)
3. Pred uporabo iztisnite ves zrak iz balona in razširitvene svetline balona ter ga nadomestite s tekočino za polnjenje. (V primeru nepopolne odstranitve zraka stanja napolnenosti balona ne bo mogoče opazovati pod presvetlitvijo.)
4. V primeru hudih stenotičnih lezij, kot so poapnele lezije, krvne žile ni mogoče povsem razširiti. Tudi v tem primeru ne prekoračite naznačenega delovnega tlaka. (Balon lahko počni in delci lahko ostanejo v telesu.)
5. Za medicinske pripomočke, uporabljene skupaj s tem katetrom, upoštevajte navodila za uporabo takih pripomočkov. (Ko balonski kateter uporabljate za post-dilatacijo opornice med postopkom vstavljanja periferne opornice, si oglejte proizvajalčeva navodila za uporabo.)
6. Vstavljanje v opornico, odstranjevanje iz opornice ali dilatacijo balona znotraj opornice opravite previdno pod presvetlitvijo. (Če za te postopke ne boste uporabili presvetlitve, lahko pride do poškodb katetra ali notranje plasti žile.)
7. Balonskega katetra za dilatacijo PTA Metacross OTW ne poskušajte spravilskizki vodilo, manjše od označenega na nalepki. Poglejte oznako izdelka.

[Previdnostni ukrepi med uporabo]

1. Pripravo uporabite takoj po odprtju sterilne embalaže.
2. Celoten postopek je treba opraviti aseptično.
3. Ta kateter lahko uporabljajo le zdravniki, ki imajo izkušnje s perkutanim žilnim zdravljenjem.
4. Izberite kateter z ustrežno velikostjo balona (premer balona, dolžina balona) v skladu z naslednjimi (postopki) merili.
 - 1) Premer napolnjenega balona ne sme preseči notranjega premera žile proksimalno in distalno od lezije.
 - 2) Dolžina napolnjenega balona ne sme preseči dolžine lezije, ki jo je treba zdraviti. (Neprimerna izbira katetra lahko pripelje do akutne žilne zapore.)
5. Ta kateter uporabite le, ko lahko v trenutku izvedete urgentno operacijo.
6. Zdravnik, odgovoren za postopek, mora določiti trajanje in število polnjenj balona glede na svoje pretekle izkušnje.
7. Heparinizirano fiziološko raztopino je treba infundirati zaradi preprečevanja strjevanja krvi, medtem ko je ta balonski kateter vstavljen v žilo.

8. Balona ne polnite in ne potiskajte vodilne žice naprej, ko je kateter ukrivljen ali upognjen.
9. Kateter previdno uvajajte v krvno žilo in ob tem preverjajte mesto in pomikanje njegove konice pod presvettljivo ali digitalno subtraksijsko angiografijo DSA.
10. Balon vedno polnite ob spremljanju stanja napolnjenosti pod presvettljivo. Balon polnite previdno, ob tem pa preverjajte njegovo premikanje s radionepruustnimi označevalcema. Če opazite kakršnoli nepravilnost, kot je majhen upor, nepremičen kateter med uvajanjem ali ukrivljena distalna konica vodilne žice, morate postopek takoj prekiniti in počasi odstraniti kateter skupaj z vodilno žico.
11. Katetra ne vstavljajte ali odstranjujte na hitro. (Hitro premikanje lahko poškoduje kateter ali notranjo plast žile.)
12. Katetra ne premikajte z napolnjenim balonom. Ob premikanju katetra z napolnjenim balonom lahko balon počli ali se pretrga cevka katetra.
13. Balona v žili ne polnite ali praznite hitro. Zaradi hitrega polnjenja ali praznjenja se lahko poškoduje žila ali počli balon in delci ostanejo v telesu.
14. Za polnjenje balona ne uporabljajte injektorja (priprave za samodejno injiciranje).
15. Bodite previdni, da preprečite poškodbe katetra s skalpelom ali škarjami.
16. Če med uvajanjem katetra zaznate kakršnoli nepravilnost, kot je močan upor, morate postopek takoj prekiniti. Nato morate preveriti vzrok in ustrezno ukrepati. (Če boste nadaljevali s postopkom s prekomerno silo, lahko pride do poškodbe katetra ali stene žile.)
17. Vedno pazite na stanje bolnika in nadzorujte telesno temperaturo, utrip ter dihanje. Če opazite kakršnoli nepravilnost, takoj prenehajte z uporabo katetra ali ukrepaite ustrezno po zdravniški presoji glede na stanje bolnika.
18. Po uporabi kateter odstranite kot medicinske odpadke v skladu z bolnišničnimi postopki.
19. Ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo organska topila, ali oljnatih kontrastnih sredstev. Stik s temi sredstvi lahko pripelje do poškodb katetra.
20. Katetra med uvajanjem ne smete ukrivljati ali obračati.
21. Med uvajanjem priprave v krvno žilo ali odstranjevanjem priprave iz krvne žile mora biti balon povsem izprazen. (Pripravo z večjim in daljšim balonom praznimo dlje časa.)
22. Če med izvlačenjem priprave po opravljenem postopku začitute upor, priporočamo odstranitev celotnega sistema skupaj z uvajalom/vodilom.
23. Vedno uporabite kateter poleg vodilne žice, vstavljene v svetlino vodilne žice.

[Navodila za postopek]

Materiali, ki jih običajno potrebujemo ob uporabi balonskega katetra za dilatacijo PTA Metacross OTW, so:

- Vodilna žica(e) ustreznega premera in dolžine
- Ustrezno uvajalo/vodilo in dilatator
- Fiola s kontrastnim sredstvom
- Fiola sterilne fiziološke raztopine
- Pripomoček za polnjenje z manometrom
- Brizgalka z zaklepnim priključkom Luer
- Tripotni petelinček

[Postopek ali navodila za uporabo]

1. Izbiira katetra

Pred uporabo pod presvettljivo preverite notranji premer žile proksimalno in distalno od stenotične lezije in izberite kateter z ustrezno velikostjo balona. Če sta za potrjen premer primerni dve velikosti, izberite manjšo.
2. Priprava
 - 1) Po aseptični odstranitvi katetra iz embalaže odstranite zaščitne materiale.
 - 2) Zrak v balonu in razširitevni svetlini balona nadomestite s tekočino za polnjenje v skladu z naslednjimi postopki.
 - a) Na odprtino za polnjenje balona pritrdite napravo za polnjenje (ni vključena v ta komplet), napolnjeno s tekočino za polnjenje.

- b) Po tem, ko približno 10 sekund ustvarjate negativni tlak v napravi za polnjenje, usmerite konico cevke katetra navzdol in počasi sprostite negativni tlak, da bo tekočina napolnila balon in razširitevno svetlino balona ter izločila zrak.
- c) Če je po tem, ko balon napolnite s tekočino za polnjenje, v njem in spojki prisoten zrak, ponavljajte postopek b), dokler povsem ne izločite zraka.
- d) Odstranite napravo za polnjenje z odprtine za polnjenje balona in izločite zrak iz valja naprave za polnjenje.
- e) Napravo za polnjenje ponovno pritrdite na odprtino za polnjenje balona in ohranjajte negativni tlak. Preverite, da zrak ne uhaja več nazaj v brizgalko.
- 3) Svetlino vodilne žice izperite s heparinizirano fiziološko raztopino za izpiranje in jo napolnite s heparinizirano fiziološko raztopino.
- 4) Celoten balonski kateter za dilatacijo PTA Metacross OTW potopite v fiziološko raztopino.
3. Vstavitvev in napolnitev balonskega katetra

Pred uporabo preverite, ali je kateter združljiv z vodilnim katetrom (ni vključen v ta komplet), vodilom (ni vključen v ta komplet) in vodilno žico (ni vključena v ta paket) glede na naslednjo razpredelnico.

Koda izdelka	Premer balona (mm)	Združljivo vodilo (Fr/mm)	Največji premer za vodilno žico (mm)
BD-L30020SW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (brez dolžine balona 200 mm), 7 mm (dolžina balona 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0,89 mm
BD-L70200CW	6 mm (samo dolžina balona 200 mm), 7 mm (brez dolžine balona 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm:	7 Fr / 2,33 mm	

Pri uporabi tega katetra, vstavljenega v vodilo ali vodilni kateter

- 1) Pri uporabi tega katetra v vodilnem katetru popustite hemostatični ventil, a naj ostane še vedno dovolj pritv, da preprečite iztekanje krvi.
- 2) Ta kateter s povsem izpraznjenim balonom postopno vstavljajte v vodilo ali vodilni kateter vzdolž vodilne žice, ki je potisnjena do distalnega obrobja lezije. Pod presvettljivo kateter počasi potiskajte, da se radionepruustni označevalec na balonu pomakne do ciljnega mesta.
- 3) Pod presvettljivo preverite položaj radionepruustnega označevalca na balonu in določite mesto dilatacije.
- 4) Na odprtino za polnjenje balona čvrsto pritrdite pripomoček za polnjenje.
- 5) Postopno napolnite balon do končnega premera in preverjajte tlak za polnitev ter razširitev stenotično lezijo (za premere napolnjenega balona si oglejte razpredelnico skladnosti za balone v 1. tabeli na koncu teh navodil za uporabo).
4. Odstranitev katetra
 - 1) Ko ustvarite negativen tlak, da povsem izpraznite balon, odstranite kateter.
5. Ponovna vstavitvev katetra
 - 1) Če je potrebna ponovna vstavitvev odstranjenega katetra z izpraznjenim balonom, se prepričajte, da je balon povsem izprazen in zložen, preden ga ponovno vstavite v krvno žilo pacienta. Pri ponovni vstavitvi uporabljajte kateter, kot je navedeno v delu »Vstavitvev in napolnitev balonskega katetra«.
 - 2) Če pri ponovnem vstavljanju katetra začitute oteženo pomikanje, ga nehalje pomikati naprej in ga previdno odstranite iz krvne žile pacienta. Za uporabo pripravite nov kateter Metacross OTW skladno s postopki, ki jih najdete zgoraj v tem delu navodil za uporabo.

[Zapleti]

Okvare priprave:

- Pretrganje balona
- Nezadostna polnitev/praznjenje balona
- Pretrganje balona/ali cevke katetra

- Težave pri odstranitvi priprave
- Iztekanje tekočine za polnjenje

Neželeni učinki:

- Lokalne ali sistemske okužbe
- Lokalna notranja krvavitev ali hematoma
- Poškodba intime
- Disekcija žile
- Predrtje žile
- Pretrganje žile
- Anevrizma
- Aritmija
- Akutna zamašitev obkoda
- Venska tromboembolija
- Vazospazem
- Nastanek psevdoanevrizme
- Arteriovenska fistula
- Krvavitev, zaradi katere je potrebna infuzija
- Alergična reakcija na kontrastni medij/ledvična odpoved
- Bolečina ali trgajoča bolečina
- Smrt
- Embolija
- Endokarditis
- Vročica
- Hipotenzija/Hipertenzija
- Vnetje
- Miokardni infarkt
- Sepsa
- Šok
- Kap
- Prehodni ishemični napad (tranzitorna ishemična ataka)

[Shranjevanje in rok uporabnosti]

1. Hranite v hladnem, suhem in temnem prostoru. Ne izpostavljajte vodi, neposredni sončni svetlobi.
2. Rok uporabnosti je naveden na škatli. Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.

[Paket]

1 pribor/škatla

[Ime in naslov proizvajalca ali zastopnika]



Proizvajalec: KANEKA CORPORATION

Naslov: 3-18, 2 Chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
 OSAKA, 530-8288 JAPAN
 Tel. št.: (+81)-(0) 6-6226-5256
 Št. faksa: (+81)-(0) 6-6226-5143



Zakonit pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Naslov: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
 Tel. št.: (+32)-(0) 14-256-297
 Št. faksa: (+32)-(0) 14-256-298

Distributer v EU: TERUMO EUROPE N.V.

Naslov: INTERLEUVENLAAN 40, 40,3001 LEUVEN, BELGIJA
 Tel. št.: (+32)-(0) 16 381 211
 Št. faksa: (+32)-(0) 16 400 249

Vsa imena blagovnih znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja TERUMO CORPORATION ali njihovih drugih lastnikov.

1. Tabela Metacross OTW balon Razpredelnica skladnosti


Tlak (atm)	Premer balona (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96*	6.98*	8.00*	8.98*	9.90*	11.98*
10	3.01*	3.98*	5.06*	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35**	10.42**	12.61**
14	3.14	4.13	5.27	6.39**	7.48**	8.58**	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50**						
20	3.36**	4.38**	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

* Nazivni tlak

** Naznačen delovni tlak

[OPIS PROIZVODA]

Metacross OTW je dilatacioni balon-kateter za perkutanu transluminalnu angioplastiku (PTA) kod perifernih indikacija. Metacross OTW je sistem vrste preko žice (OTW) a maksimalan prečnik kompatibilne vodič-žice je 0,89 mm (0,035 inča). Distalni deo ovog katetera sastoji se od balona i osovine (ko-aksijalne) dvostrukog lumena. Spoljni lumen koristi se za naduvavanje i izduvavanje balona kontrastnim sredstvom razređenim fiziološkim rastvorom. Unutrašnji lumen (lumen vodič-žice; od distalnog vrha do otvora za vodič-žicu) služi za umetanje kompatibilne vodič-žice radi lakšeg uvođenja katetera kroz stenotičnu leziju ili stent koji treba da se izduva. Proksimalni deo čini osovina sa dvostrukim lumenom sa dvostrukim luer priključkom, manifold; jedan za naduvavanje / izduvavanje balona, drugi za pristup lumen u vodič-žice. Dva radiopaktna markera postavljena su u balon, a oni ukazuju na radnu dužinu balona, i služe da vode lekara pri pravilnom pozicioniranju balona u ciljanu leziju pomoću fluoroskopije. Metacross OTW je dostupan u različitim veličinama balona po prečniku i dužini pri preporučenim pritisacima za naduvavanje (nominalni pritisak). Nakon naduvavanja, prečnik balona varira prema pritisku naduvavanja. Grafikon usklađenosti balona Metacross OTW dat je u tabeli 1 na kraju ovih uputstava za upotrebu. U paketu za sterilizaciju, medicinsko sredstvo je opremljeno zaštitnim materijalima, zaštitnom cevi balona i malom sondom, a sve treba ukloniti pre upotrebe. Zaštitna cev balona postavlja se preko balona savijenog u niskom profilu a mala sonda se postavlja u lumen vodič-žice kako bi sprečila lomljenje osovine katetera. Distalni vrh katetera sužen je kako bi olakšao napredovanje katetera u stenotičnu leziju ili stent.
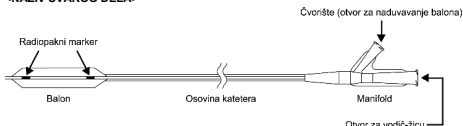
<NAZIV SVAKOG DELA>

Sterilan i nepirogen u neoštećenoj i neotvorenoj blister-kesici. Ovo medicinsko sredstvo je sterilisano etilen-oksikom.

Preporučeni prečnik vodič-žice:

Maksimalni prečnik: 0,035" (0,89 mm)

Preporučeni pritisak naduvavanja i maksimalni pritisak naduvavanja**Nominalni pritisak:**

- Prečnik balona: manji od 6 mm: 10 atm
- Prečnik balona: 6 mm i veći: 8 atm

Procenjeni pritisak pucanja:

- Prečnik balona: manji od 5 mm: 20 atm
- Prečnik balona: 5 mm: 18 atm
- Prečnik balona: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Prečnik balona: 9 mm i veći: 12 atm

[INDIKACIJE]

Metacross OTW dilatacioni balon-kateter za PTA namenjen je za dilataciju stenoza u ilijačnoj, femoralnoj, ilijačno-femoralnoj, poplitealnoj, infrapoplitealnoj i renalnim arterijama, kao i za terapiju opstruktivnih lezija nativne ili sintetičke arteriovenske dijalizne fistule. Ovo medicinsko sredstvo je indikovano i za post-dilataciju stenta u perifernoj vaskulaturi.

Napomena: Test verifikacije za post-dilataciju stenta medicinskog sredstva Metacross OTW obavljen je korišćenjem Complete® SE vaskularnog stent sistema (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® vaskularnog stent sistema (Korporacija Cordis) i Epic™ vaskularnog samoširećeg stent sistema (Bostonska naučna korporacija).

[KONTRAINDIKACIJE]

1. Pacijenti kod kojih se razvila anastomotična stenoza u periodu od jednog meseca nakon postavljanja AV šanta.
2. Kod pacijenata koji imaju lezije koje komuniciraju sa pseudoaneurizmom.
3. Trudnice.
4. Pacijenti koji ne podnose antiagregacionu ili antikoagulacionu terapiju.

[UPOZORENJA I MERE PREDOSTROŽNOSTI]**[Upozorenja]**

1. Ovaj uređaj je namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Ne upotrebljavati ponovo. Ne sterilisati. Ne obrađivati ponovo. Ponovna obrada može da ugrozi sterilnost, biološku kompatibilnost i fizički integritet medicinskog sredstva.
2. Nemojte koristiti ako su proizvod ili pojedinačno pakovanje oštećeni.
3. Nemojte naduvavati balon tako da premaši prečnik krvnog suda proksimalno i distalno od stenotične lezije.
4. Nemojte naduvavati balon na pritisak koji premašuje procenjeni pritisak pucanja.
5. Nemojte koristiti ovaj kateter u sistemu centralne cirkulacije.

[Mere opreza koje se odnose na postupke]

1. Pažljivo i polako izvadite medicinsko sredstvo iz cevi nosača i uklonite zaštitne delove sa medicinskog sredstva. Nepažljivo rukovanje može da uzrokuje oštećenje balona i/ili osovine katetera medicinskog sredstva, čime se narušava sposobnost naduvavanja i/ili izduvavanja balona.
2. Balon naduvavajte kontrastnim sredstvom razređenim fiziološkim rastvorom u odnosu 1:1 (u daljem tekstu „tečnost za naduvavanje“). Za naduvavanje se ne sme koristiti nikakvo gasovito sredstvo, kao što je vazduh. (Balon se može nepravilno naduvati.)
3. Pre upotrebe, izbacite sav vazduh iz balona i lumena za naduvavanje balona i zamenite ga tečnošću za naduvavanje. (U slučaju nepotpunog izbacivanja vazduha, stanje naduvanosti balona se ne može pratiti pomoću fluoroskopije.)
4. U slučaju ozbiljnih stenotičnih lezija, kao što su kalcifikovane lezije, krvni sud se ne može u potpunosti dilatirati. U tom slučaju nemojte primenjivati pritisak koji premašuje procenjeni pritisak pucanja. (Balon može puci, a njegovi ostaci mogu ostati u telu pacijenta.)
5. Što se tiče medicinskih sredstava koja se koriste zajedno sa ovim kateterom, sledite uputstva za upotrebu tih medicinskih sredstava. (Kada se balon-kateter koristi za post-dilataciju stenta prilikom postupka postavljanja perifernog stenta, konsultujte uputstvo za upotrebu koje je priložio proizvođač.)
6. Pri umetanju u stent, vadenju iz stenta ili dilataciji balona unutar stenta, postupajte pažljivo uz praćenje fluoroskopijom. (Postupanje bez praćenja fluoroskopijom može dovesti do oštećenja katetera ili do povrede krvnog suda.)
7. Nemojte pokušavati da provučete Metacross OTW dilatacioni balon-kateter za PTA kroz uvodnik manje veličine nego što je ona naznačena na oznaci. Pogledajte oznaku na proizvodu.

[Mere predostrožnosti tokom upotrebe]

1. Medicinski uređaj upotrebite odmah po otvaranju sterilnog pakovanja.
2. Celokupna procedura se mora izvoditi u sterilnim uslovima.
3. Ovaj kateter smeju da koriste samo lekari koji su obučeni za perkutanu vaskularnu terapiju.
4. Izaberite kateter sa balonom odgovarajuće veličine (prečnikom i dužinom balona) u skladu sa sledećim (proceduralnim) kriterijumima ().
 - 1) Prečnik naduvanog balona ne sme da premaši unutrašnji prečnik krvnog suda proksimalno i distalno u odnosu na leziju.
 - 2) Dužina naduvanog balona ne sme da premaši dužinu lezije koja se tretira. (Izbor neodgovarajućeg katetera može da dovede do akutne okluzije krvnog suda.)

- Koristite ovaj kateter samo ako postoje uslovi za izvođenje hitne hirurške intervencije u svakom trenutku.
- Lekar koji je zadužen za obavljanje postupka mora da odredi trajanje i broj naduvavanja balona na osnovu svojih prethodnih iskustava.
- Heparinizovan fiziološki rastvor mora da se ubrizga da bi se sprečilo zgrušavanje dok se ovaj balon-kateter uvodi u krvni sud.
- Nikada nemojte naduvavati balon ili uvoditi vodič-žicu ako je kateter savijen ili iskrivljen.
- Pažljivo manipulišite kateterom unutar krvnog suda proveravajući položaj i pomeranje njegovog vrha pomoću fluoroskopije ili DSA (digitalna suprakciona angiografija).
- Balon uvek naduvavajte prateći stanje njegove naduvanosti pomoću fluoroskopije. Pažljivo naduvavajte balon proveravajući njegovo pomeranje pomoću radiopaktnih markera. Ako dođe do bilo kakve abnormalnosti, kao što je blag otpor, nepokretljivost katetera za vreme manipulisanja ili savijenost distalnog vrha vodič-žice, postupak se mora odmah prekinuti, a ovaj kateter polako izvući zajedno sa vodič-žicom.
- Nemojte brzo umetati ili vaditi ovaj kateter. (Brzo rukovanje može da dovede do oštećenja ovog katetera ili do povrede intime krvnog suda.)
- Nemojte pomerati kateter dok god je balon naduvan. (Pomeranje katetera sa naduvanim balonom može da dovede do pucanja balona ili do preloma osovine katetera.)
- Nemojte brzo naduvavati ili izduvavati balon unutar krvnog suda. (Brzo naduvavanje ili izduvavanje balona može da dovede do oštećenja krvnog suda ili do pucanja balona i zaostajanja ostataka balona u telu pacijenta.)
- Nemojte koristiti injektor (sredstvo za automatsko ubrizgavanje) za naduvavanje balona.
- Moraju se preduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečilo bilo kakvo oštećenje katetera hirurškim nožem ili makazama.
- Ako dođe do bilo kakve abnormalnosti prilikom manipulisanja kateterom, kao što je snažan otpor, postupak se mora odmah prekinuti. Mora se utvrditi uzrok i moraju se preduzeti odgovarajuće mere. (Nastavak rada uz primenu sile može da dovede do oštećenja katetera ili zida krvnog suda.)
- Uvek obraćajte pažnju na stanje pacijenta i pratite njegove vitalne parametre kao što su telesna temperatura, puls i disanje. Ukoliko dođe do bilo kakve abnormalnosti, odmah prekinite sa upotrebom ovog katetera ili preduzmite mere prilagođene stanju pacijenta prema odluci lekara.
- Nakon upotrebe bacite kateter u medicinski otpad u skladu sa bolničkim procedurama.
- Ne koristite sredstva koja sadrže organske rastvarače ili uljana kontrastna sredstva. Kontakt sa ovim sredstvima može da dovede do oštećenja katetera.
- Prilikom manipulisanja ovim kateterom nemojte ga uvijati niti okretati.
- Prilikom umetanja ovog medicinskog sredstva u krvni sud ili vađenja ovog medicinskog sredstva iz krvnog suda, uverite se da je balon potpuno izduvan. (Medicinsko sredstvo sa većim i dužim balonom zahteva duže vreme izduvavanja.)
- Ako se oseti otpor prilikom vađenja ovog medicinskog sredstva nakon obavljenog postupka, preporučuje se da se čitav sistem izvadi zajedno sa uvodnikom.
- Uvek koristite kateter uz vodič-žicu koja je umetnuta u lumen za vodič-žicu.

[Uputstva za rad]

Materijali koji su obično potrebni pri korišćenju Metacross OTW dilatacionog balon-katetera za PTA pri PTA postupcima obuhvataju:

- Vodič-žicu/e odgovarajućeg prečnika i dužine
- Odgovarajući uvodnik i komplet za dilataciju
- Bočicu kontrastnog sredstva
- Bočicu fiziološkog rastvora
- Sredstvo za naduvavanje sa manometrom
- Špic sa luer-blokadom
- Trokraku slavinu

[Metod rada ili uputstvo za upotrebu]

- Izbor katetera
Pre upotrebe proverite unutrašnji prečnik krvnog suda proksimalno i distalno od stenotične lezije pomoću fluoroskopije i izaberite kateter sa balonom odgovarajuće veličine. Ako odgovaraju dve veličine balona, odaberite manju veličinu.
- Priprema
 - Nakon aseptičnog vađenja katetera iz pakovanja, uklonite zaštitne materijale sa katetera.
 - Zamenite vazduh iz balona i iz lumena za naduvavanje balona tečnošću za naduvavanje primenom sledećih postupaka.
 - Priključite medicinsko sredstvo za naduvavanje (nije uključeno u ovaj komplet) napunjeno tečnošću za naduvavanje na priključak za naduvavanje balona.
 - Nakon primene negativnog pritiska na trajanju od oko 10 sekundi na medicinsko sredstvo za naduvavanje, usmerite vrh osovine katetera nadole i polako otpustite negativan pritisak kako biste dozvolili da tečnost napuni balon i lumen za naduvavanje balona i tako izbaci vazduh.
 - Ako u balonu i u lumen za naduvavanje balona zaostane vazduh, ponovite proceduru b) sve dok se vazduh u potpunosti ne izbaci.
 - Odvojte medicinsko sredstvo za naduvavanje od priključka za naduvavanje balona i uklonite vazduh iz cilindra medicinskog sredstva za naduvavanje.
 - Ponovo priključite medicinski uređaj za naduvavanje na priključak za naduvavanje balona i održavajte negativan pritisak. Uverite se da se vazduh više ne vraća u špic.
 - Ispirite lumen za vodič-žicu heparinizovanim fiziološkim rastvorom i napunite lumen heparinizovanim fiziološkim rastvorom.
 - Potopite kompletan Metacross OTW dilatacioni balon-kateter za PTA u fiziološki rastvor.
- Umetanje i naduvavanje balon-katetera
Pre upotrebe proverite da li je ovaj kateter kompatibilan sa vodič-kateterom (nije uključen u ovaj komplet), uvodnikom (nije uključen u ovaj komplet) i vodič-žicom (nije uključena u ovaj komplet) pomoću tablice u nastavku.

Kataloški broj	Prečnik balona (mm)	Kompatibilan uvodnik (Fr/mm)	Maksimalni prečnik vodič-žice (inča/mm)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (isključujući dužinu balona od 200 mm), 7 mm (dužina balona od 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0,89 mm (0,035 inča)
	6 mm (samo dužina balona od 200 mm), 7 mm (isključujući dužinu balona od 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm:	7 Fr / 2,33 mm	

U slučaju upotrebe ovog katetera umetnutog u uvodnik ili vodič-kateter

- Kada se koristi ovaj kateter umetnut u vodič-kateter, olabavite hemostatsku valvulu istovremeno pazeći da bude dovoljno pritegnut da bi se sprečilo curenje krvi.
- Postupno uvodite kateter, uz potpuno izduvan balon, u uvodnik ili vodič-kateter preko vodič-žice i uvedite ga do distalne periferije lezije. Pomoću fluoroskopije polako uvodite kateter tako da radiopaktni marker na balonu dosegne ciljno mesto.
- Pomoću fluoroskopije proverite položaj radiopaktnog markera na balonu i utvrdite mesto dilatacije.
- Čvrsto pričvrstite medicinsko sredstvo za naduvavanje na priključak za naduvavanje balona.
- Postupno naduvajte balon do ciljnog prečnika proveravajući pritisak naduvavanja i dilatirajte stenotičnu leziju (za prečnike naduvanih balona, pogledajte grafikon usklađenosti balona dat u tabeli 1, na kraju ovog uputstva za upotrebu).

4. Uklanjanje katetera

- 1) Nakon primene negativnog pritiska radi potpunog izduvavanja balona, izvadite kateter iz tela pacijenta.
- #### 5. Ponovno uvođenje katetera
- 1) Ako je potrebno ponovno uvođenje izvađenog katetera sa izduvanim balonom, uverite se da je balon u potpunosti izduvan i sklopljen pre ponovnog uvođenja u krvni sud pacijenta. Prilikom ponovnog uvođenja koristite kateter po ovde datom odeljku „Uvođenje i naduvavanje balon katetera“.
 - 2) Ako se oseti otpor prilikom ponovnog uvođenja katetera, prestanite sa uvođenjem i pažljivo ga izvucite iz krvnog suda pacijenta. Pripremite za korišćenje novi Metacross OTW u skladu sa gore datim postupcima u ovom odeljku uputstva za upotrebu.



Ovlašteni predstavnik u Evropskoj uniji:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresa: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Br. tel.: (+32)-(0) 14-256-297

Br. faksa: (+32)-(0) 14-256-298

Distributer za EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresa: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgija

Br. tel.: (+32)-(0) 16 381 211

Br. faksa: (+32)-(0) 16 400 249

Svi nazivi robnih marki su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi korporacije TERUMO CORPORATION i njihovih odnosnih vlasnika.

[Komplikacije]

Nedostaci medicinskog sredstva:

- Pucanje balona
- Nedovoljno naduvavanje/izduvavanje balona
- Pucanje balona i/ili prelom osovine katetera
- Teškoće pri vađenju medicinskog sredstva
- Curenje tečnosti za naduvavanje

Neželjeni događaji:

- Lokalne ili sistemske infekcije
- Lokalno unutrašnje krvarenje ili hematoma
- Pucanje intime
- Disekcija krvnog suda
- Perforacija krvnog suda
- Pucanje krvnog suda
- Aneurizma
- Aritmija
- Akutna okluzija krvnog suda
- Venska tromboembolija
- Vazospazam
- Formiranje pseudoaneurizme
- Arteriovenska fistula
- Krvarenje koje zahteva transfuziju
- Alergijski odgovor na kontrastno sredstvo/otkaz bubrega
- Dugotrajna ili pritiskajuća bol
- Smrt
- Embolija
- Endokarditis
- Groznica
- Visok/nizak krvni pritisak
- Upala
- Infarkt miokarda
- Sepsa
- Šok
- Moždani udar
- Prolazni ishemični napad

[Skladištenje i datum isteka roka trajanja]

1. Čuvati na hladnom, suvom i tamnom mestu. Izbegavati izlaganje vodi i direktnom sunčevom svetlu.
2. Datum isteka roka trajanja naznačen je na kutiji. Nemojte koristiti po isteku roka trajanja.

[Pakovanje]

1 komplet/kutija

[Naziv i adresa proizvođača ili zastupnika]



Proizvođač: KANEKA CORPORATION

Adresa: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city

OSAKA, 530-8288 JAPAN

Br. tel.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Br. faksa: (+81)-(0) 6-6226-5143

PM-05579

98/115 (3210-2)

Tabela 1. Metacross OTW Grafikon usklađenosti balona

Pritisak (atm)	Prečnik balona (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00"	8.98"	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06"	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										


* Nominalni pritisak

** Procenjeni pritisak pucanja

[DESCRIEREA PRODUSULUI]

Metacross OTW este un cateter de dilatare pe balon, pentru angioplastia transluminală percutanată (PTA) pentru indicații periferice. Metacross OTW este de tipul „pe fir” (OTW - over the wire) și diametrul maxim al firului de ghidaj compatibil este de 0.035 inci (0,89 mm). Secțiunea distală a cateterului constă dintr-un balon și tija cu lumen dual (co-axiale). Lumenul exterior este utilizat pentru umflarea și dezumflarea balonului cu substanță de contrast diluată cu soluție salină. Lumenul interior (lumenul pentru firul de ghidaj, de la vârful distal până la portul firului de ghidaj) este pentru introducerea unui fir de ghidaj compatibil pentru a facilita avansarea cateterului prin leziunea stenotică sau stentul care trebuie dilatat. Secțiunea proximală este o tijă cu lumen dublu, prevăzută cu racord cu două porturi luer - unul pentru umflarea/dezumflarea balonului și celălalt pentru acces în lumenul pentru firul de ghidaj. În interiorul balonului, două marce radioopace, care indică lungimea de lucru a balonului, sunt plasate pentru a facilita poziționarea corespunzătoare, de către medic, a balonului în leziunea țintă, sub control fluoroscopic. Metacross OTW este disponibil în diverse mărimi ale balonului, în diametru și în lungime, la presiunile de umflare recomandate (presiune nominală). La umflare, diametrul balonului variază în funcție de presiunea de umflare. Diagrama de complianță a balonului pentru Metacross OTW este furnizată în Tabelul 1 de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare. În ambalajul de sterilizare, dispozitivul este echipat cu materiale de protecție, un tub de protecție a balonului și un stilet, care vor fi scoase înainte de utilizare. Tubul de protecție a balonului este plasat pe balon, printr-o împăturire strânsă, iar stiletul este introdus în lumenul pentru firul de ghidaj pentru a preveni colabarea țigii cateterului. Vârful distal al cateterului este conic pentru a facilita avansarea cateterului în leziunea stenotică sau în stent.

<DENUMIREA PĂRȚILOR COMPONENTE>

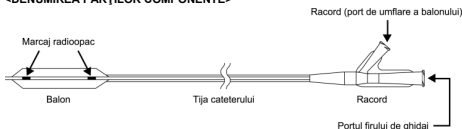

Steril și apirogen dacă punga nu este deschisă sau deteriorată. Acest dispozitiv este sterilizat cu oxid de etilenă.

Diametrul recomandat al firului de ghidaj:

Diametru maxim: 0.035" (0,89 mm)

Presiunea de umflare recomandată și presiunea maximă de umflare

Presiunea nominală:

- Diametrul balonului: mai mic de 6 mm: 10 atm
- Diametrul balonului: 6 mm sau mai mare: 8 atm

Presiunea nominală de explozie:

- Diametrul balonului: mai mic de 5 mm: 20 atm
- Diametrul balonului: 5 mm: 18 atm
- Diametrul balonului: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Diametrul balonului: 9 mm sau mai mare: 12 atm

[INDICAȚII]

Cateterul de dilatare pe balon pentru PTA Metacross OTW este destinat dilatării stenozei în arterele iliacă, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra-poplitee și renală, precum și pentru tratamentul leziunilor obstruative pe fistulele arteriovenoase de dializă, native sau artificiale. De asemenea, acest dispozitiv este indicat pentru post-dilatarea stentului în vasculatura periferică.

Notă: Testul de verificare a Metacross OTW pentru post-dilatarea stentului a fost efectuat utilizând sistemul de stent vascular Complete® SE (Medtronic, Inc), sistemul de stent vascular S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) și sistemul de stent vascular auto-expandabil Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[CONTRAINDICAȚII]

1. Pacienții care au dezvoltat stenoza anastomozelor în termen de o lună după crearea șuntului arteriovenos.
2. Pacienții care au leziuni care comunică cu un pseudoanevrism.
3. Paciențele însărcinate.
4. Pacienții care nu pot tolera tratamentul antiplachetar sau anticoagulant.

[AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE]

[Avertismente]

1. Acest dispozitiv este de unică folosință. Nu refoșosiți. Nu resterilizați. Nu reprocesați. Reprocesarea poate compromite caracterul steril, biocompatibilitatea și integritatea fizică a dispozitivului.
2. A nu se utiliza dacă produsul sau ambalajul a fost deteriorat.
3. Nu umflați balonul depășind diametrul vasului sanguin, în punctele proximal și distal față de leziunea stenotică.
4. Nu umflați balonul la o presiune mai mare decât presiunea nominală de explozie
5. Nu utilizați acest cateter în sistemul circulator central.

[Măsurile de precauție privind procedurile]

1. Scoateți încet și cu atenție dispozitivul din tubul de portaj și înlocuiți părțile de protecție ale dispozitivului. Prin manipulare neatență se poate produce deteriorarea balonului și/sau a țigii cateterului, afectând totodată procesul de umflare și/sau dezumflare a balonului.
2. Umflați balonul cu substanță de contrast diluată cu soluție salină în proporția 1:1 (amestec denumit mai jos „lichid de umflare”). Pentru umflare nu trebuie utilizat un mediu gazos, de exemplu aer. (Balonul se poate umfla în mod neregulat.)
3. Înainte de utilizare, eliminați tot aerul din balon și din lumenul de umflare a balonului și înlocuiți-l cu lichidul de umflare. (În cazul în care aerul nu este eliminat complet, starea de umflare a balonului nu poate fi observată la fluoroscopie)
4. În cazul unei leziuni stenotice severe cum sunt leziunile calcificate, vasul de sânge nu va putea fi dilatat în întregime. În asemenea caz, nu aplicați o presiune care să depășească valoarea nominală a presiunii de explozie. (Balonul ar putea exploda și detritusurile ar putea rămâne în corpul pacientului.)
5. Pentru dispozitivele medicale utilizate împreună cu acest cateter, respectați instrucțiunile de utilizare a dispozitivelor respective. (Atunci când cateterul cu balon este utilizat pentru post-dilatarea stentului în cadrul procedurii de amplasare a stentului periferic, consultați instrucțiunile de utilizare emise de fabricant.)
6. Pentru introducerea în stent, retragerea din stent sau dilatarea balonului în interiorul stentului, procedați cu atenție, sub control fluoroscopic. (Lucrând fără control fluoroscopic puteți deteriora cateterul sau puteți leza vasul sanguin).
7. Nu încercați să treceți cateterul de dilatare pe balon pentru PTA Metacross OTW printr-o teacă de introducere având mărimea mai mică decât cea indicată pe etichetă. Consultați eticheta produsului.

[Măsurile de precauție în timpul utilizării]

1. Utilizați dispozitivul imediat după deschiderea ambalajului steril.
2. Întreaga procedură trebuie efectuată în condiții aseptice.
3. A se utiliza acest cateter numai de medicii instruiți în terapia vasculară percutanată.
4. Selectați cateterul cu dimensiunea corespunzătoare a balonului (diametrul balonului, lungimea balonului) conform următoarelor criterii (proceduri).
 - 1) Diametrul balonului umflat nu trebuie să fie mai mare decât diametrul interior al vasului de sânge, în punctele proximal și distal față de leziune.
 - 2) Lungimea balonului umflat nu trebuie să depășească lungimea leziunii care urmează să fie tratată. (O selectare inadecvată a cateterului poate conduce la ocluzie vasculară acută.)

5. Utilizați acest cateter numai în cazul în care intervenția chirurgicală în regim de urgență poate fi efectuată în orice moment.
6. Medicul care trebuie să efectueze procedura trebuie să stabilească durata și numărul de umflări ale balonului, pe baza experienței sale anterioare.
7. Trebuie să fie perfuzată soluție salină heparinizată pentru anticoagulare în timpul introducerii cateterului cu balon în vasul de sânge.
8. Nu umflați niciodată balonul sau nu avansați firul de ghidaj în cazul în care cateterul este îndoit sau răsucit.
9. Manevrați cu atenție cateterul în vasul sanguin, verificând locația și mișcarea vârfului său cu ajutorul fluoroscopiei sau monitorizării DSA (angiografie cu substracție digitală).
10. Umflați întotdeauna balonul, verificând starea de umflare cu ajutorul fluoroscopiei. Umflați cu atenție balonul, verificând mișcarea acestuia cu ajutorul marcărilor radio-opace. Dacă se descoperă o anomalie, de exemplu faptul că există o rezistență ușoară, cateterul este fix în timpul manevrării sau vârful distal al firului de ghidaj este răsucit, trebuie să întrerupeți imediat procedura iar cateterul trebuie să fie îndepărtat încet, împreună cu firul de ghidaj.
11. Nu introduceți și nu îndepărtați rapid acest cateter. (Dacă acționați rapid, puteți deteriora cateterul sau puteți leza intima vasculară).
12. Nu mișcați cateterul atunci când balonul este umflat. (Mișcarea cateterului cu balonul umflat poate duce la explozia balonului sau la ruperea țije cateterului.)
13. Nu umflați și nu dezumflați balonul rapid în vasul de sânge. (Umflarea sau dezumflarea rapidă poate provoca lezarea vasului de sânge sau explozia balonului, resturile rămânând în corpul pacientului).
14. Nu utilizați un injectomat (dispozitiv de injectare automată) pentru umflarea balonului.
15. Trebuie luate măsuri de precauție pentru a preveni orice deteriorare a cateterului de către bisturiu sau foarfecii chirurgicale.
16. Dacă, la manevrarea cateterului, apare orice anomalie, de exemplu o rezistență puternică, procedura trebuie întreruptă imediat. Cauza trebuie investigată și trebuie luate măsuri adecvate. (Operarea în continuare, cu forță excesivă, poate conduce la deteriorarea cateterului sau la lezarea peretelui vascular.)
17. Întotdeauna, acordați atenție stării pacientului și monitorizați temperatura corporală, pulsul și respirația. În momentul identificării anomaliei, întrerupeți imediat utilizarea cateterului sau luați măsurile adecvate pentru starea pacientului, acestea fiind la latitudinea medicului.
18. După utilizare, eliminați cateterul ca deșeu medical, conform procedurilor spitalului.
19. Nu folosiți agenți care conțin solvenți organici sau substanțe de contrast uleioase. Contactul cu acești agenți poate conduce la deteriorarea cateterului.
20. La manevrarea cateterului, nu răsuciți și nu rotiți cateterul.
21. La introducerea acestui dispozitiv în vasul de sânge sau la scoaterea acestui dispozitiv din vasul de sânge, aveți grijă ca balonul să fie complet dezumflat. (Un dispozitiv prevăzut cu balon mai mare și mai lung necesită un timp de dezumflare mai lung.)
22. Dacă se întâmplă o rezistență în cursul retragerii post-procedurale a acestui dispozitiv, se recomandă retragerea întregului sistem, împreună cu teaca de introducere/de ghidaj.
23. Utilizați întotdeauna cateterul împreună cu un fir de ghidaj introdus prin lumenul pentru firul de ghidaj.

[Instrucțiuni de operare]

Materialele care sunt, de obicei, necesare pentru efectuarea PTA cu ajutorul cateterului de dilatare pe balon pentru PTA Metacross OTW includ:

- Fir(e) de ghidaj cu diametru și lungime adecvate
- Teacă de introducere/ghidaj și set de dilatare adecvate
- Flacon cu substanță de contrast
- Flacon cu soluție salină sterilă
- Dispozitiv de umflare cu manometru
- Seringă luer-lock

- Robinet cu trei căi

[Metoda de operare sau instrucțiuni de utilizare]

1. Selectarea cateterului
Înainte de utilizare, verificați diametrul interior al vasului de sânge în punctele proximal și distal față de leziunea stenotică cu ajutorul fluoroscopiei și selecția cateterului cu dimensiunea corespunzătoare a balonului. Dacă pentru diametrul verificat se pot utiliza două dimensiuni, selecția dimensiunii mai mici.
2. Pregătirea
 - 1) După ce îndepărtați aseptice cateterul din ambalaj, detașați materialele de protecție de la cateter.
 - 2) Încoluiți aerul din balon și din lumenul de umflare a balonului cu lichid de umflare, conform următoarelor proceduri.
 - a) Atașați dispozitivul de umflare (nu este inclus în acest set) umplut cu lichidul de umflare la portul de umflare al balonului.
 - b) După ce aplicați o presiune negativă timp de aproximativ 10 secunde asupra dispozitivului de umflare, direcționați în jos vârful țije cateterului și eliberați încet presiunea negativă pentru a permite lichidului să umple balonul și lumenul de umflare a balonului și pentru a elimina aerul.
 - c) Dacă încă se mai află aer în balon și în lumenul de umflare a balonului, repetați procedura b) până când aerul este eliminat complet.
 - d) Detașați dispozitivul de umflare de la portul de umflare a balonului și scoateți aerul din tubul dispozitivului de umflare.
 - e) Reașați dispozitivul de umflare la portul de umflare a balonului și mențineți presiunea negativă. Verificați ca aerul să nu se mai întoarcă în seringă.
 - 3) Spălați lumenul firului de ghidaj cu soluție salină heparinizată și umpleți lumenul cu soluție salină heparinizată.
 - 4) Scufundați întregul cateter de dilatare pe balon pentru PTA Metacross OTW în soluție salină.
3. Introducerea și umflarea balonului cateterului
Înainte de utilizare, verificați compatibilitatea cateterului cu cateterul de ghidaj (nu este inclus în acest set), teaca de introducere (nu este inclusă în acest set) și firul de ghidaj (nu este inclus în acest set) folosind tabelul de mai jos.

Codul produsului	Diametru balon (mm)	Teacă compatibilă (Fr/mm)	Diametru maxim al firului de ghidaj (inch/mm)
BD-L30020SW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (cu excepția lungimii de 200 mm a balonului), 7 mm (lungimea balonului 20 mm, 40 mm)	5 Fr / 1,66 mm	0.035 inch ± 0.89 mm
~	6 mm (numai lungimea de 200 mm a balonului), 7 mm (cu excepția lungimii de 20 mm, 40 mm a balonului), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
BD-L70200CW	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Când utilizați acest cateter introdus în teaca de introducere sau cateterul de ghidaj

- 1) Când utilizați acest cateter în cateterul de ghidaj, slăbiți valva hemostatică, păstrând-o în același timp suficient de strânsă, astfel încât să prevină scurgerile de sânge.
- 2) Introduceți treptat cateterul, cu balonul complet dezumflat, în teaca de introducere sau cateterul de ghidaj, peste firul de ghidaj, și avansați către periferia distală a leziunii. Sub control fluoroscopic, avansați încet cateterul până când marcajul radioopac al balonului acestuia ajunge la locul țintă.
- 3) Sub control fluoroscopic, verificați poziția marcajului radioopac al balonului și determinați locul unde va avea loc dilatarea.
- 4) Atașați în mod ferm dispozitivul de umflare la racordul de umflare a balonului.
- 5) Umflați treptat balonul până la diametrul țintă, verificând presiunea de umflare și dilatați leziunea stenotică (pentru diametrele balonului în stare umflată, consultați diagrama de complianță a balonului furnizată în Tabelul 1 de la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare).

4. Îndepărtarea cateterului

- 1) După ce aplicați o presiune negativă pentru a dezumfla complet balonul, îndepărtați cateterul.

5. Re-introducerea cateterului

- 1) Dacă este necesară re-introducerea cateterului scos cu balonul dezumflat, asigurați-vă că balonul este complet dezumflat și împăturit înainte de a-l re-introduce în vasul de sânge al pacientului. Pentru re-introducere utilizați cateterul conform instrucțiunilor de la secțiunea „Introducerea și umflarea balonului cateterului” din acest document.
- 2) Dacă întâmpinați vreo rezistență în timpul re-introducerii cateterului, opriți avansarea acestuia și scoteți-l cu grijă din vasul de sânge al pacientului. Pregătiți pentru utilizare un nou dispozitiv Metacross OTW în conformitate cu procedurile descrise mai sus, în această secțiune a acestor instrucțiuni de utilizare.

[Complicații]

Defecțiuni ale dispozitivului:

- Ruperea balonului
- Umflarea/dezumflarea insuficientă a balonului
- Ruperea balonului și/sau a teiei cateterului
- Dificultate la îndepărtarea dispozitivului
- Scurgerea lichidului de umflare

Evenimente adverse:

- Infecție locală sau sistemică
- Hemoragie internă locală sau hematom
- Ruptură de inimă
- Disecție vasculară
- Perforație vasculară
- Ruptură vasculară
- Anevrism
- Aritmie
- Ocluzie vasculară acută
- Tromboembolism venos
- Spasm vascular
- Formarea unui pseudoanevrism
- Fistulă arteriovenoasă
- Hemoragie care necesită transfuzie
- Reacție alergică la substanța de contrast/insuficiență renală
- Disconfort sau durere la apăsare
- Deces
- Embolism
- Endocardită
- Febră
- Hipertensiune / Hipotensiune
- Inflamație
- Infarct miocardic
- Sepsis
- Șoc
- Accident vascular cerebral
- Atac ischemic tranzitoriu

[Depozitare și data expirării]

1. A se păstra într-un loc răcoros, uscat și întunecos. A se evita expunerea la apă și la lumina solară directă.
2. Data de expirare este indicată pe cutie. A nu se utiliza după data de expirare.

[Ambalaj]

1 set/cutie

[Numele și adresa producătorului sau reprezentantului]



Producător: KANEKA CORPORATION

Adresă: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN

Nr. tel.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Nr. fax: (+81)-(0) 6-6226-5143



Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresă: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Nr. tel.: (+32)-(0) 14-256-297

Nr. fax: (+32)-(0) 14-256-298

Distribuitor pentru UE: TERUMO EUROPE N.V.

Adresă: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgia

Nr. tel.: (+32)-(0) 16 381 211

Nr. fax: (+32)-(0) 16 400 249

Toate numele de firme și denumirile sunt mărci de firmă și mărci înregistrate ale TERUMO CORPORATION și ale firmelor respective.

Tabelul 1. Metacross OTW Diagrama de complianță a balonului

Presiune (atm)	Diametru balon (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00"	8.98"	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06"	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										

* Presiunea nominală

** Presiunea nominală de explozie

[ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА]

Metacross OTW е перкутанен транслуминален (РТА) дилатационен балон-катетър за ангиопластика за периферни приложения. Metacross OTW е от тип „над жицата“ (OTW) и максималният диаметър на съвместимия водач е 0.035 инча (0,89 мм). Дилаталната секция на този катетър се състои от балон и тела с двойни канали (коаксиални). Външният канал се използва за надуване и изпускане на балона с рентгеноконтрастен агент, разтворен във физиологичен разтвор. Вътрешният канал (каналът на водача; от дисталния край до порта на водача) служи за прекарване на съвместим водач, който да улесни придвижването на катетъра през стенотичната лезия или стента, който трябва да бъде разширен. Проксималната секция е shaft с двоен лумен и тръбопровод с два луер-порта; един за надуване/прибиране на балона, другият – за достъп до лумена на водача. Вътре в балона са поставени два рентгеновонепроницаеми маркера, които показват работната дължина на балона и са предназначени да насочват лекаря за правилно позициониране на балона в целевата лезия под флуороскопия. Metacross OTW се предлага с различни размери на балона по отношение на диаметъра и дължината при препоръчителните налягания на надуване. След надуването диаметърът на балона варира в зависимост от налягането на надуване. Диаграмата за съответствие на балоните за Metacross OTW е представена в таблица 1 в края на тези указания за употреба. В стерилизационния пакет изделието е оборудвано с предпазни материали, предпазна тръба за балона и стилет, които трябва да бъдат отстранени преди употреба. Предпазната тръба за балона е поставена над сгънатия балон като нисък профил, а стилетът е поставен в канала на водача, за да се предотврати сгъването на тялото на катетъра. Дисталният край на катетъра е заострен, за да се улесни придвижването на катетъра в стенотичната лезия или стента.

<НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ>



Стерилна и непиrogenна неповредена и неотворена блистер - опаковка. Водачът е стерилизиран с етиленов оксид.

Препоръчителен диаметър на водача:

Максимален диаметър: 0,035 инча (0,89 мм)

Препоръчително налягане при надуване и максимално налягане при надуване

Номинално налягане:

Диаметър на балона: по-малък от 6 мм:	10 атм
- Диаметър на балона: 6 мм и по-голям:	8 атм

Номинално налягане на спукване:

- Диаметър на балона: по-малък от 5 мм:	20 атм
- Диаметър на балона: 5 мм:	18 атм
- Диаметър на балона: 6 мм, 7 мм, 8 мм:	14 атм
- Диаметър на балона: 9 мм и по-голям:	12 атм

[ПОКАЗАНИЯ]

Дилатационният балон катетър Metacross OTW РТА е предназначен за дилатирание на стенози в илячните, феморални, илю-феморални, подплатеални, инфра-подплатеални и ренални артерии, и за лечение на обструктивни лезии на нативни или синтетични артерио-венозни диализни фистули. Това изделие е предназначено също и за последваща дилатация след поставяне на стента в периферната васкулатура.

Бележка: Проверочното изпитване за пост-дилатация на стента за Metacross OTW беше извършено посредством система за васкуларни стентове Complete® SE (Medtronic, Inc), системата за васкуларни стентове S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) и система за саморазпъващи се васкуларни стентове Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ]

1. Пациенти, които са развили анатомична стеноза един месец след имплантиране на артерио-венозен байпас.
2. Пациенти които имат лезии, свързани с псевдоаневризма.
3. Пациенти които са бременни.
4. Пациенти които не толерират антиплателетна терапия или антикоагулантна терапия.

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ]

[Предупреждения]

1. Това изделие е само за еднократна употреба. Да не се ползва повторно. Да не се стерилизира повторно. Да не се подлага на повторна обработка. Да не се подлага на повторна обработка, тъй като тя може да влоши стерилността, биосъвместимостта и физична цялост на устройството.
2. Не използвайте, ако продуктът или опаковката са повредени.
3. Не надувайте балона над диаметъра на кръвоносния съд проксимално или дистално на стенотичната лезия.
4. Не надувайте балона до стойности на налягането надвишаващи номиналното налягане на спукване.
5. Не използвайте този катетър за централната кръвоносна система.

[Предпазни мерки по отношение на процедурите]

1. Внимателно и бавно извадете това изделие от носещата тръба и извадете предпазните части от него. Невнимателното боравене може да повреди балона и/или каналата на катетъра на изделието, влошавайки надуването и/или изпускането на балона.
2. Надуйте балона с контрастно вещество, разтворено с физиологичен разтвор в съотношение 1:1 (по-долу, "флуид за надуване"). За надуване не може да се използва газообразно средство, например въздух. (Балонът може да се надуе неравномерно.)
3. Преди употреба изгонете изцяло въздуха от балона и лумена за надуването му и го заменете с флуид за надуване. (Ако остане въздух, състоянието на надуване на балона не може да се наблюдава под флуороскоп.)
4. В случай на сериозни стенотични лезии като калцирани лезии, кръвоносният съд не може да бъде надут изцяло. Не прилагайте налягане, което да надвишава номиналното налягане на спукване в този случай. (Балонът може да се спуца и в тялото да останат остатъци.)
5. Що се отнася до медичните изделия, които се използват заедно с този катетър, следвайте инструкциите за употребата им. (Когато балонът на катетъра се ползва за последваща дилатация на стента по време на процедура за поставяне на периферен стент, направете справка с инструкциите за ползване на производителя.)
6. За поставяне в стент, изваждате от стент, или дилатация на балона в стент, работете внимателно под флуороскоп. (Работа без флуороскоп може да повреди катетъра или нарани кръвоносния съд.)
7. Не се опитвайте да прокарате дилатационния балонен катетър РТА Metacross OTW през въвеждащ катетър с размер, по-малък от отбелязания на етикета. Направете справка с етикета на продукта.

[Предпазни мерки по време на употреба]

1. Използвайте изделието непосредствено след отваряне на стерилната опаковка.

3. Този катетър трябва да се използва само от лекари с опит в перкутанната васкуларна терапия.
4. Изберете катетър с подходящ размер на балона (диаметър на балона, дължина на балона) в съответствие със следните (процедурни) критерии.
 - 1) Диаметърът на надутия балон не трябва да надвишава вътрешния диаметър на кръвоносния съд, проксимално и дистално на лезията.
 - 2) Дължината на надутия балон не трябва да надвишава дължината на третираната лезия. (Неподходящ избор на катетър може да доведе до остра оклузия на кръвоносните съдове.)
5. Използвайте този катетър само когато извършването на спешна хирургическа операция е възможно по всяко време.
6. Отговорният за процедурата лекар трябва да определи продължителността и броя на надуванията на балона на базата на своя предшестваша опит.
7. Трябва да се влее хепаринизиран физиологичен разтвор като анти-коагулант при въвеждане на балон-катетъра в кръвоносния съд.
8. В никакъв случай не надувайте балона и не въвеждайте водача при огънат или усукан катетър.
9. Движете катетъра внимателно в кръвоносния съд, като проверявате местоположението и движението на върха му под флуороскоп или DSA (дигитална субтракционна ангиография).
10. Винаги надувайте балона като същевременно наблюдавате състоянието му на надуване под флуороскоп. Надувайте балона внимателно като проверявате придвижването му чрез рентгенонепроницаемите маркери. При установяване на аномалия, например леко съпротивление, катетър, който не може да се премести по време на манипулацията, или при прегънат дистален връх на водача, процедурата трябва да бъде прекъсната незабавно и катетърът да се извади бавно заедно с водача.
11. Не въвеждайте и не ведете катетъра бързо. (Бързите манипулации могат да предизвикат повреда на катетъра или нараняване на вътрешността на кръвоносния съд.)
12. Не местете катетъра при надут балон. (При преместване на катетъра с надут балон може да се стигне до спукване на балона или до счулване на ствола на катетъра.)
13. Не надувайте или изпускайте балона бързо в кръвоносния съд. (Бързото надуване или изпускане може да увреди кръвоносния съд или да предизвика спукване на балона, при което в тялото остават замърсители.)
14. Не използвайте инжектор (автоматично устройство за инжектиране) за надуване на балона.
15. Трябва да се вземат предпазни мерки, за да се предпази катетъра от повреди, нанесени от хирургически нож или ножичи.
16. Ако настъпят аномалии, като силно съпротивление по време на манипулации на катетъра, процедурата трябва да се прекъсне незабавно. Трябва да бъде установена причината и да се предприемат подходящи действия. (Продължаването на работата с прекалена сила може да доведе до повреда на катетъра или до увреждане на съдовата стена.)
17. Винаги обръщайте внимание на състоянието на пациента и наблюдавайте телесната температура, пулса и дишането. При установяване на аномалия, преустановете използването на катетъра незабавно или предприемете съответните мерки за състоянието на пациента, по усмотрение на лекаря.
18. След употреба депонирайте катетъра като медицински отпадък в съответствие с болничните процедури.
19. Не използвайте агенти, съдържащи органични разтворители или маслени контрастни носители. Допирът с тези агенти може да доведе до повреда на катетъра.
20. Не усуквайте и въртете катетъра, по време на работа с него.
21. При въвеждане или изваждане на изделието в/от кръвоносния съд се убедете, че балонът е напълно изпуснат. (Изделие с по-голям или по-дълъг балон се нуждае по-дълго време за изпускане.)

22. Ако усетите съпротива по време на изваждането на изделието след процедурата, се препоръчва да извадите заедно цялата система заедно с интродосера/ водещия катетър.
23. Винаги използвайте катетъра заедно с водач, вкран в канала на водача.

[Инструкции за работа]

Материалите, необходими обикновено за РТА с дилатационен балон-катетър Metacross OTW РТА, включват:

- Водач(и) с подходящ диаметър и дължина
- Подходящ интродосер/водец катетър и комплект дилататори
- Флакон с контрастно вещество
- Флакон със стерилен физиологичен разтвор
- Устройство за надуване с манометър
- Спринцовка с лuerов накрайник
- Трипътно кранче

[Оперативен метод или инструкции за употреба]

1. Избор на катетър
Преди употреба проверете вътрешния диаметър на кръвоносния съд проксимално и дистално на стенотичната лезия под флуороскоп и изберете катетър с подходящ размер на балона. В случай че за проверка диаметър са приложими два размера, изберете по-малкия.
2. Подготовка
 - 1) След асептично изваждане на катетъра от опаковката, отстранете от него защитните материали.
 - 2) Заменете въздуха в балона и лумена за надуване на балона с флуид за надуване в съответствие със следните процедури.
 - a) Закрепете устройството за надуване (не е включено в този комплект), напълнено с флуид за надуване, върху отвора за надуване на балона.
 - b) След прилагане на отрицателно налягане към устройството за надуване в продължение на около 10 секунди, насочете накрайника на ствола на катетъра надолу и освободете отрицателното налягане бавно, така че флуидът да запълни балона и лумена за надуването му и да изгони въздуха.
 - c) В случай че установите наличие на въздух в балона и отвора за надуването му, повторете процедура б) до цялостно изгонване на въздуха.
 - d) Откачете устройството за надуване от отвора за надуване на балона и отстранете въздуха от цилиндъра на устройството за надуване.
 - e) Отново прикачете устройството за надуване към отвора за надуване на балона и поддържайте негативно налягане. Убедете се, че въздухът не се връща в спринцовката.
 - 3) Промийте канала на водача с хепаринизиран физиологичен и напълнете канала с хепаринизиран физиологичен разтвор.
 - 4) Потопете целия дилатационен балон-катетър Metacross OTW РТА във физиологичен разтвор.
3. Въвеждане и надуване на балон-катетъра
Преди употреба, моля, проверете дали този катетър е съвместим с водещия катетър (не е включен в този комплект), въвеждащия катетър (не е включен в този комплект), и водача (не е включен в този комплект) с помощта на следната таблица.

Каталожен номер	Диаметър на балона (мм)	Съвместима конзола (френч/мм)	Максимален диаметър на водача (инач/мм)
BD-L3002CSW ~ BD-L7020COW	3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм (с изключение на дължина на балона 200 мм), 7 мм (при дължина на балона 20 мм, 40 мм)	5 френч / 1,66 мм	0.035 инач (0,89 мм)
	6 мм (само при дължина на балона 200 мм), 7 мм (с изключение на дължина на балона 20 мм, 40 мм), 8 мм	6 френч / 2,0 мм	
	9 мм, 10 мм, 12 мм	7 френч / 2,33 мм	

При използване на катетъра, когато е поставен във въвеждащия или водещия катетър

- 1) При използване на катетъра във въвеждащия катетър, раздвижете хемостатичния клапан, като го задържате достатъчно затегнат, за да предотвратите изтичането на кръв.
- 2) Постепенно въведете катетъра, с изцяло изпуснат балон във въвеждащия или водещия катетър през водача и го придвижете напред към дисталната периферия на лезията. Под флуороскоп бавно прокарайте напред катетъра за да може рентгенонепроницаемият маркер в балона да достигне до целевото място.
- 3) Под флуороскоп проверете положението на рентгенонепроницаемия маркер в балона и определете мястото за надуване.
- 4) Закрепете здраво устройството за надуване към отвора за надуване на балона.
- 5) Надувайте балона постепенно до желания диаметър, като проверявате налягането при надуване и същевременно разширявате стеногичната лезия (за диаметъра на надутия балон,направете справка с диаграмата за съответствие на балоните в таблица 1 в края на тези Указания за употреба).
4. Изваждане на катетъра
 - 1) След като приложите отрицателно налягане за цялостно изпускане на балона, извадете катетъра.
5. Повторно въвеждане на катетъра
 - 1) Ако е необходимо повторно поставяне на извадения катетър с изпуснат балон, уверете се, че балонът е напълно изпуснат и сгънат, преди да го поставите отново в кръвоносният съд на пациента. При повторното поставяне използвайте катетъра съгласно раздела „Поставяне и надуване на балонния катетър“ в този документ.
 - 2) Ако срещнете съпротивление при повторното поставяне на катетъра, прекратете придвижването му и внимателно го извадете от кръвоносният съд на пациента. Подгответе за използване нов Metacross OTW в съответствие с процедурите, посочени в този раздел на тези Указания за употреба.

[Усложнения]

Повреди в изделието:

- Спукване на балона
- Недостатъчно надуване / изпускане на балона
- Счупване на балона и/или ствола на катетъра
- Трудности при преместване на изделието
- Изтичане на флуид за надуване

Неблагоприятни явления:

- Локални или систематични инфекции
- Местно вътрешно кървене или хематом
- Вътрешно разкъсване
- Дисекция на кръвоносен съд
- Перфорация на кръвоносен съд
- Разкъсване на кръвоносен съд
- Аневризма
- Аритмия
- Акутна васкуларна оклузия
- Венозен тромбоемболизъм
- Спазъм на кръвоносен съд
- Образуване на псевдоаневризма
- Артеровенозна фистула
- Кръвотечение, изискващо кръвопреливане
- Алергична реакция към контрастното вещество/ бъбречна недостатъчност
- Болка или болка от притискане
- Смъртен изход
- Емболизъм
- Ендокардит
- Треска
- Високо / Ниско кръвно налягане
- Възпаление
- Инфаркт на миокарда

- Сепсис
- Удар
- Инсулт
- Преходна исхемична атака

[Съхранение и срок на годност]

1. Съхранявайте на хладно, сухо и тъмно място. Избягвайте излагане на вода и пряка слънчева светлина.
2. Срокът на годност е указан върху кутията. Да не се използва след срока на годност.

[Опаковка]

1 комплект/кутия

[Име и адрес на производителя или представителя]



Производител: KANEKA CORPORATION

Адрес: 3-18, 2 Chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288, JAPAN
Тел.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Факс: (+81)-(0) 6-6226-5143



Оторизиран представител за Европейската общност: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Адрес: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Тел.: (+32)-(0) 14-256-297
Факс: (+32)-(0) 14-256-298

Дистрибутор за EC: TERUMO EUROPE N.V.

Адрес: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, Belgium (Белгия)
Тел.: (+32)-(0) 16 381 211
Факс: (+32)-(0) 16 400 249

Всички марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на TERUMO CORPORATION и техните съответни собственици.

Таблица 1. Metacross OTW Диаграма за съответствието на балоните

Налягане (атм)	Диаметър на балона (мм)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35''	10.42''	12.61''
14	3.14	4.13	5.27	6.39''	7.48''	8.58''	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50''						
20	3.36''	4.38''	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							


* Номинално налягане

** Номинално налягане на спукване

[ОПИС ПРОДУКТУ]

Metacross OTW – це дилатаційний балонний катетер для черешчирної трансліомінальної ангіопластики (ЧТА) призначений для периферійних судин. Катетер Metacross OTW належить до типу «OTW» (over the wire), а максимальний діаметр сумісного провідника складає 0.035 дюйма (0,89 мм). Дистальна частина катетера складається з балона та шайфти із двома просвітами (коаксіальних). Зовнішній просвіт використовують для заповнення та здуття балона за допомогою контрастної речовини, розведеної фізіологічним розчином. Внутрішній просвіт (просвіт провідника; від дистального кінчика до порту провідника) призначений для розташування сумісного провідника з метою полегшення просування катетера крізь ділянку стенозу чи стента, який потрібно розширити. Проксимальна частина складається з шайфти із двома просвітами та маніфольда із двома портами типу Люер.; один порт для під'єднання пристрою роздуття/здуття балона, а інший – для доступу до просвіта провідника. Всередині балона знаходяться два рентгеноконтрастні маркери, що вказують на робочу довжину балону, які допомагають лікареві належним чином розташувати балон у цільовій ділянці під контролем рентгеноскопії. Катетер Metacross OTW доступний із різними розмірами балона за діаметром та довжиною при рекомендованому тисковій роздуттю (номінальний тиск). Під час роздуття діаметр балона змінюється відповідно до тиску роздуття. Схему відповідності балонів Metacross OTW наведено у таблиці 1 наприкінці цієї інструкції з використання. У стерильній упаковці пристрій оснащено захисними матеріалами – трубкою для захисту балона та стилетом, які слід вилучити перед використанням. Трубка для захисту балона охоплює балон, згорнутий для компактності, а стилет уставлено в просвіт провідника для запобігання деформації шайфти катетера. Дистальний кінчик катетера має скіс для полегшення просування катетера до ділянки стенозу чи стента.

НАЙМЕНУВАННЯ КОЖНОЇ ЧАСТИНИ

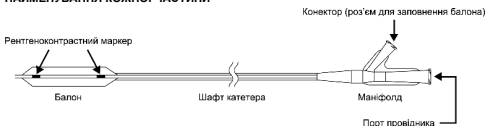

Пристрій є стерильним та апірогенним у неущкоджений і закритий блістерній упаковці. Пристрій простерилізовано оксидом етилену.

Рекомендований діаметр провідника:

Максимальний діаметр: 0.035" (0,89 мм)

Рекомендований тиск заповнення та максимальний тиск заповнення

Номінальний тиск:

- Діаметр балона: менший 6 мм:	10 атм
- Діаметр балона: 6 мм та більше:	8 атм

Номінальний тиск розриву:

- Діаметр балона: менше 5 мм:	20 атм
- Діаметр балона: 5 мм:	18 атм
- Діаметр балона: 6 мм, 7 мм, 8 мм:	14 атм
- Діаметр балона: 9 мм та більше:	12 атм

[ВКАЗІВКИ]

Metacross OTW – дилатаційний балонний катетер для ЧТА призначено для розширення звужень клубової, стенової, клубово-стенової, підколінної, задньої підколінної та ниркової артерій та для лікування обструктивних патологічних змін, артеріовенозних діалізних свищів природного або штучного походження. Цей пристрій також призначено для пост-дилатаційного стентування у периферійній судинній сітці.

Примітка. Тест верифікації щодо стента після дилатації катетером Metacross OTW проводили з використанням васкулярної стент-системи Complete® SE (Medtronic, Inc), васкулярної стент-системи

S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) та васкулярної саморозширювальної стент-системи Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[ПРОТИПОКАЗАННЯ]

1. Пациентам, у яких розвинувся стеноз анастомозу протягом одного місяця після встановлення артеріовенозного шунта.
2. Пациентам з ураженнями, які поєднані з псевдоаневризмою.
3. Вагітним пациентам або з підозрою на вагітність.
4. Пациентам із непереносимістю тромбоцитарних та антикоагулянтних терапій.

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ]

[Попередження]

1. Цей пристрій призначено для одноразового використання. Не використовувати повторно. Повторно не стерилізувати. Не піддавати повторній обробці. Повторна обробка може призвести до втрати стерильності, до порушення біосумісності та втрати функціональної цілісності виробу.
2. Не використовувати, якщо продукт або його упаковка пошкоджено.
3. Не надувати балон до розмірів, що перевищують діаметр кровоносної судини проксимально або дистально до стенозованої ділянки.
4. Тиск заповнення балона не повинен перевищувати номінальний тиск розриву.
5. Не використовувати цей катетер у центральній системі кровообігу.

[Запобіжні заходи, пов'язані з процедурами]

1. Аккуратно та повільно вийміть пристрій з трубки утримувача і вилучіть захисні частини з цього пристрою. Необережне поводження може призвести до пошкодження балона та/або шайфти катетера, що унеможливить заповнення та/або здуття балона.
2. Заповнювати балон сумішшю контрастної речовини та фізіологічного розчину у пропорції 1:1 (надалі «рідина для заповнення»). Не слід використовувати газоподібні контрастні речовини для заповнення. (Балон може заповнюватися нерівномірно.)
3. Перед використанням випустіть все повітря з балона і з просвіту для заповнення балона та замініть його рідиною для заповнення. (У разі неповного видалення повітря, виявити стан заповненості балона на рентгеноскопії неможливо.)
4. У випадку серйозних стенозних новоутворень, таких як кальциновані новоутворення, кровоносна судина не може бути дилатована повністю. У такому випадку не використовуйте тиск, що перевищує номінальний тиск розриву. (Балон може розірватися, і фрагменти можуть залишитися всередині тіла.)
5. Для медичних пристроїв, які використовуються разом з цим катетером, слід дотримуватися інструкцій з використання цими пристроями. (Коли балонний катетер використовується для пост-дилатації стенту під час процедури встановлення периферійного стенту, зверніться до інструкцій з використання від виробника.)
6. Для введення у стент, виведення зі стенту або внутрішньостентової дилатації балона, процедуру слід проводити з обережністю, з використанням рентгеноскопії. (Здійснення цього без рентгеноскопії може зруйнувати катетер або пошкодити кровоносну судину.)
7. Не намагайтеся провести Metacross OTW дилатаційний балонний катетер для ЧТА через інтродьюсер меншого діаметру, ніж вказано на етикетці. Інформація зазначена на етикетці продукту.

[Заходи безпеки під час використання]

1. Використовуйте пристрій відразу ж після відкриття стерильної упаковки.
2. Усі маніпуляції повинні проводитися в асептичних умовах.

3. Цей катетер повинен використовуватися тільки лікарями, кваліфікованими для проведення черезшкірної судинної терапії.
4. Оберіть катетер із відповідним розміром балона (діаметр балона, довжина балона), дотримуючись наступних (процедур) критеріїв.
 - 1) Діаметр заповненого балона не повинен перевищувати внутрішній діаметр судини проксимально та дистально до ураження
 - 2) Довжина заповненого балона не повинна перевищувати довжину ураження, яке слід лікувати.
(Невірний вибір катетера може призвести до різкої оклюзії судини).
5. Використовуйте цей катетер за умови можливості проведення термінової операції .
6. Лікар, який виконуватиме процедуру, повинен визначити тривалість і кількість заповнень балона, спираючись на свій минулий досвід.
7. Коли балонний катетер вставлений в кровоносну судину, для забезпечення антикоагуляції слід ввести гепаринізований фізіологічний розчин.
8. Ніколи не заповнюйте балон та не просувайте провідник із зігнутим або заплутаним катетером.
9. Маніпулюйте катетером у кровоносній судині обережно, відстежуючи розташування і рух його кінчика на рентгеноскопії або на моніторі ЦСА (цифрова субтракційна ангіографія).
10. Завжди заповнюйте балон, спостерігаючи за його заповненням за допомогою рентгеноскопії. Обережно заповнюйте балон, перевіряючи його рух за допомогою рентгеноконтрастних маркерів. Якщо спостерігаються будь-які відхилення від норми, такі як слабкий опір, нерухомий катетер під час маніпуляцій або вигнутий дистальний кінчик провідника, процедуру слід негайно припинити і повільно вилучити катетер разом з провідником.
11. Не поспішайте при розташуванні або вилученні катетера. (Різкі рухи можуть пошкодити катетер або інтиму судини.)
12. Не маніпулюйте дилатаційним катетером із заповненим балоном. (Переміщення катетера із заповненим балоном може призвести до розриву балона або руйнування шафту катетера)
13. Не поспішайте при заповнюванні або здутті балону в кровоносній судині. (Швидке заповнення або дефляція можуть пошкодити кровоносні судини або призвести до розриву балона, що спричинить відокремлення фрагментів в тіло пацієнта.)
14. Не використовуйте інжектор (автоматичний пристрій для заповнення) для заповнення балона.
15. Слід вжити застережних заходів для запобігання будь-якому uszkodженню катетера хірургічним ножом або ножицями.
16. Якщо під час маніпулювання катетером помічено будь-яке відхилення від норми, наприклад, значний опір, слід негайно припинити процедуру . Слід з'ясувати причину і вжити відповідних заходів. (Продовження операції з докладанням надмірної сили може призвести до руйнування катетера або пошкодження стінки кровоносної судини).
17. Завжди приділяйте увагу стану пацієнта та відстежуйте його температуру тіла, пульс та дихання. Якщо виявлено будь-які відхилення від норми, слід негайно припинити використання катетера або, на розсуд лікаря, вжити належних заходів для покращення стану пацієнта.
18. Після використання утилізуйте катетер як медичні відходи, дотримуючись клінічних процедур.
19. Не використовуйте органічні розчинники або масялянисті контрастні речовини. Контакт з цими речовинами може призвести до пошкодження катетера.
20. Під час маніпулювання катетером, не гнітайте та не крутіть катетер.
21. Під час введення цього пристрою у кровоносну судину або виведення цього пристрою з кровоносної судини слід упевнитися, що балон повністю пустий. (Пристрій з більшим або довшим балоном потребує більшого часу для здуття).

22. Якщо відчувається опір під час післяпроцедурного виведення цього пристрою, рекомендовано вилучити всю систему разом з інтродьюсером/провідником.
23. Завжди використовуйте катетер разом з провідником, встановленим у просвіті для провідника.

[Інструкції з використання]

Матеріали, що зазвичай використовуються для ЧТА за допомогою Metacross OTW дилатаційного балонного катетера для ЧТА:

- Провідник(и) відповідного діаметру та довжини
- Відповідний інтродьюсер / направляючий катетер і набір дилаторів
- Флакон з контрастною речовиною
- Флакон стерильного фізіологічного розчину
- Пристрій для заповнення з манометром
- шприц з роз'ємом Люера
- Триходовий краник

[Метод експлуатації або інструкції із застосування]

1. Вибір катетера

Перед використанням перевірте на рентгеноскопії внутрішній діаметр кровоносних судин проксимально та дистально до стенозного ураження та виберіть катетер з відповідним розміром балона. Якщо обидва розміри відповідають перевіреному діаметру, оберіть катетер меншого розміру.

2. Приготування

- 1) Після видалення в аспетичних умовах катетера з контейнера, зніміть захисне покриття з катетера.
- 2) Замініть повітря в балоні та в просвіті для заповнення балона рідиною для заповнення у відповідності до наступних процедур.
 - a) Закріпіть пристрій для заповнення (не входить у цей комплект) із рідиною для заповнення у порт для заповнення балона.
 - b) Після застосування негативного тиску до пристрою для заповнення протягом приблизно 10 секунд, спрямуйте кінчик катетера донизу та повільно послабте негативний тиск, щоб дозволити рідині заповнити балон та просвіт для заповнення балона, витиснувши повітря.
 - c) Якщо після того, як балон був заповнений рідиною для заповнення, в ньому та в просвіті катетера залишилося повітря, повторіть процедуру b) до повної відсутності повітря.
 - d) Від'єднайте пристрій для заповнення від порту для заповнення балона та випустіть повітря з циліндра пристрою для заповнення.
 - e) Під'єднайте пристрій для заповнення балона до порту заповнення балона і утримуйте негативний тиск. Упевніться, що повітря більше не повертається до шприца.
- 3) Промийте просвіт провідника гепаринізованим фізіологічним розчином та заповніть ним просвіт.
- 4) Загнурте Metacross OTW дилатаційний балонний катетер для ЧТА повністю у фізіологічний розчин.
3. Встановлення та заповнення балонного катетера
Перед використанням, будь-ласка, перевірте сумісність даного катетера з провідниковим катетером (не включеного у цей комплект), інтродьюсером (не включеного у цей комплект) та провідником (не включеного у цей комплект) відповідно до наступної таблиці.

Номер за каталогом	Діаметр балона (мм)	Сумісний інтродьюсер (Fr/мм)	Максимальний діаметр для провідника (дюймів/мм)
BD-L30020SW ~ BD-L70200CW	3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм (за винятком балонів довжиною 200 мм), 7 мм (балони довжиною 20 мм, 40 мм)	5 Fr / 1,66 мм	0.035 дюйма (0.89 мм)
	6 мм (лише балони довжиною 200 мм), 7 мм (за винятком балонів довжиною 20 мм, 40 мм), 8 мм	6 Fr / 2,00 мм	
	9 мм, 10 мм, 12 мм	7 Fr / 2,33 мм	

Використання катетера, розташованого в інтродюсері або провідниковому катетері

- 1) Під час використання катетера в провідниковому катетері дещо послабте гемостатичний клапан, проте залиште його досить туго затиснутим для запобігання витоку крові.
- 2) поступово введіть катетер з повністю пустим балоном у інтродюсер або провідниковий катетер поверх провідника та просувайте до дистальної периферії ушкодження. Повільно просувайте катетер під рентгеноскопією до досягнення рентгеноконтрастним маркером на балоні мети необхідної ділянки.
- 3) Під рентгеноскопією слід підтвердити розміщення рентгеноконтрастного маркера та визначити область дилатації.
- 4) Надійно під'єднайте пристрій для заповнення балона до порту для заповнення.
- 5) Поступово заповніть балон до потрібного діаметру, перевіряючи тиск заповнення, та розширте стенозоване ураження (відомості щодо діаметру роздутного балона див на схемі відповідності балонів, наведених у таблиці 1 наприкінці цієї інструкції з використання).
4. Вилучення катетера
 - 1) Після застосування негативного тиску для повного видалення повітря з балона, катетер слід видалити.
5. Повторне встановлення катетера
 - 1) Якщо потрібно повторно встановити виїятий катетер зі здутим балоном, переконайтеся, що балон повністю здутий та згорнутий, перед тим як повторно встановлювати його у кровоносну судину пацієнта. Під час повторного встановлення катетера поведіться з ним згідно з розділом цієї інструкції «Встановлення та роздуття балонного катетера».
 - 2) Якщо під час повторного встановлення катетера спостерігається будь-який опір, припиніть його просування й акуратно вилучіть його з кровоносної судини пацієнта. Підготуйте до використання новий катетер Metacross OTW відповідно до процедур, наведених вище у цьому розділі цієї інструкції з використання.

[Ускладнення]

Дисфункції пристрою:

- Розрив балона
- Недостатнє заповнення / здуття балона
- Пошкодження балона та/або шашта катетера
- Ускладнення під час видалення приладу
- Витікання речовини для заповнення

Побічні явища:

- Місцеві або системні інфекції
- Місцева внутрішня кровотеча або гематома
- Розрив інтими
- Дисекція судини
- Перфорація судини
- Розрив судини
- Аневризма
- Аритмія;
- Гостра оклюзія судини
- Венозна тромбоемболія
- Вазоспазм
- Утворення псевдоаневризми
- Артеріовенозний свищ
- Кровотеча, що вимагає переливання крові
- Алергічна реакція на контрастну речовину / відмова нирок
- Тулий або стискаючий біль
- Смерть
- Емболія
- Ендокардит
- Лихоманка
- Гіпертензія / Гіпотензія
- Печія
- Інфаркт міокарду
- Сепсис

- Шок
- Інсульт
- Транзиторний ішемічний напад

[Зберігання та термін придатності]

1. Зберігати у прохолодному, сухому, темному місці. Уникати контакту з водою, прямими сонячними променями.
2. Термін придатності вказано на коробці. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

[Упаковка]

1 комплект/коробка

[Назва та адреса виробника або представника]



Виробник: KANEKA CORPORATION

Адреса: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

Телефон: (+81)-(0) 6-6226-5256

Факс: (+81)-(0) 6-6226-5143



Авторизований представник у Європейській Співдружності: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Адреса: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Телефон: (+32)-(0) 14-256-297

Факс: (+32)-(0) 14-256-298

Дистриб'ютор у ЄС: TERUMO EUROPE N.V.

Адреса: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
(БЕЛЬГІЯ)

Телефон: (+32)-(0) 16 381 211

Факс: (+32)-(0) 16 400 249

Усі зазначені назви компаній та різні імена є торговими марками та зареєстрованими торговими марками корпорації Terumo, а також кожної компанії.

Таблиця 1. Схема відповідності балонів Metacross OTW

Тиск (атм)	Діаметр балона (мм)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'			
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28			
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35"	10.42"	12.61"			
14	3.14	4.13	5.27	6.39"	7.48"	8.58"	9.55	10.71	12.98			
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79						
18	3.28	4.29	5.50"									
20	3.36"	4.38"	5.64									
22	3.46	4.49	5.79									
24	3.56	4.60										

* Номінальний тиск


** Номінальний тиск розриву

[OPIS PROIZVODA]

Metacross OTW je balonski dilatacijski kateter za perkutano transluminalnu angioplastiku (PTA) za periferne indikacije. Metacross OTW je OTW tip, koaksijalni, a maksimalni promjer kompatibilne žice vodilje je 0.035 in (0,89 mm).

Distalni dio ovog katetera sastoji se od balona i dvolumenskih osovina (koaksijalnih). Vanjski lumen služi za napuhavanje i ispuhivanje balona kontrastnim sredstvom razrijeđenim fiziološkom otopinom. Unutarnji lumen (lumen žice vodilje; od distalnog vrha do otvora žice vodilje) služi za umetanje kompatibilne žice vodilje čime se olakšava uvođenje katetera kroz stenotičnu leziju ili stent koje treba dilatirati. Proksimalni dio je dvolumenska osovina s dvojnomo luer utičnicom Manifold; jedna za spajanje na napuhavanje/ispuhivanje balona, druga za pristup lumena žice vodilje. Unutar balona postavljena su dva rentgenski vidljiva markera koji označavaju radnu dužinu balona, kako bi liječnika vodili u pravilnom postavljanju balona na ciljanu leziju pri fluoroskopiji. Metacross OTW je dostupan s balonima različitih promjera i dužina pri preporučenim tlakovima napuhavanja (nominalni tlak). Nakon napuhavanja promjer balona se mijenja sukladno tlaku napuhavanja. U tablici 1 na kraju ove Upute za uporabu nalazi se shema usklađenosti Metacross OTW balona. U pakiranju za sterilizaciju, uređaj je opremljen zaštitnim materijalima, zaštitna cijev balona i stilet, koje treba ukloniti prije upotrebe. Zaštitna cijev balona je postavljena preko balona i tanko presavijena a stilet je umetnut u lumen žice vodilje kako bi se spriječio prijelom trupa katetera. Distalni vrh katetera je konusni kako bi se olakšalo uvođenje katetera u stenotičnu leziju ili stent.

<NAZIVI DJELOVA>

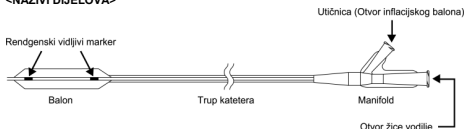

Sterilan i nepirogen u neotešenoj i neotvorenoj blister vrećici. Ovaj uređaj je steriliziran etilen-oksikom.

Preporučeni promjer žice vodilje:

Maksimalni promjer: 0,035" (0,89 mm)

Preporučeni inflacijski tlak i maksimalni inflacijski tlak

Nazivni tlak:

- Promjer balona: manji od 6 mm:	10 atm
- Promjer balona: 6 mm i više:	8 atm
Nazivni tlak prsnuća:	
- Promjer balona: manji od 5 mm:	20 atm
- Promjer balona: 5 mm:	18 atm
- Promjer balona: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 atm
- Promjer balona: 9 mm i više:	12 atm

[INDIKACIJE]

Balonski dilatacijski kateter Metacross OTW PTA namijenjen je dilataciji stenozu kod ilijačnih, femoralnih, iliofemoralnih, poplitealnih, infra-poplitealnih i renalnih arterija, kao i za liječenje opstrukcijskih lezija nativnih ili sintetskih arteriovenskih dijilaznih fistula. Ovaj uređaj se također primjenjuje u postdilataciji periferne vaskulature.

Napomena: Test provjere za postdilataciju stenta Metacross OTW proveden je koristeći Complete® SE Vascular Stent System (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) i Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation).

[Kontraindikacije]

1. Pacijenti koji su razvili anastomozne stenozu u roku od mjesec dana nakon ugradnje AV shunta.
2. Pacijenti koji imaju lezije koje komuniciraju s pseudoaneurizmom.

3. Trudnice.
4. Pacijenti koji ne mogu tolerirati antitrombotičnu ili antikoagulantnu terapiju.

[UPOZORENJA I MJERE OPREZA]

[Upozorenja]

1. Ovaj uređaj je za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovno koristiti uređaj. Nemojte iznova sterilizirati. Nemojte ponavljati postupak. Ponavljanje može utjecati na sterilnost, biokompatibilnost i fizički integritet uređaja.
2. Nemojte koristiti proizvod ako su proizvod ili ambalaža oštećeni.
3. Balon se ne smije napuhati tako da prelazi promjer krvne žile proksimalno i distalno prema leziji stenozu.
4. Nemojte napuhivati balon tako da prelazi tlak pucanja.
5. Kateter se ne smije koristiti u središnjem krvožilnom sustavu.

[Mjere opreza u pogledu postupaka]

1. Pažljivo i polagano izvadite uređaj iz nosača i uklonite dijelove za zaštitu uređaja. Nepažljivo rukovanje može oštetiti balon ili trup katetera te utjecati na napuhivanje ili ispuhivanje balona.
2. Napužite balon kontrastnim sredstvom razrijeđenim s fiziološkom otopinom u omjeru 1:1 (u daljnjem tekstu "inflacijski fluid"). Plinoviti medij kao što je zrak ne smiju se koristiti za napuhivanje. (Balon bi se mogao nepravilno napuhati.)
3. Prije uporabe, istisnite sav zrak iz balona i inflacijskog lumena balona i zamijenite ga s inflacijskim fluidom. (U slučaju nepotpunog uklanjanja zraka, balon se u napuhanom stanju ne može promatrati pod fluoroskopijom.)
4. U slučaju ozbiljnih stenotičnih lezija kao što su kalcificirane lezije, krvne žile ne mogu biti dilatirane u potpunosti. U tom slučaju, nemojte primjenjivati tlak koji prelazi tlak pucanja. (Balon može puknuti i krhotine mogu ostati u tijelu.)
5. Što se tiče medicinskih uređaja koji se koriste uz ovaj kateter, slijedite upute za uporabu takvih uređaja. (Kad se balonski kateter koristi za postdilataciju stenta tijekom postupka postavljanja periferne stenta, pogledajte upute proizvođača.)
6. Pri umetanju u stent, povlačenju iz stenta ili in-stent dilataciji balona, radite oprezno pod fluoroskopijom. (Radom bez fluoroskopije mogli biste oštetiti kateter ili ozlijediti krvnu žilu.)
7. Nemojte pokušavati provući dilatacijski balonski kateter Metacross OTW PTA kroz ovojnicu uvodnice koja je manje veličine od one navedene na naljepnici. Pogledajte oznake proizvoda.

[Mjere opreza tijekom uporabe]

1. Koristite uređaj odmah nakon otvaranja sterilnog paketa.
2. Cijeli postupak treba provoditi aseptički.
3. Kateter trebaju koristiti samo liječnici vješti u perkutnoj vaskularnoj terapiji.
4. Odaberite kateter odgovarajuće veličine balona (promjer i duljina balona) prema sljedećim kriterijima (postupka).
 - 1) Promjer napuhanog balona ne smije prelaziti unutarnji promjer krvne žile proksimalno i distalno u odnosu na leziju.
 - 2) Duljina napuhanog balona ne smije prelaziti duljinu tretirane lezije. (Neprikladan izbor katetera može dovesti do akutne vaskularne okluzije.)
5. Koristite ovaj kateter samo ako je moguće izvesti hitni kirurški zahvat u bilo kojem trenutku.
6. Liječnik zadužen za postupak treba utvrditi trajanje i broj napuhivanja balona na temelju svojih ranijih iskustava.
7. Dok je balonski kateter u krvnoj žili, treba primijeniti infuziju heparinirane fiziološke otopine radi anti-koagulacije.
8. Nikada ne napuhujte balon niti uvodite žicu vodilju sa savijenim ili iskrivljenim kateterom.
9. Pažljivo rukujte kateterom u krvnoj žili provjeravajući položaj i kretanje njegovog vrha pod fluoroskopijom ili digitalnom suptrakcijskom angiografijom (DSA).
10. Balon uvijek napuhujte tako da njegovo stanje promatrate pod fluoroskopijom. Pažljivo napuhujte balon provjeravajući njegove

- kretne pomoću rendgenski vidljivog markera. Ako dođe do abnormalnosti kao što su slab otpor, zastoj katetera tijekom rukovanja ili iskrivljivanje distalnog vrha žice vodilje, postupak treba odmah prekinuti i kateter treba polagano ukloniti zajedno sa žicom vodiljom.
- Kateter se ne smije brzo uvoditi niti uklanjati. (Brzi rad s kateterom može ga oštetiti ili ozlijediti vaskularnu intimu.)
 - Nemojte pomicati kateter dok je balon napuhan. (Pomicanje katetera s napuhanim balonom može dovesti do pucanja balona ili prijeloma trupa katetera.)
 - Dok je u krvnoj žili, balon se ne smije naglo napuhati ili ispuhati. (Brzo napuhivanje ili ispuhivanje može oštetiti krvne žile ili uzrokovati pucanje balona te u tijelu mogu ostati krhotine.)
 - Za napuhivanje balona nemojte koristiti injektor (automatski uređaj za ubrizgavanje).
 - Treba poduzeti mjere opreza kako bi se spriječilo oštećenje katetera kirurškim nožem ili škarama.
 - Ako se pojave abnormalnosti, kao što je jak otpor tijekom rukovanja kateterom, postupak treba odmah prekinuti. Treba pronaći uzrok i poduzeti odgovarajuće mjere. (Nastavak operacije primjenom prekomjerne sile može dovesti do oštećenja katetera ili ozljede stijenke krvne žile.)
 - Uvijek obratite pozornost na stanje pacijenta i pratite tjelesnu temperaturu, puls i disanje. Kada se pojave abnormalnosti, odmah prekinite uporabu katetera ili poduzmite odgovarajuće mjere sukladno stanju pacijenta prema procjeni liječnika.
 - Nakon uporabe odložite kateter kao medicinski otpad u skladu s bolničkim postupcima.
 - Nemojte koristiti sredstva koja sadrže organska otapala ili kontrastna sredstva na bazi ulja. Kontakt s njima može dovesti do oštećenja katetera.
 - Dok rukujete kateterom, nemojte ga savijati niti okretati.
 - Prilikom uvođenja uređaja u krvne žile ili uklanjanja iz njih, pobrinite se da je balon u potpunosti ispraznjen. (Uređaju s većim ili duljim balonom treba više vremena za napuhivanje.)
 - Ako osjetite otpor tijekom postupoduralnog povlačenja uređaja, preporučljivo je povući cijeli sustav, zajedno s uvodnicom / vodičem ovojnice.
 - Kateter uvijek koristite sa žicom vodiljom umetnutom u lumen žice vodilje.

[Operativne upute]

Materijali koji su obično potrebni za PTA s balonskim dilatacijskim kateterom Metacross OTW PTA uključuju:

- Žicu vodilju odgovarajućeg promjera i dužine
- Odgovarajući uvodnicu / vodič ovojnice i dilator komplet
- Bočicu kontrastnog sredstva
- Bočicu sterilnog pufera
- Uređaj za napuhivanje s manometrom
- Luer-lock špicu
- Troputni sigurnosni ventil

[Metode operacije ili upute za uporabu]

- Odabir katetera
 - Prije uporabe, pod fluoroskopijom provjerite unutarnji promjer krvne žile proksimalno i distalno u odnosu na stenotičnu leziju i odaberite kateter s odgovarajućom veličinom balona. Ako su za procijenjeni promjer primjenjive dvije veličine, odaberite manju.
- Pripreme
 - Nakon aseptičnog vađenja katetera iz spremnika, uklonite zaštitni materijal s katetera.
 - Ispustite zrak iz balona i infencijskog lumena balona i zamijenite ga s infencijskim fluidom prema sljedećem postupku.
 - Pričvrstite uređaj za napuhivanje (nije uključen u ovaj komplet) ispunjen infencijskim fluidom na otvor za napuhivanje balona.
 - Nakon primjene negativnog tlaka otprilike 10 sekundi na uređaju za napuhivanje, usmjerite vrh trupa katetera prema dolje i polagano oslobodite negativni tlak kako biste fluidom ispunili balon i infencijski lumen balona te istisnuli zrak.
 - Ako u balonu i infencijskom lumenu balona još uvijek ima zraka, ponovite postupak b) sve dok se sav zrak u potpunosti ne ukloni.

- Odvijite uređaj za napuhivanje s otvora infencijskog balona i uklonite zrak iz cilindra uređaja za napuhivanje.
 - Ponovno pričvrstite uređaj za napuhivanje na otvor infencijskog balona i održavajte negativan tlak. Uvjerite se da se zrak više ne vraća u štrcaljku.
 - Isperte lumen žice vodilje hepariniziranim fiziološkom otopinom i ispunite ga njome.
 - Uronite cijeli balonski dilatacijski kateter Metacross OTW PTA u fiziološku otopinu.
- Umetanje i napuhivanje balonskog katetera

Prije uporabe, provjerite je li kateter kompatibilan s uvodnim kateterom (nije uključen u ovaj komplet), ovojnicom uvodnice (nije uključena u ovaj komplet), i žicom vodiljom (nije uključena u ovaj komplet) prema sljedećoj tablici.

Kataloški broj	Promjer balona (mm)	Kompatibilna ovojnica (Fr/mm)	Maksimalni promjer žice vodilje (inč/mm)
BD-L300020SW ~ BD-L70200CW	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (zuzev dužine balona 200 mm), 7 mm (20 mm, 40 mm dužine balona)	5 Fr / 1,66 mm	0.035 inča (0,89 mm)
	6 mm (samo dužina balona 200 mm), 7 mm (zuzev dužine balona 20 mm, 40 mm), 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Kada koristite kateter umetnut u ovojnicu uvodnice ili uvodni kateter

- Kada se ovaj kateter koristi u uvodnom kateteru, otpustite hemostatski ventil, ali istovremeno pazite da bude dovoljno zategnut kako biste spriječili gubitak krvi.
- Postupno umetnite kateter s potpuno ispraznjenim balonom u ovojnicu uvodnice ili uvodni kateter preko žice vodilje i uvodite do distalnog ruba lezije. Kateter uvodite polagano, pod fluoroskopijom, dok njegov rendgenski vidljivi marker u balonu ne dođe na ciljno mjesto.
- Pod fluoroskopijom, provjeravajte položaj rendgenski vidljivog markera u balonu i odredite mjesto dilatacije.
- Uređaj za napuhivanje dobro pričvrstite na otvor infencijskog balona.
- Postupno napuhujte balon do ciljnog promjera provjeravajući tlak inflacije i dilatirajte stenotičnu leziju (za promjere napuhanog balona pogledajte shemu sukladnosti u tablici 1. na kraju ovih uputa za upotrebu).
- Uklanjanje katetera
 - Primjenom negativnog tlaka potpuno ispraznite balon i izvadite kateter.
- Ponovno uvođenje katetera
 - Ako je potrebno ponovo uvoditi izvađeni kateter s ispuhanim balonom, uvjerite se da je balon potpuno ispuhan i presavijen prije ponovnog uvođenja u krvnu žilu pacijenta. Pri ponovnom uvođenju kateter upotrijebite prema odjeljku "Umetanje i napuhivanje balonskog katetera" ovdje.
 - Ako se pri ponovnom uvođenju katetera naide na otpor, prekinite uvođenje i pažljivo ga uklonite iz krvne žile pacijenta. Pripremite za upotrebu novi Metacross OTW u skladu s postupkom opisanom gore u ovom odjeljku Uputa za upotrebu.

[Komplikacije]

Kvarovi na uređaju:

- Probijanje balona
- Nedovoljna infliacija ili deflacija balona
- Pucanje balona ili prijelom trupa katetera
- Poteškoće pri uklanjanju uređaja
- Istjecanje infencijskog fluida

Štetni događaji:

- Lokalne ili sustavne infekcije
- Lokalno unutarnje krvarenje ili hematoma
- Intimalna ruptura
- Vaskularna disekcija
- Vaskularna perforacija

- Vaskularna ruptura
- Aneurizma
- Aritmija
- Akutna vaskularna okluzija
- Venska tromboembolija
- Vazospazam
- Formiranje pseudoaneurizme
- Arteriovenske fistule
- Krvarenje koje zahtijeva transfuziju
- Alergijske reakcije na kontrastna sredstva / zatajenje bubrega
- Dugotrajna bol ili bol pod pritiskom
- Smrt
- Embolija
- Endokarditis
- Groznica
- Hipertenzija / hipotenzija
- Upala
- Infarkt miokarda
- Sepsa
- Šok
- Moždani udar
- Prolazni ishemijski napad

[Skladištenje i datum isteka]

1. Čuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu. Izbjegavajte izlaganje vodi i izravnoj sunčevoj svjetlosti.
2. Datum isteka je označen na kutiji. Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti.

[Paket]

1 komplet / kutija

[Ime i adresa proizvođača ili zastupnika]



Proizvođač: KANEKA CORPORATION

Adresa: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. br. : (+81)-(0) 6-6226-5256
Faks. : (+81)-(0) 6-6226-5143



Ovlašteni zastupnik u Europskoj Uniji:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresa: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel. br. : (+32)-(0) 14-256-297
Faks. : (+32)-(0) 14-256-298

Distributer u EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresa: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgija
Tel. br. : (+32)-(0) 16 381 211
Faks. : (+32)-(0) 16 400 249

Svi nazivi brenda su trgovački žigovi ili registrirani trgovački žigovi tvrtke TERUMO CORPORATION i njihovih vlasnika.

Tablica 1. Shema sukladnosti Metacross OTW balona

Tlak (atm)	Promjer balona (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.96'	6.98'	8.00'	8.98'	9.90'	11.98'
10	3.01'	3.98'	5.06'	6.11	7.14	8.19	9.18	10.16	12.28
12	3.07	4.06	5.16	6.24	7.30	8.38	9.35''	10.42''	12.61''
14	3.14	4.13	5.27	6.39''	7.48''	8.58''	9.55	10.71	12.98
16	3.21	4.21	5.38	6.55	7.66	8.79			
18	3.28	4.29	5.50''						
20	3.36''	4.38''	5.64						
22	3.46	4.49	5.79						
24	3.56	4.60							

*Nominalni tlak

** Nazivni tlak prsnuća

© TERUMO CORPORATION September, 2021

PM-05579
(3210-2)